



| | |
|------------------------------------|--|
| Nom KOUROUMA | Adresse |
| Prénom DAVID | Exposition |
| Né le 19/08/1994 | Profession OFFICIER HSE |
| Age 29 Ans | Entreprise COVEC |
| Genre Masculin | Service |
| ID 409 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 160 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 52 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur admin admin | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 30,2 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 93,8 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 61 %

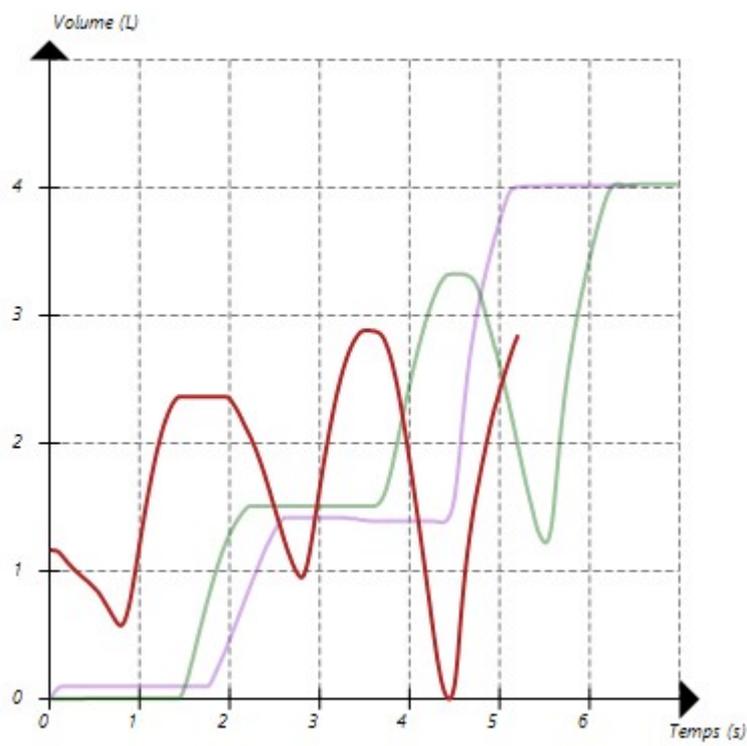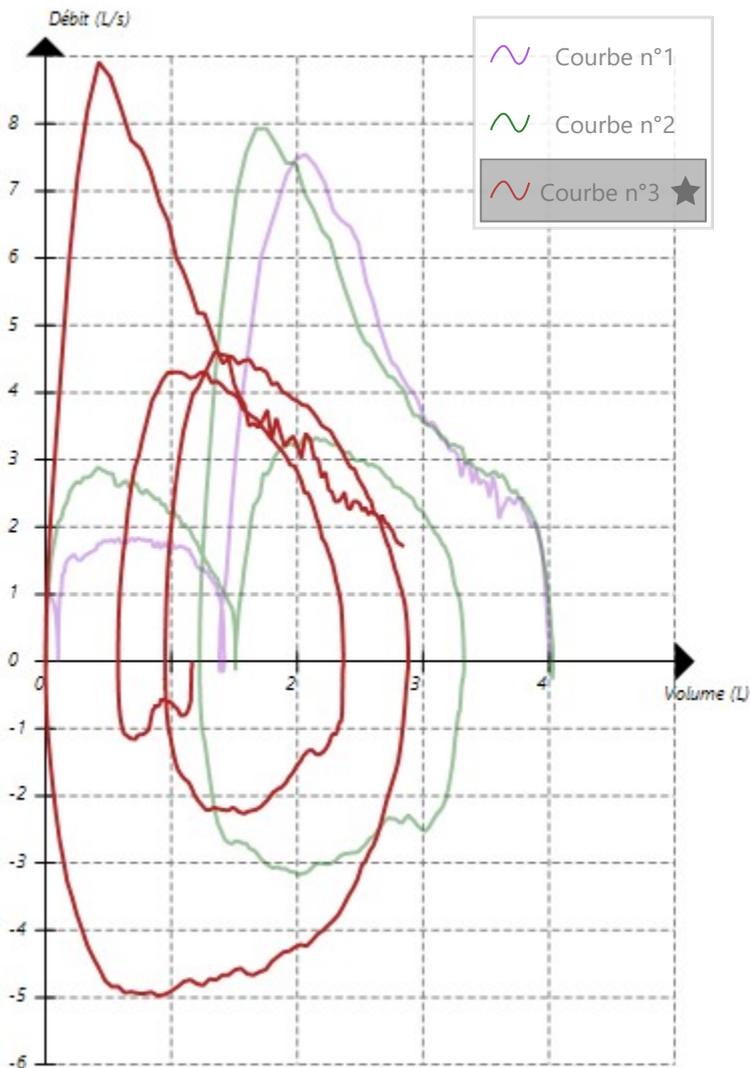

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 | Courbe n°3 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 2,63 L | 2,81 L | 2,87 L | 3,58 L | 80,17 % |
| VEMS | 2,63 L | 2,81 L | 2,87 L | 3,05 L | 94,10 % |
| DEP | 7,67 L/s | 8,08 L/s | 9,00 L/s | 8,04 L/s | 111,94 % |
| VEMS/ CVF | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,94 % | 119,13 % |
| Durée d'expiration | 2,04 s | 0,80 s | 0,78 s | - | |
| DEMM | 4,69 L/s | 4,60 L/s | 4,47 L/s | 3,60 L/s | 124,17 % |
| DEMM/ CVF | 1,78 s-1 | 1,64 s-1 | 1,56 s-1 | 1,01 s-1 | 154,46 % |
| DE75 | 7,50 L/s | 7,31 L/s | 7,68 L/s | - | |
| DE50 | 4,70 L/s | 4,56 L/s | 4,71 L/s | - | |
| DE25 | 2,91 L/s | 2,94 L/s | 3,01 L/s | - | |