

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMOUDOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/12/1999	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> CHAUFFER
<b>ID</b> 730	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 65 %

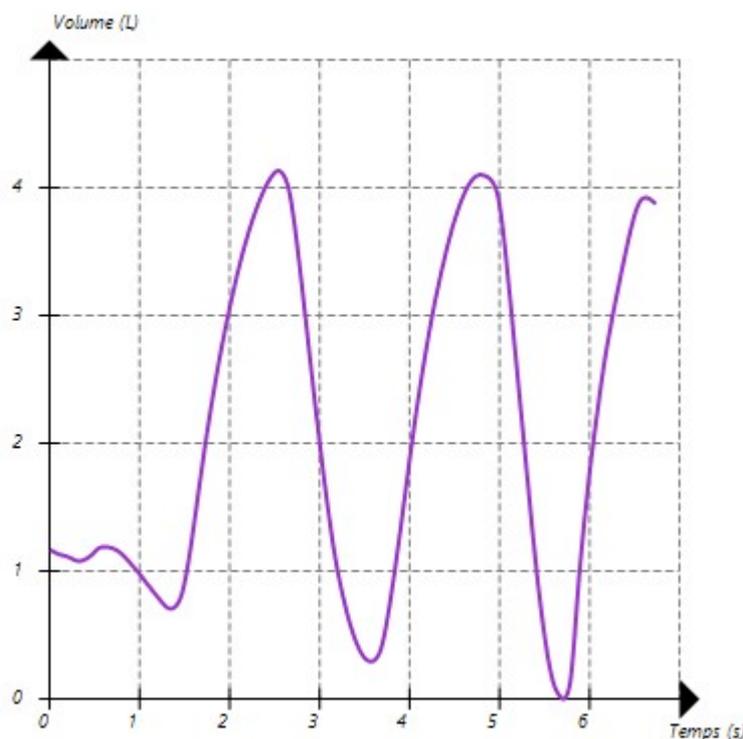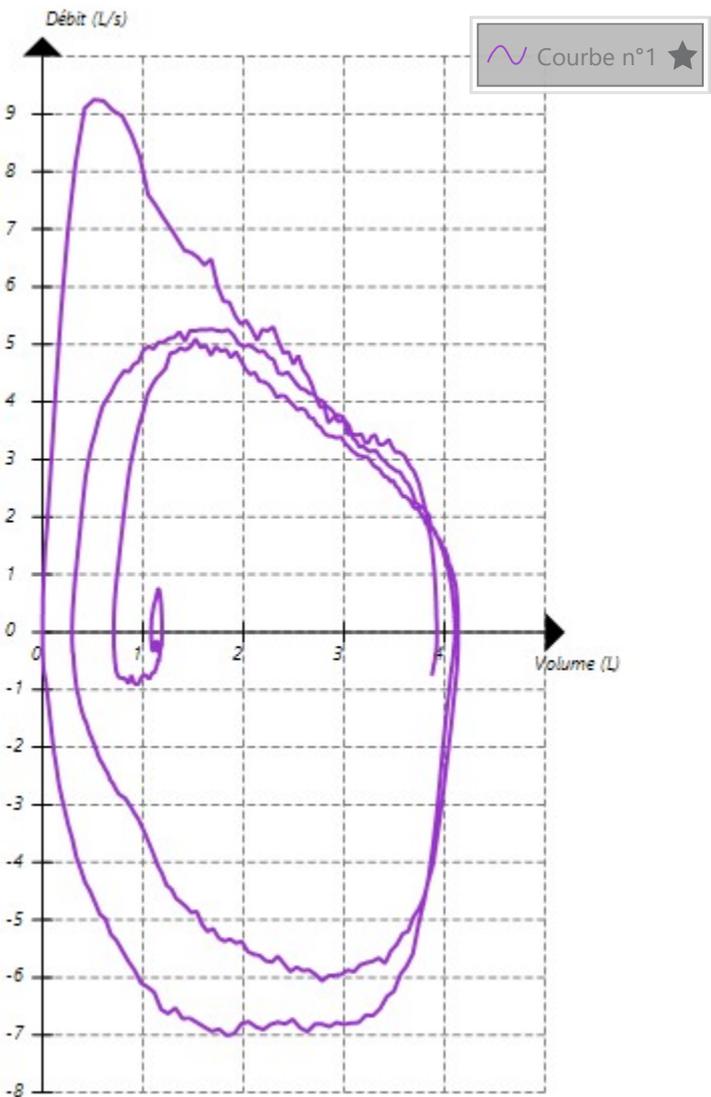

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,92 L	4,86 L	80,66 %
VEMS	3,92 L	4,11 L	95,38 %
DEP	9,27 L/s	10,20 L/s	90,88 %
VEMS/ CVF	100,00 %	84,85 %	117,86 %
Durée d'expiration	0,91 s	-	
DEMM	5,54 L/s	4,56 L/s	121,49 %
DEMM/ CVF	1,41 s-1	0,94 s-1	150,00 %
DE75	8,19 L/s	-	
DE50	5,35 L/s	-	
DE25	3,78 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: