


<b>Nom</b> BEAVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BALLA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/06/1992	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MENUISIER
<b>ID</b> 755	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,7 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 58 %

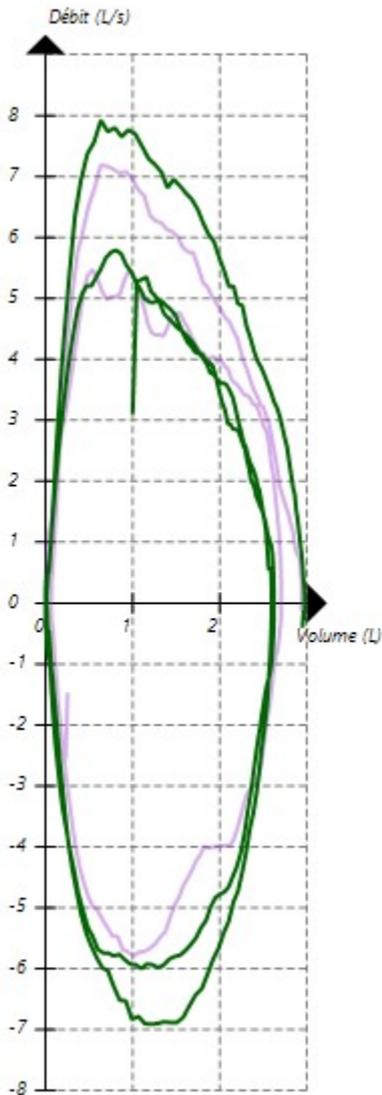

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★

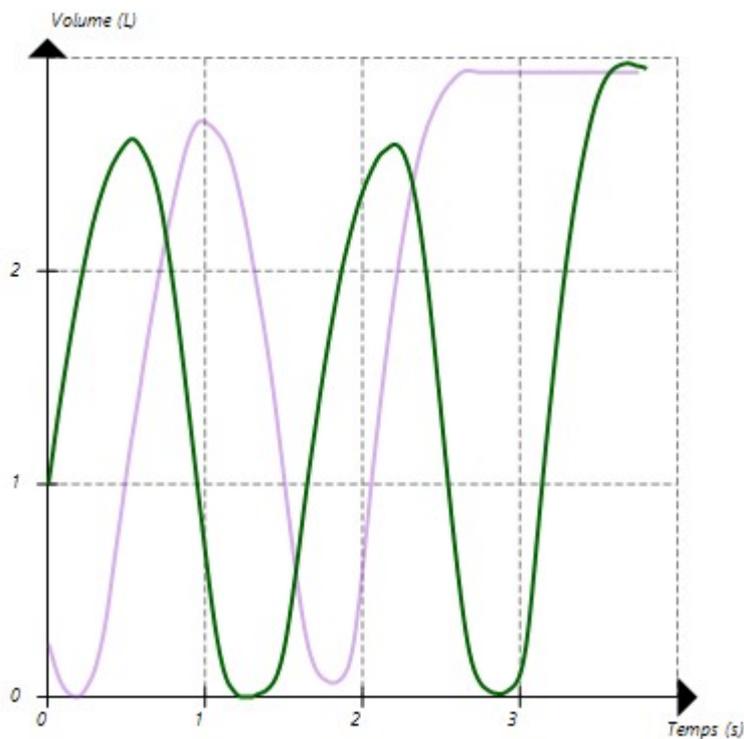

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,88 L	2,96 L	3,91 L	75,70 %
VEMS	2,88 L	2,96 L	3,28 L	90,24 %
DEP	7,29 L/s	8,05 L/s	8,54 L/s	94,26 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	83,39 %	119,92 %
Durée d'expiration	0,85 s	0,80 s	-	
DEMM	5,89 L/s	6,73 L/s	3,71 L/s	181,40 %
DEMM/CVF	2,05 s-1	2,27 s-1	0,95 s-1	238,95 %
DE75	7,08 L/s	7,74 L/s	-	
DE50	5,97 L/s	6,97 L/s	-	
DE25	4,20 L/s	4,94 L/s	-	