

<b>Nom</b> HABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> PEPE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 07/01/2000	<b>Profession</b> INTERPRET
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 375	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédits sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 24,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 53 %

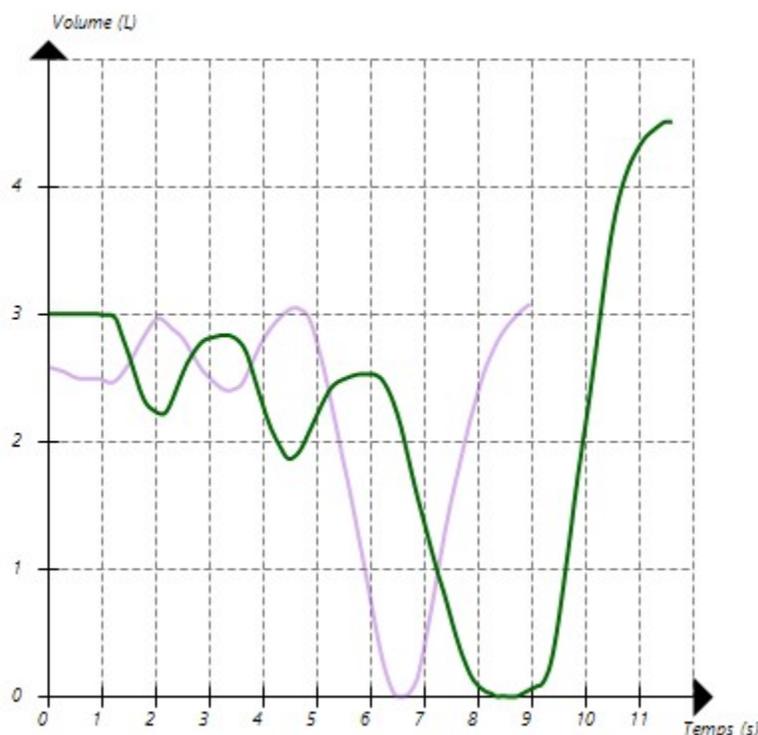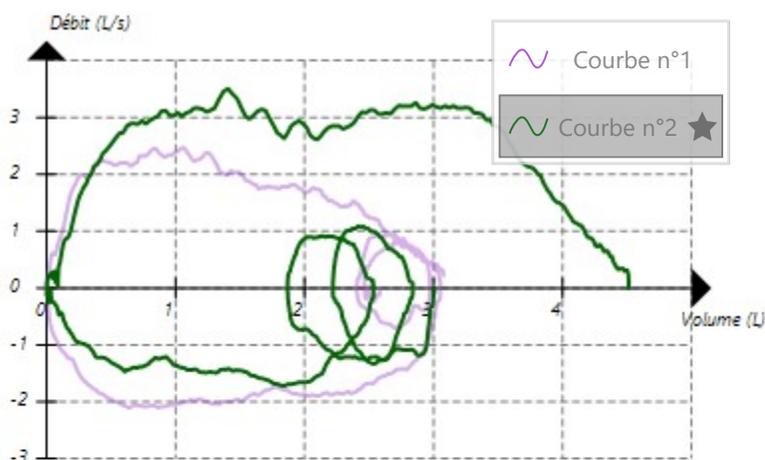

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,09 L	4,52 L	5,28 L	85,61 %
VEMS	2,16 L	3,22 L	4,43 L	72,69 %
DEP	2,54 L/s	3,52 L/s	-	
VEMS/ CVF	69,90 %	71,24 %	84,22 %	84,59 %
Durée d'expiration	2,44 s	3,00 s	-	
DEMM	1,98 L/s	3,11 L/s	4,77 L/s	65,20 %
DEMM/ CVF	0,64 s-1	0,69 s-1	0,90 s-1	76,67 %
DE75	2,32 L/s	3,15 L/s	-	
DE50	1,88 L/s	2,82 L/s	-	
DE25	1,45 L/s	3,01 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: