

<b>Nom LOUA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom FASSOU MORIBA THOMAS</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 10/06/1992</b>	<b>Profession MECANICIEN</b>
<b>Age 32 Ans</b>	<b>Entreprise COVEC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 428</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 175 cm</b>	<b>Groupe ethnique Caucasien</b>
<b>Poids 61 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur admin admin</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 64 %

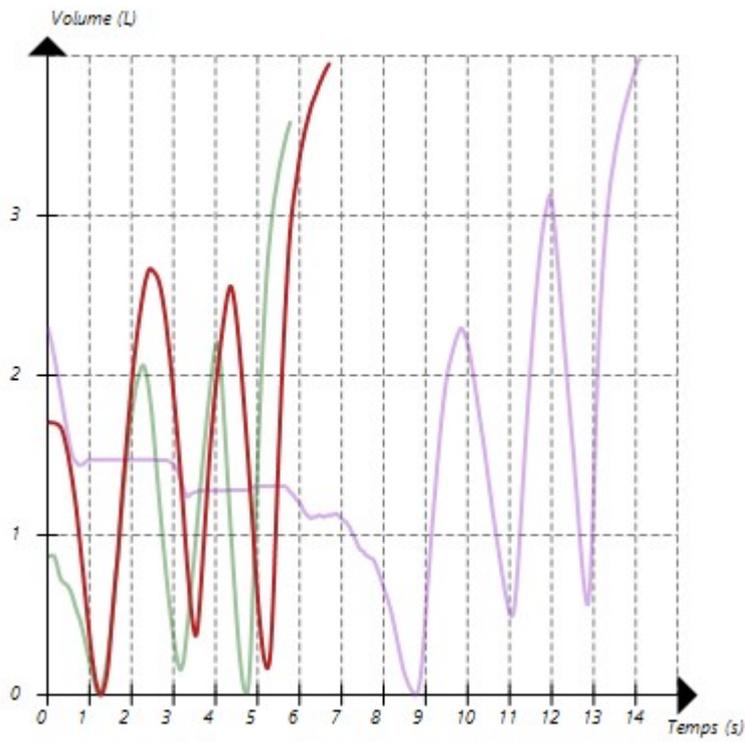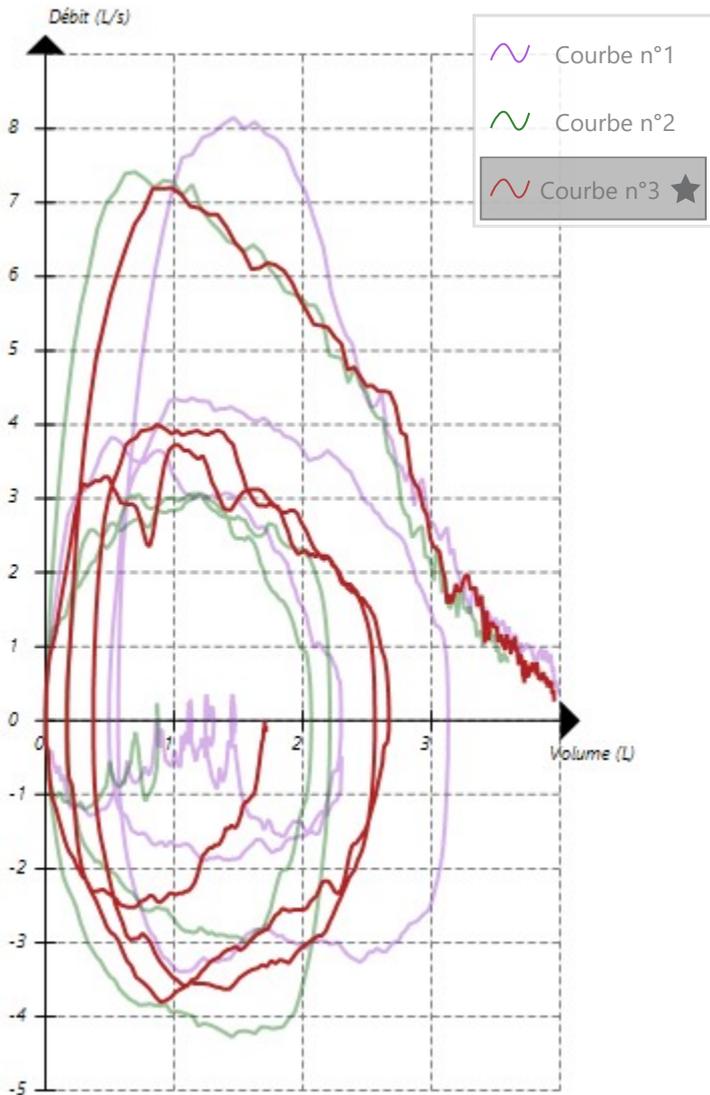

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,43 L	3,59 L	3,79 L	5,26 L	72,05 %
VEMS	3,28 L	3,59 L	3,54 L	4,28 L	82,71 %
DEP	8,25 L/s	7,44 L/s	7,28 L/s	10,01 L/s	72,73 %
VEMS/CVF	95,63 %	100,00 %	93,40 %	81,45 %	114,67 %
Durée d'expiration	1,27 s	1,06 s	1,50 s	-	
DEMM	4,90 L/s	5,74 L/s	5,14 L/s	4,27 L/s	120,37 %
DEMM/CVF	1,43 s-1	1,60 s-1	1,36 s-1	0,81 s-1	167,90 %
DE75	8,20 L/s	7,31 L/s	6,95 L/s	-	
DE50	5,43 L/s	5,89 L/s	5,40 L/s	-	
DE25	2,36 L/s	3,29 L/s	2,50 L/s	-	