



<b>Nom</b> DELAMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BERNARD	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/09/1986	<b>Profession</b> FERRAILLEIR
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 129	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 36 %

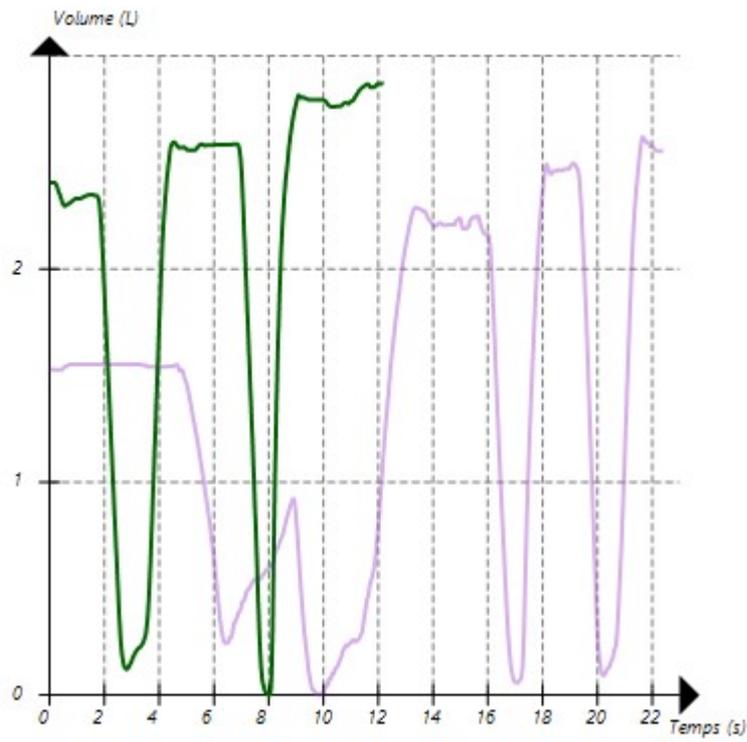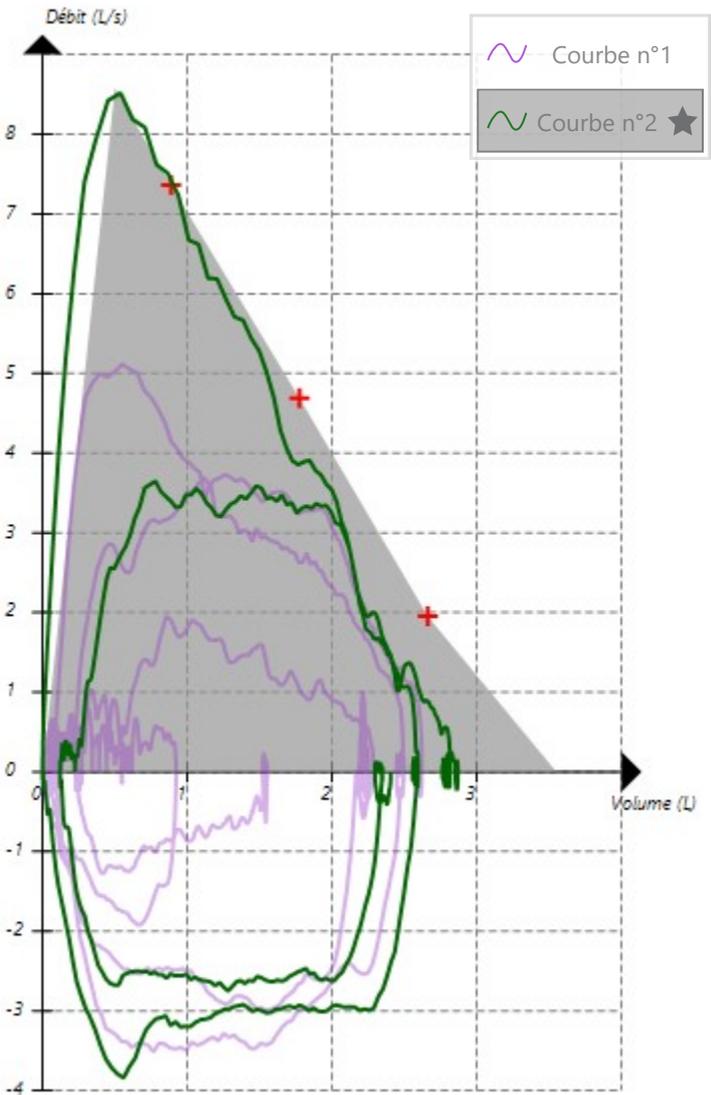

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,43 L	2,82 L	3,55 L	79,44 %
VEMS	2,43 L	2,82 L	3,00 L	94,00 %
DEP	5,24 L/s	8,63 L/s	8,58 L/s	100,58 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	80,59 %	124,08 %
Durée d'expiration	1,06 s	1,06 s	-	
DEMM	3,39 L/s	5,12 L/s	4,28 L/s	119,63 %
DEMM/CVF	1,40 s-1	1,82 s-1	1,05 s-1	173,33 %
DE75	4,75 L/s	8,13 L/s	7,36 L/s	110,46 %
DE50	3,19 L/s	5,43 L/s	4,69 L/s	115,78 %
DE25	2,65 L/s	2,84 L/s	1,95 L/s	145,64 %