

<b>Nom</b> TOUARO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> WELEWOI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 420	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 63 %

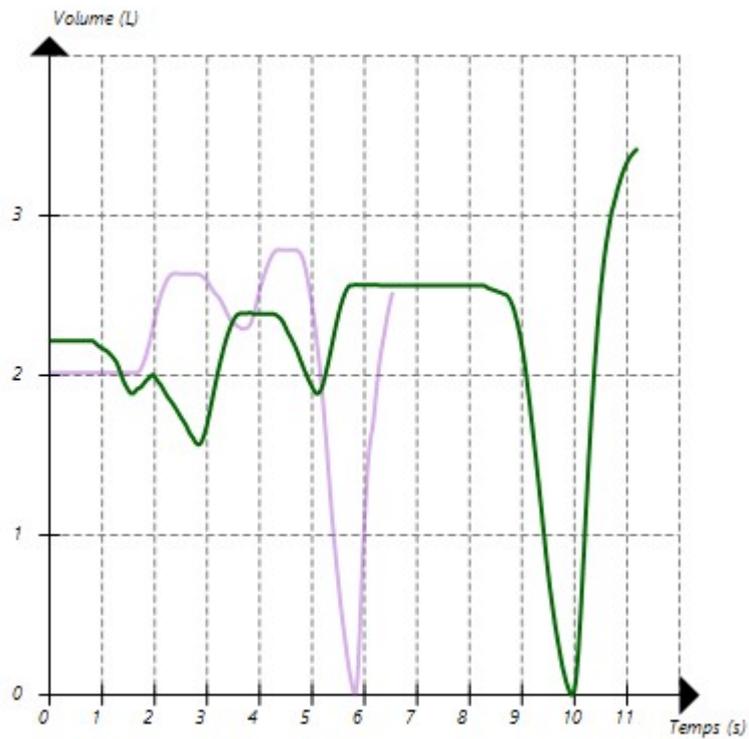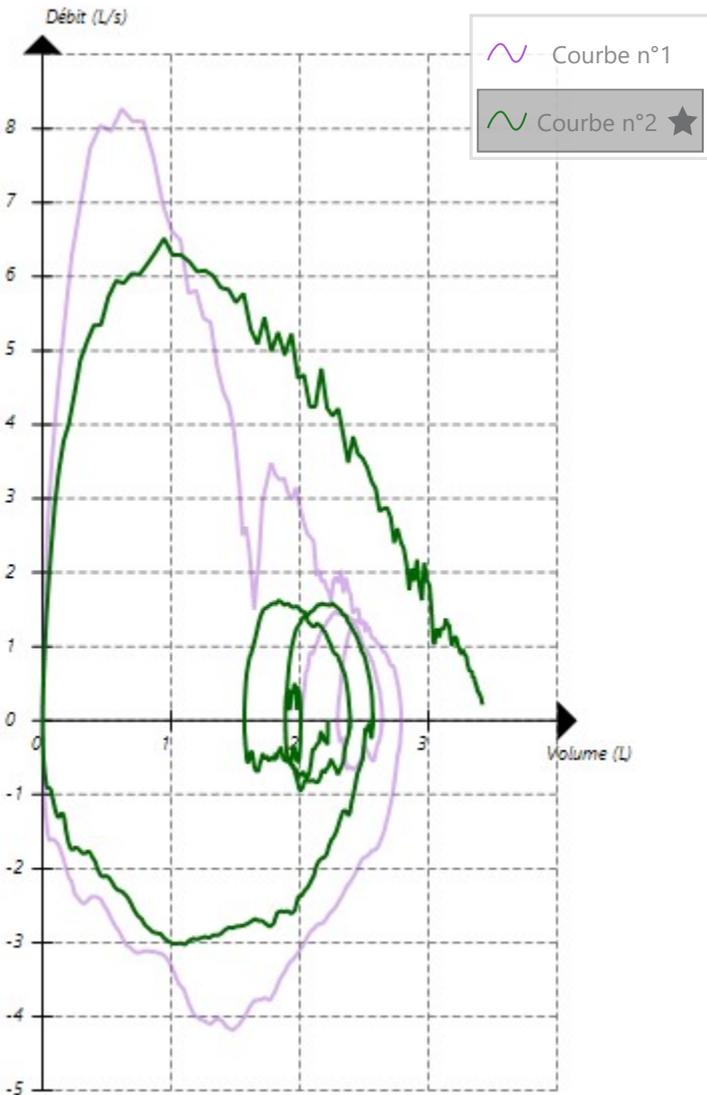

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,53 L	3,42 L	3,98 L	85,93 %
VEMS	2,53 L	3,36 L	3,30 L	101,82 %
DEP	8,39 L/s	6,95 L/s	8,61 L/s	80,72 %
VEMS/CVF	100,00 %	98,25 %	82,48 %	119,12 %
Durée d'expiration	0,73 s	1,27 s	-	
DEMM	4,44 L/s	5,08 L/s	3,60 L/s	141,11 %
DEMM/CVF	1,75 s-1	1,49 s-1	0,90 s-1	165,56 %
DE75	8,37 L/s	6,14 L/s	-	
DE50	5,21 L/s	5,40 L/s	-	
DE25	2,86 L/s	3,04 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: