



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/07/1983	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 40 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 61	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 30 %

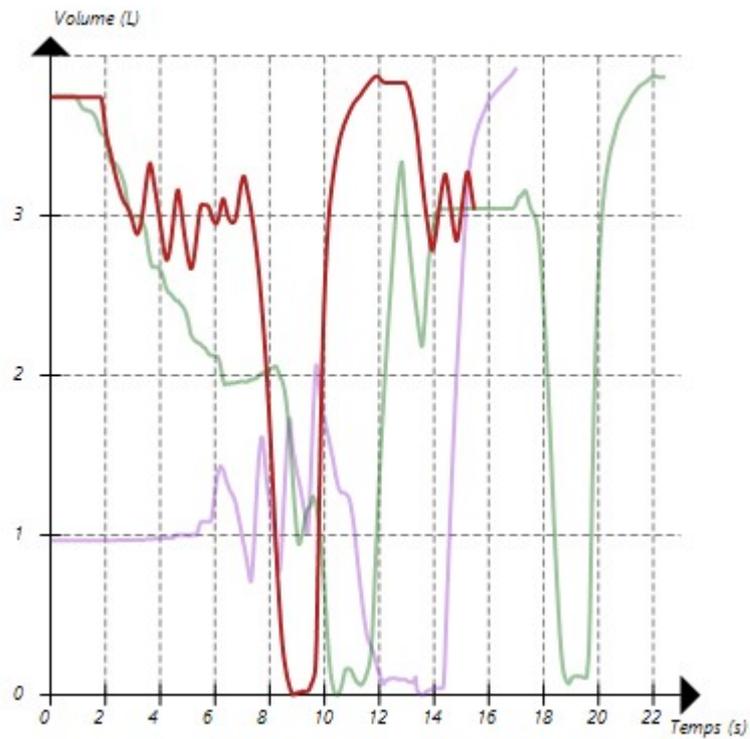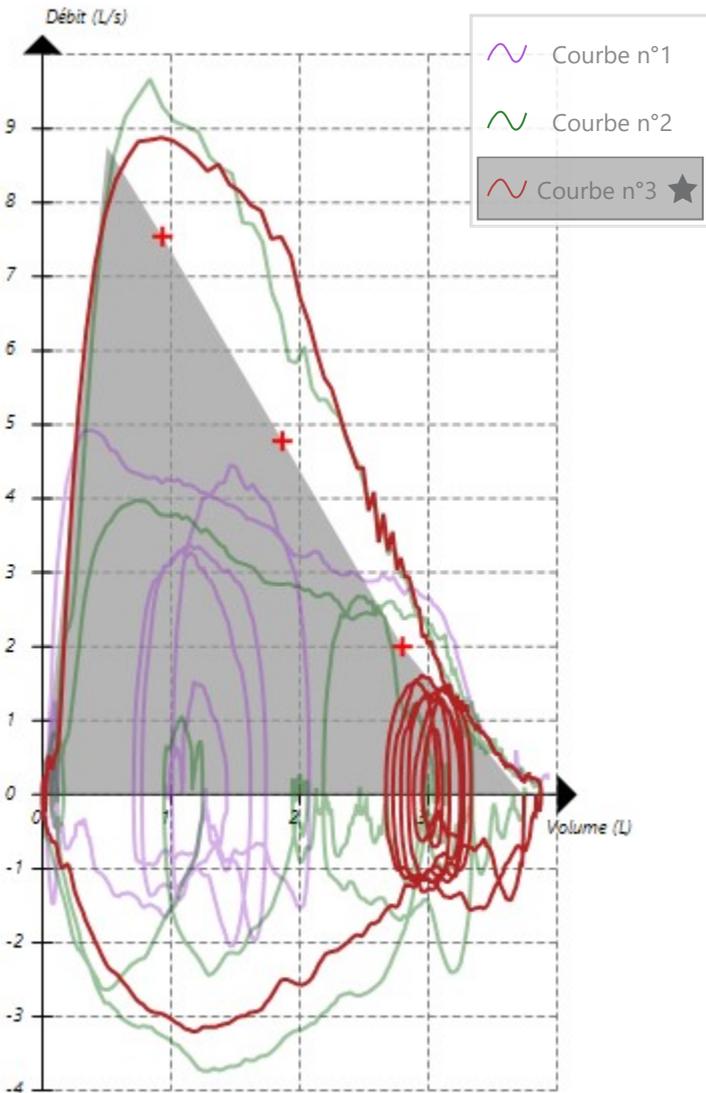

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,93 L	3,77 L	3,85 L	3,73 L	103,22 %
VEMS	3,36 L	3,43 L	3,52 L	3,11 L	113,18 %
DEP	4,98 L/s	9,96 L/s	8,98 L/s	8,76 L/s	102,51 %
VEMS/ CVF	85,50 %	90,98 %	91,43 %	80,05 %	114,22 %
Durée d'expiration	3,46 s	2,53 s	2,57 s	-	
DEMM	3,42 L/s	5,38 L/s	5,73 L/s	4,24 L/s	135,14 %
DEMM/ CVF	0,87 s-1	1,43 s-1	1,49 s-1	0,99 s-1	150,51 %
DE75	4,23 L/s	9,16 L/s	8,90 L/s	7,54 L/s	118,04 %
DE50	3,26 L/s	5,97 L/s	7,16 L/s	4,78 L/s	149,79 %
DE25	2,65 L/s	2,38 L/s	2,44 L/s	2,00 L/s	122,00 %