

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/08/1984	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 84	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 36 %

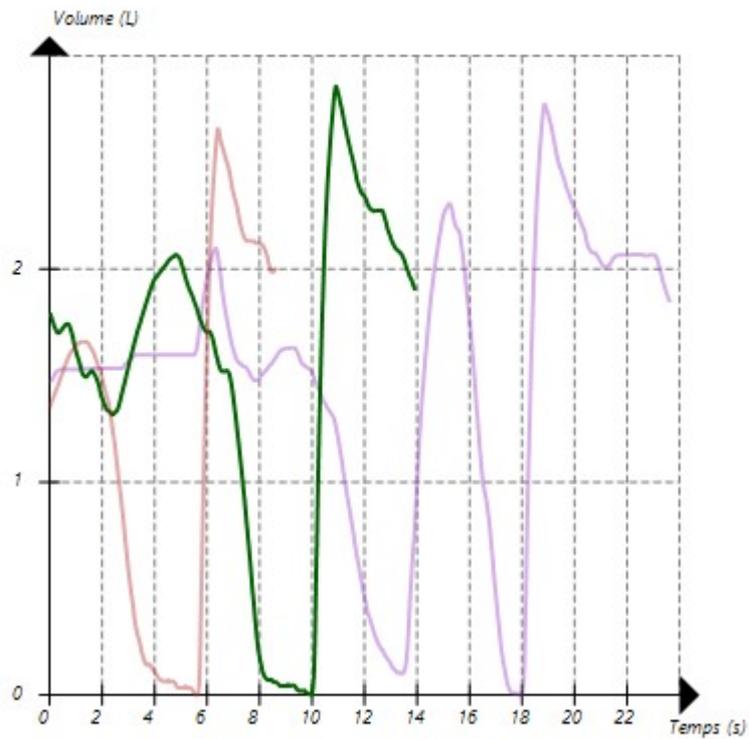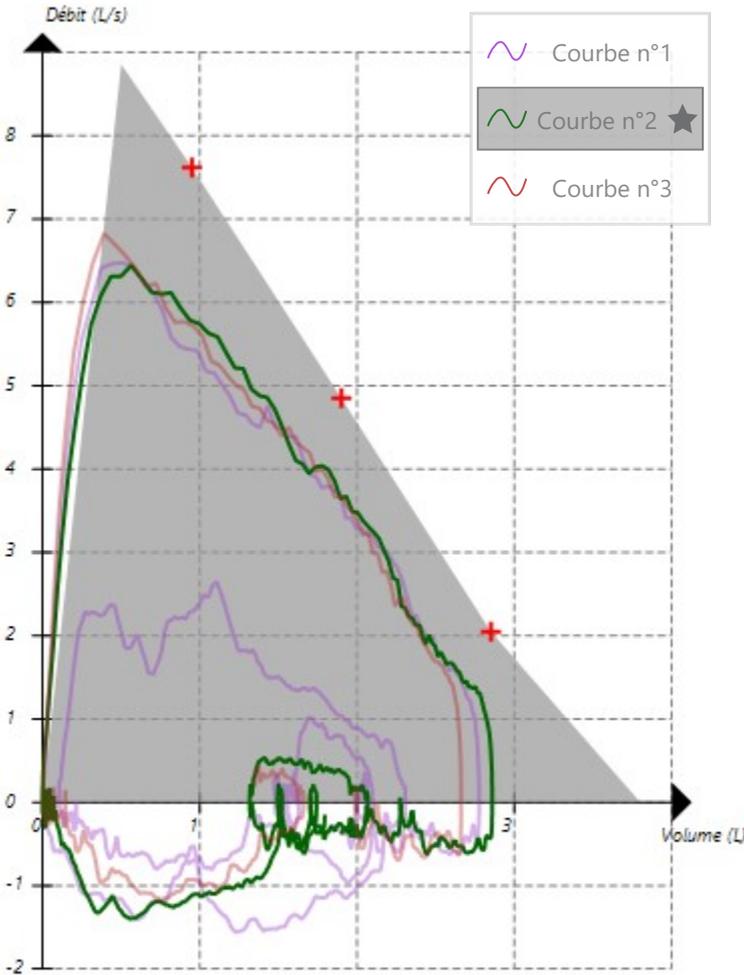

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,77 L	2,86 L	2,66 L	3,80 L	75,26 %
VEMS	2,77 L	2,86 L	2,66 L	3,18 L	89,94 %
DEP	6,60 L/s	6,50 L/s	6,90 L/s	8,86 L/s	73,36 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,23 %	124,64 %
Durée d'expiration	0,92 s	0,94 s	0,84 s	-	
DEMM	4,53 L/s	4,64 L/s	4,80 L/s	4,31 L/s	107,66 %
DEMM/CVF	1,64 s-1	1,62 s-1	1,80 s-1	0,99 s-1	163,64 %
DE75	6,12 L/s	6,26 L/s	6,19 L/s	7,62 L/s	82,15 %
DE50	4,51 L/s	4,84 L/s	4,74 L/s	4,85 L/s	99,79 %
DE25	3,20 L/s	3,14 L/s	3,45 L/s	2,05 L/s	153,17 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: