



<b>Nom</b> SAGNO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 26/07/1963	<b>Profession</b> OPERATEUR GRADEUR
<b>Age</b> 60 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 398	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 114 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 62 %

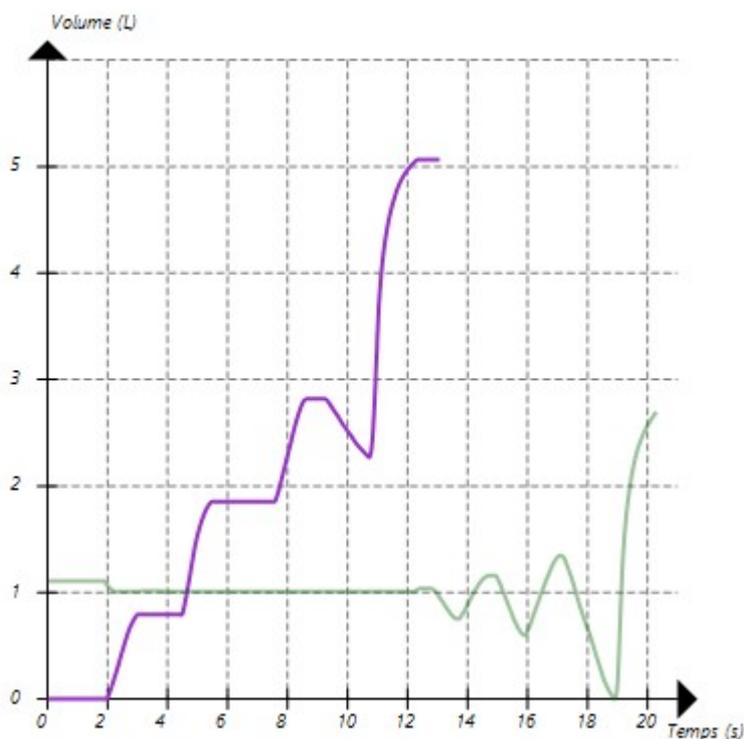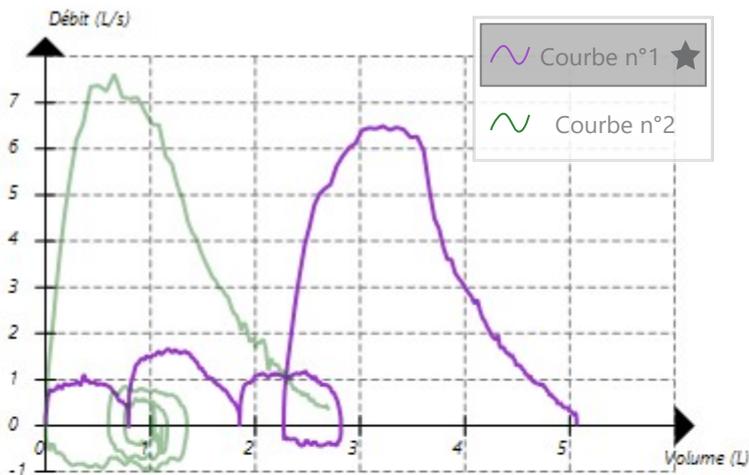

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,79 L	2,70 L	3,85 L	72,47 %
VEMS	2,62 L	2,57 L	3,00 L	87,33 %
DEP	6,70 L/s	7,66 L/s	8,15 L/s	82,21 %
VEMS/ CVF	93,91 %	95,19 %	78,27 %	119,98 %
Durée d'expiration	1,62 s	1,41 s	-	
DEMM	3,90 L/s	3,86 L/s	2,81 L/s	138,79 %
DEMM/ CVF	1,40 s-1	1,43 s-1	0,73 s-1	191,78 %
DE75	6,09 L/s	7,64 L/s	-	
DE50	5,03 L/s	4,50 L/s	-	
DE25	1,69 L/s	1,77 L/s	-	