

<b>Nom GAO</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom HONGHIN</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 21/02/1975</b>	<b>Profession</b> INGENIEUR
<b>Age 49 Ans</b>	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 2352</b>	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille 167 cm</b>	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids 68 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,6 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 100,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 47 %

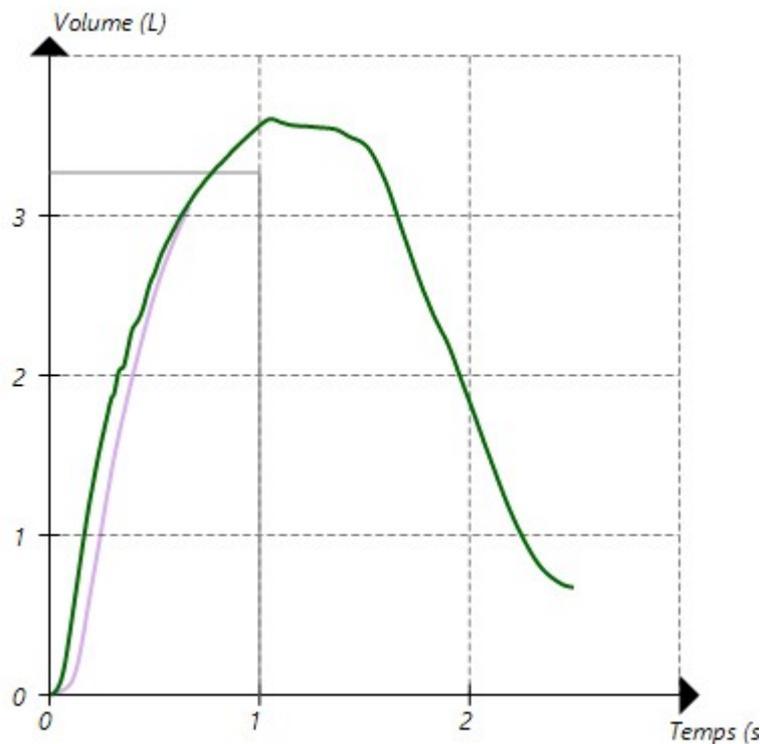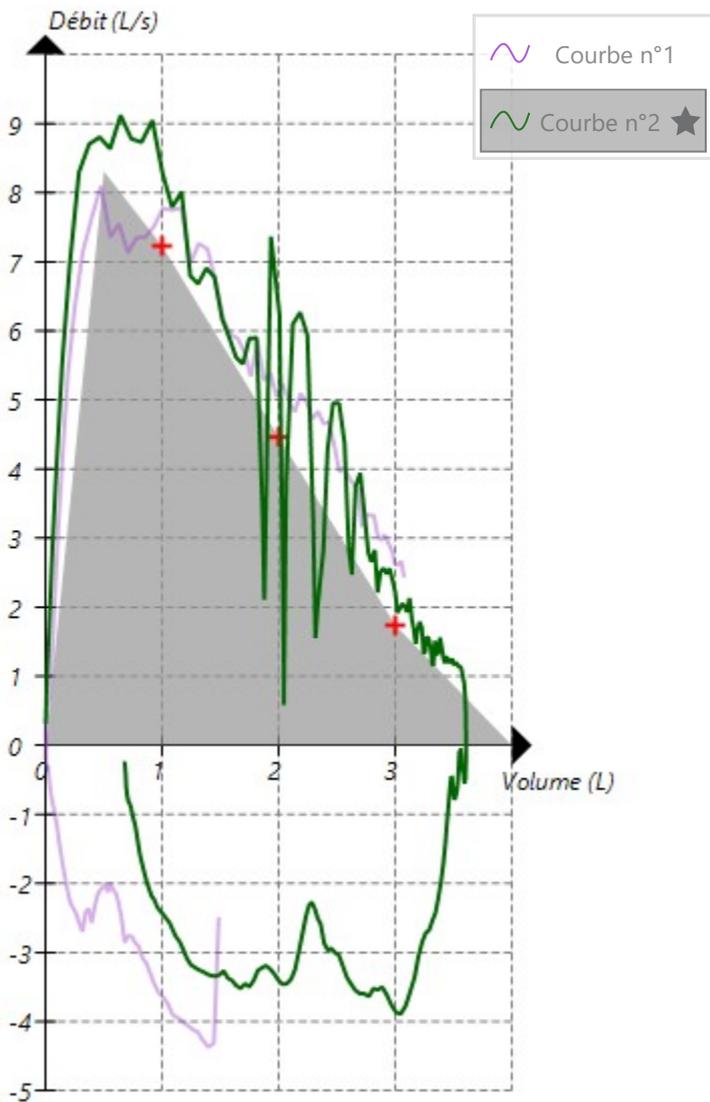

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,09 L	3,61 L	4,00 L	90,25 %
VEMS	3,09 L	3,61 L	3,27 L	110,40 %
DEP	8,17 L/s	9,31 L/s	8,31 L/s	112,03 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	78,44 %	127,49 %
Durée d'expiration	0,68 s	1,05 s	-	
DEMM	6,25 L/s	4,97 L/s	3,84 L/s	129,43 %
DEMM/CVF	2,02 s-1	1,38 s-1	0,96 s-1	143,75 %
DE75	7,70 L/s	9,27 L/s	7,23 L/s	128,22 %
DE50	6,00 L/s	5,79 L/s	4,46 L/s	129,82 %
DE25	4,98 L/s	3,88 L/s	1,74 L/s	222,99 %