


<b>Nom</b> THEORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALEXIS ZOWE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> OPERATEUR PICK UP
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 469	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 79 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 60 %

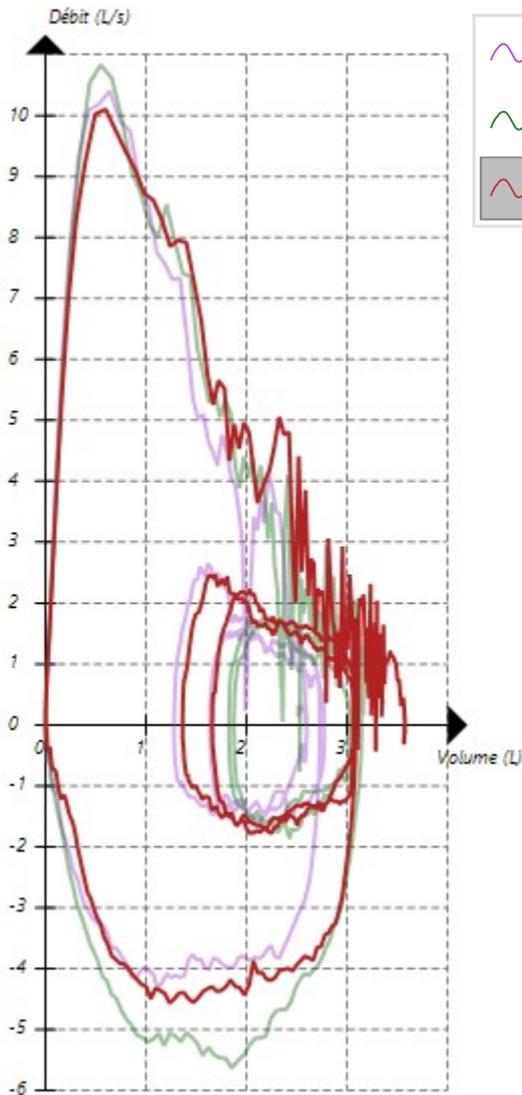

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2  
~ Courbe n°3 ★

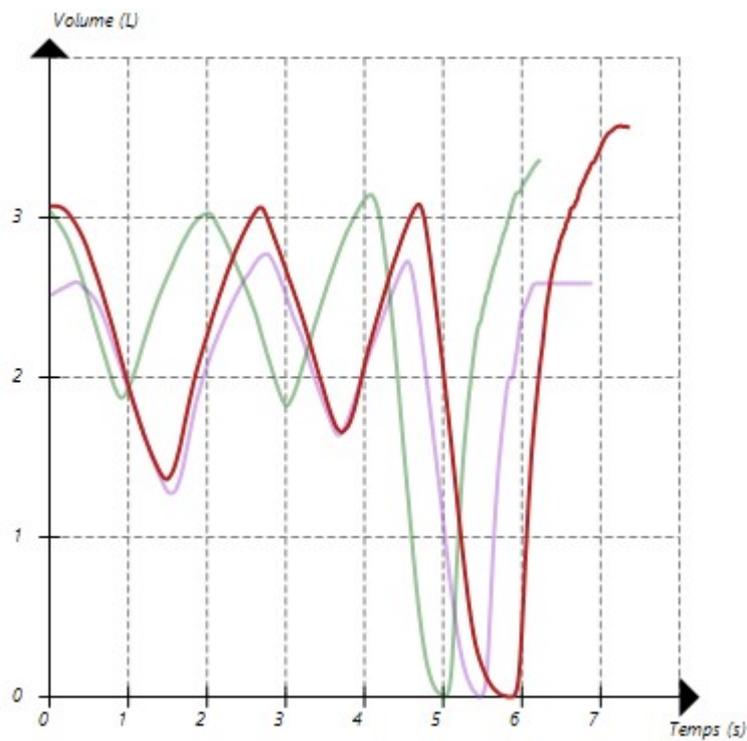

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,59 L	3,37 L	3,58 L	3,91 L	91,56 %
VEMS	2,59 L	3,27 L	3,39 L	3,28 L	103,35 %
DEP	10,58 L/s	10,95 L/s	10,25 L/s	8,54 L/s	120,02 %
VEMS/ CVF	100,00 %	97,03 %	94,69 %	83,39 %	113,55 %
Durée d'expiration	0,86 s	1,25 s	1,38 s	-	
DEMM	6,35 L/s	4,37 L/s	5,15 L/s	3,71 L/s	138,81 %
DEMM/ CVF	2,45 s-1	1,30 s-1	1,44 s-1	0,95 s-1	151,58 %
DE75	10,36 L/s	9,14 L/s	8,96 L/s	-	
DE50	7,45 L/s	5,50 L/s	5,45 L/s	-	
DE25	3,92 L/s	1,23 L/s	0,90 L/s	-	