



<b>Nom</b> TOURE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ADAMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/06/1989	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 460	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 60 %

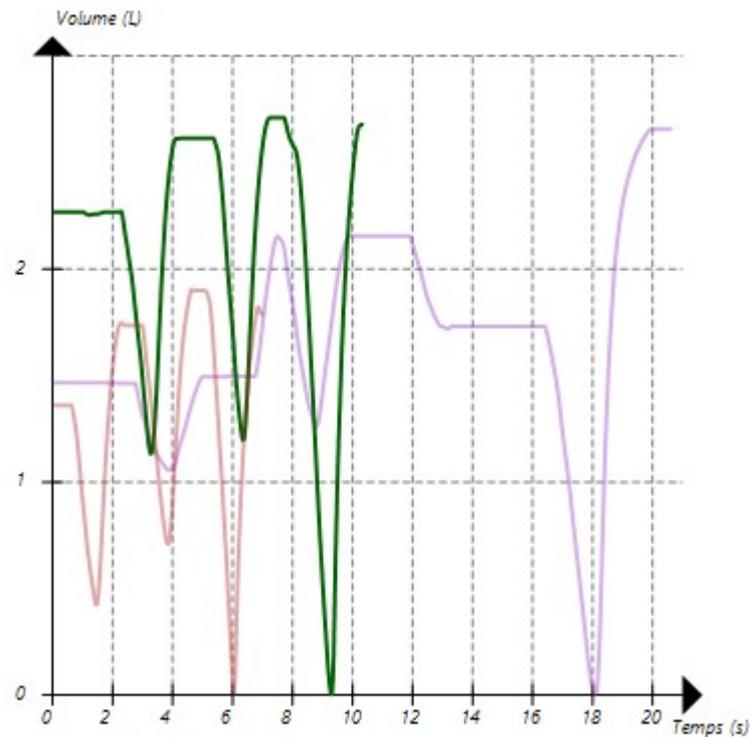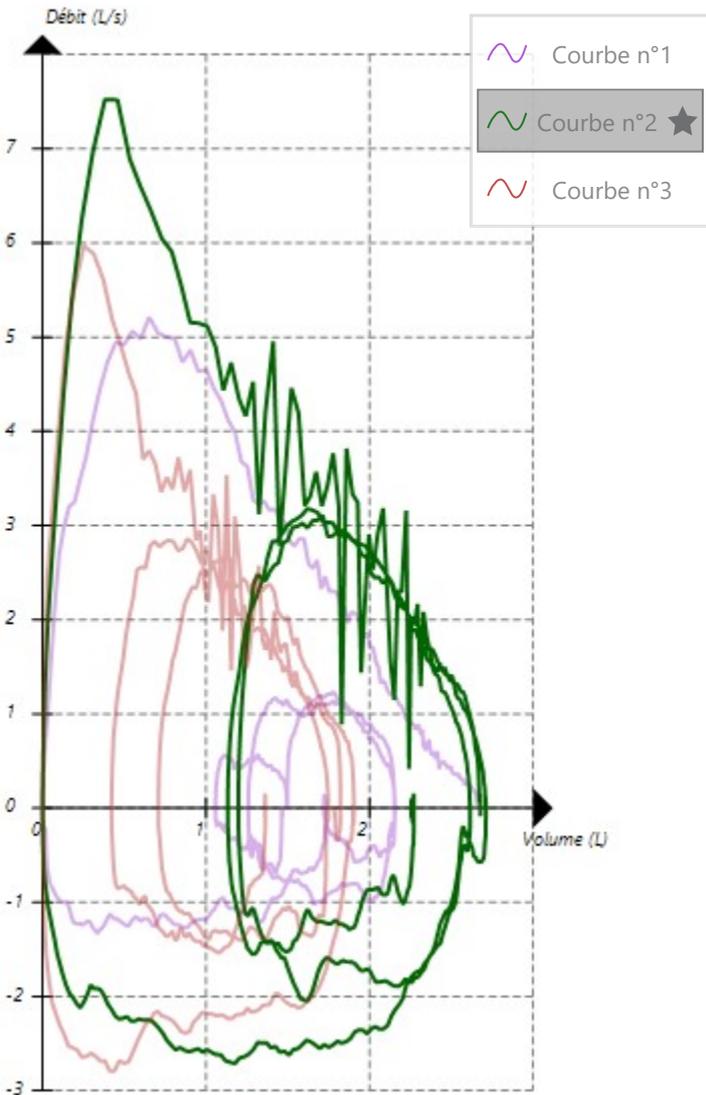

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,66 L	2,68 L	1,82 L	3,69 L	72,63 %
VEMS	2,43 L	2,68 L	1,82 L	3,08 L	87,01 %
DEP	5,27 L/s	7,64 L/s	6,02 L/s	8,15 L/s	93,74 %
VEMS/ CVF	91,35 %	100,00 %	100,00 %	82,84 %	120,71 %
Durée d'expiration	1,86 s	0,99 s	0,80 s	-	
DEMM	3,23 L/s	4,00 L/s	2,98 L/s	3,48 L/s	114,94 %
DEMM/ CVF	1,21 s-1	1,49 s-1	1,64 s-1	0,94 s-1	158,51 %
DE75	5,23 L/s	6,26 L/s	5,00 L/s	-	
DE50	3,20 L/s	3,54 L/s	4,23 L/s	-	
DE25	1,82 L/s	2,49 L/s	1,88 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: