


<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 11/11/1988	<b>Profession</b> OPERATEUR MINI BUS
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 0 512	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 62 %

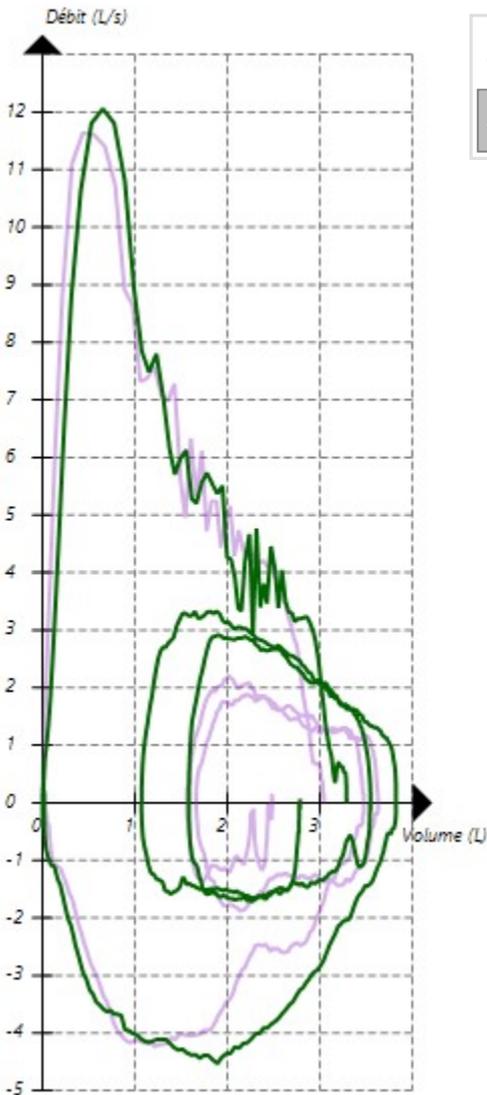

~ Courbe n°1  
 ~ Courbe n°2 ★

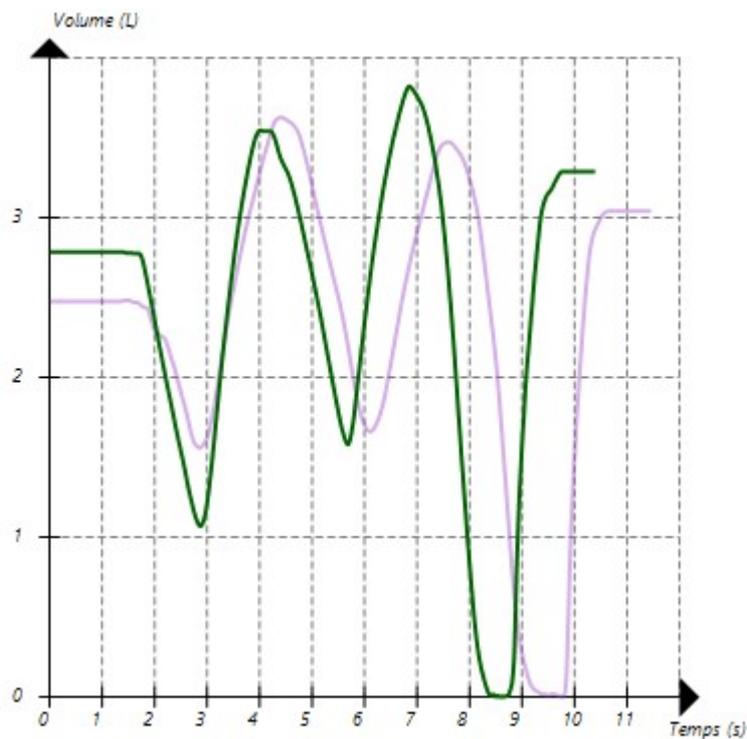

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,04 L	3,29 L	4,48 L	73,44 %
VEMS	3,04 L	3,29 L	3,71 L	88,68 %
DEP	11,75 L/s	12,15 L/s	9,46 L/s	128,44 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	82,84 %	120,71 %
Durée d'expiration	0,88 s	1,20 s	-	
DEMM	6,13 L/s	5,57 L/s	3,98 L/s	139,95 %
DEMM/CVF	2,02 s-1	1,69 s-1	0,89 s-1	189,89 %
DE75	10,68 L/s	11,56 L/s	-	
DE50	5,49 L/s	5,83 L/s	-	
DE25	3,84 L/s	4,44 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: