

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1982	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 42 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 18	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,9 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 42 %

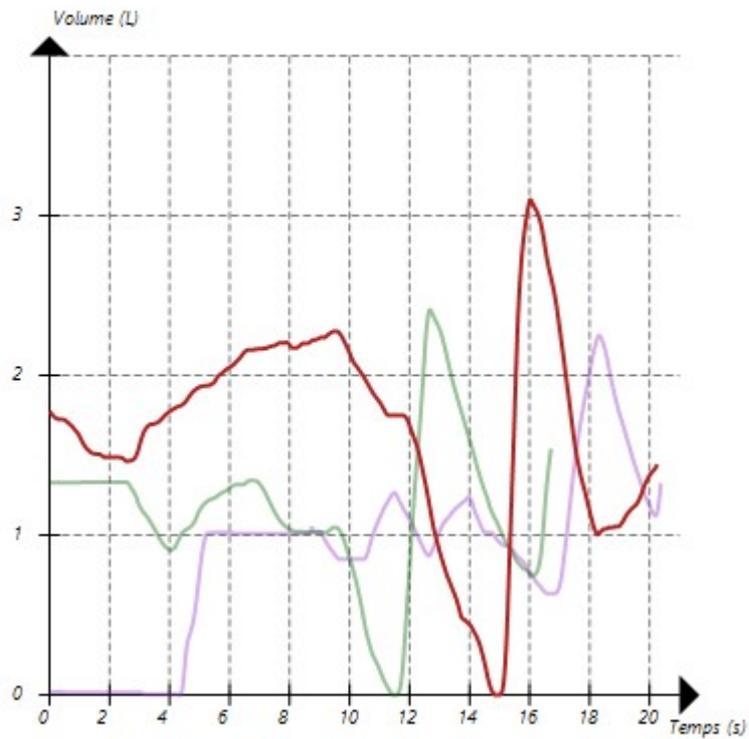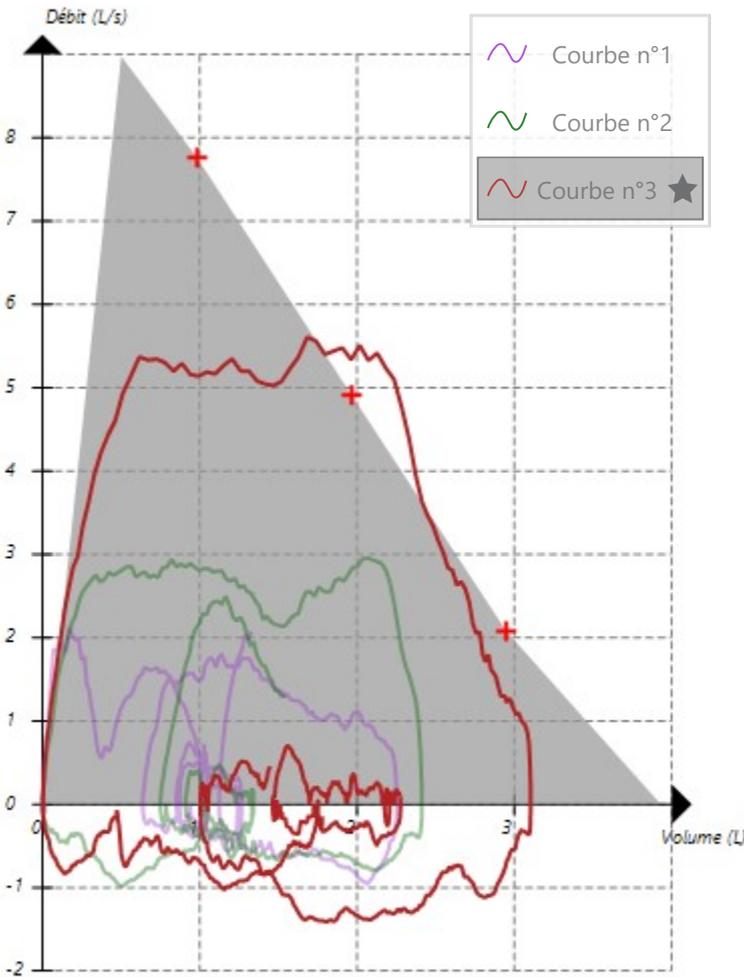

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,05 L	2,41 L	3,10 L	3,93 L	78,88 %
VEMS	1,02 L	2,41 L	3,10 L	3,25 L	95,38 %
DEP	2,39 L/s	2,99 L/s	5,64 L/s	8,98 L/s	62,81 %
VEMS/CVF	97,14 %	100,00 %	100,00 %	79,69 %	125,49 %
Durée d'expiration	4,40 s	1,21 s	1,13 s	-	
DEMM	1,12 L/s	2,63 L/s	5,35 L/s	4,26 L/s	125,59 %
DEMM/CVF	1,07 s-1	1,09 s-1	1,73 s-1	0,94 s-1	184,04 %
DE75	1,80 L/s	2,69 L/s	5,30 L/s	7,76 L/s	68,30 %
DE50	1,26 L/s	2,72 L/s	5,20 L/s	4,91 L/s	105,91 %
DE25	1,61 L/s	2,53 L/s	4,41 L/s	2,08 L/s	212,02 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: