

| | |
|--|--|
| Nom CAMARA | Adresse |
| Prénom LANCINE | Exposition |
| Né le 01/01/1999 | Profession |
| Age 25 Ans | Entreprise COVEC |
| Genre Masculin | Service MANOEUVRE |
| ID 697 | Fumeur Fumeur |
| Taille 172 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 63 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 51 %

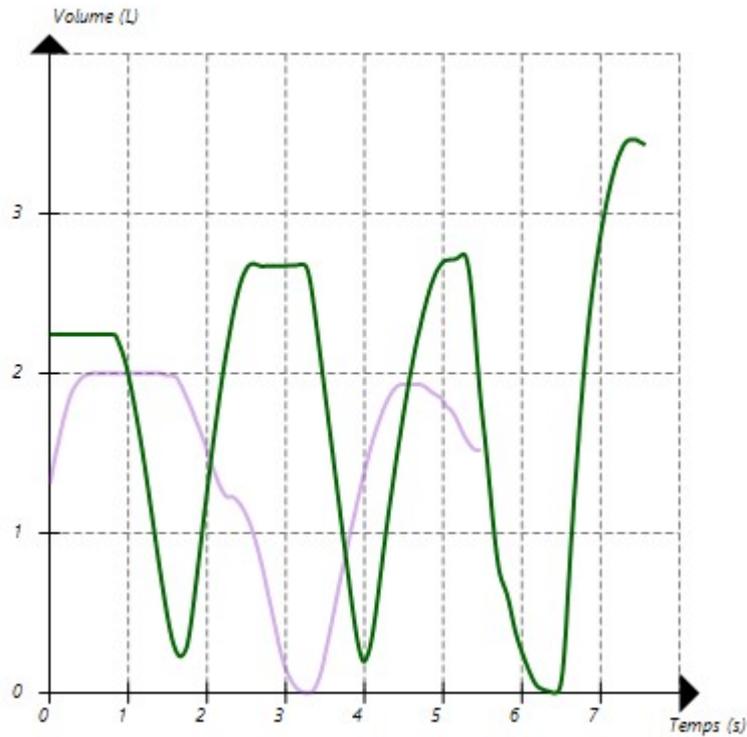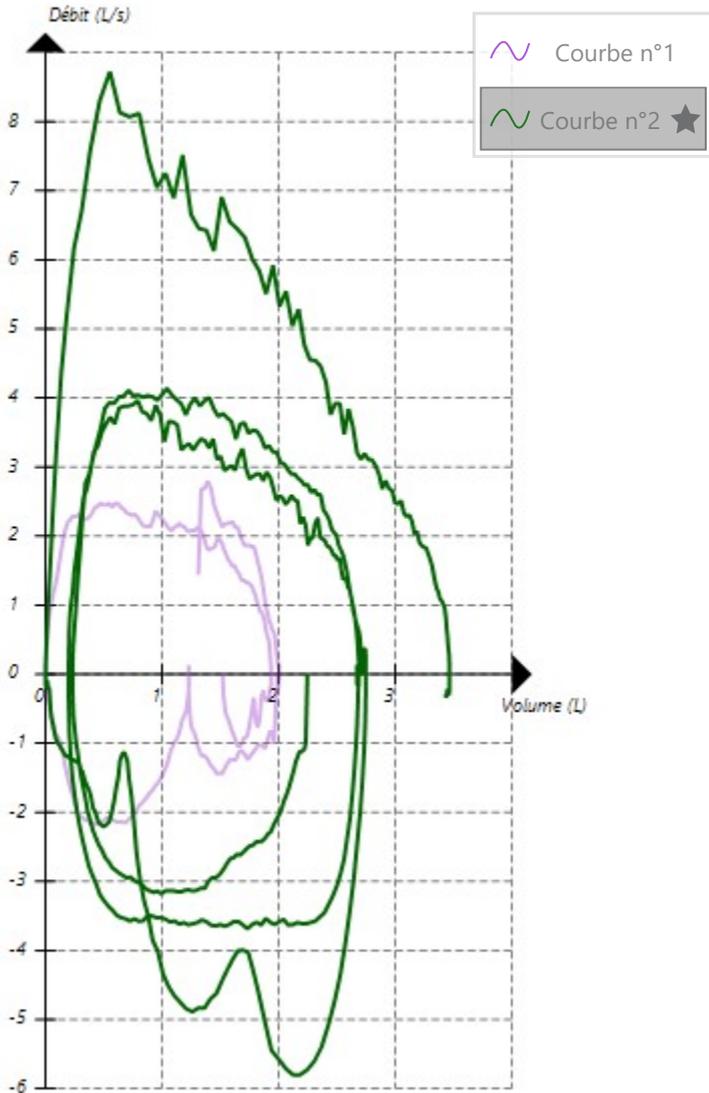

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 2,00 L | 3,47 L | 4,32 L | 80,32 % |
| VEMS | 2,00 L | 3,47 L | 3,67 L | 94,55 % |
| DEP | 2,84 L/s | 8,91 L/s | 9,29 L/s | 95,91 % |
| VEMS/CVF | 100,00 % | 100,00 % | 84,67 % | 118,11 % |
| Durée d'expiration | -2,71 s | 1,02 s | - | |
| DEMM | - | 5,74 L/s | 4,18 L/s | 137,32 % |
| DEMM/CVF | - | 1,65 s-1 | 0,97 s-1 | 170,10 % |
| DE75 | - | 7,45 L/s | - | |
| DE50 | - | 6,65 L/s | - | |
| DE25 | - | 3,92 L/s | - | |

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: