

<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZOUMANA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/02/1996	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 671	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,7 °C


Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 60 %

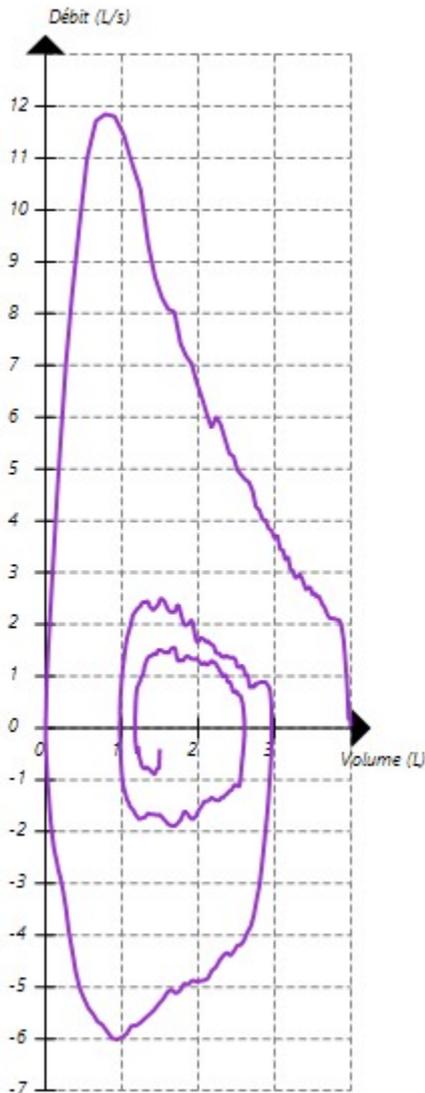

Courbe n°1 ★

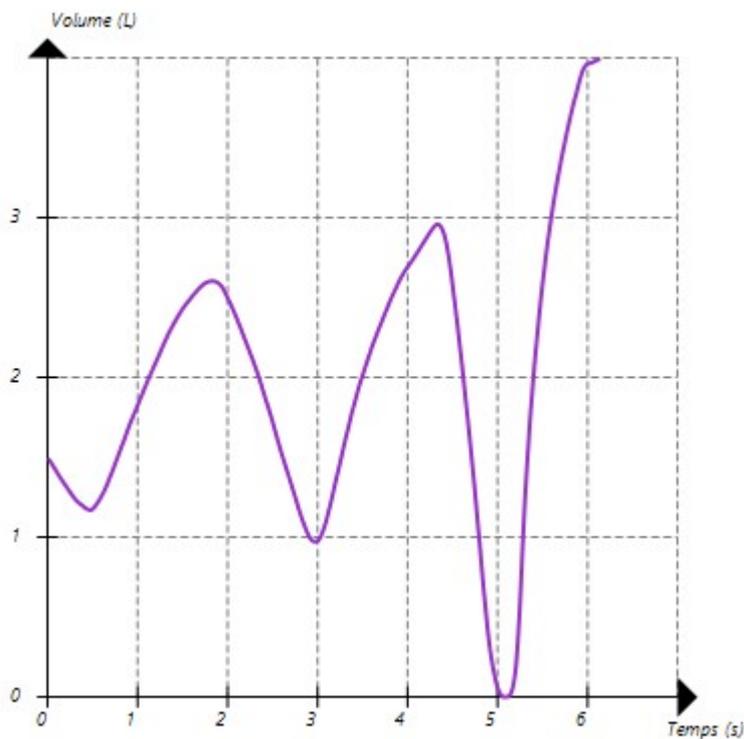

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,99 L	4,20 L	95,00 %
VEMS	3,99 L	3,55 L	112,39 %
DEP	12,13 L/s	9,08 L/s	133,59 %
VEMS/ CVF	100,00 %	84,12 %	118,88 %
Durée d'expiration	1,07 s	-	
DEMM	6,40 L/s	4,02 L/s	159,20 %
DEMM/ CVF	1,60 s-1	0,96 s-1	166,67 %
DE75	11,54 L/s	-	
DE50	6,31 L/s	-	
DE25	3,62 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: