



<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> NABY ISSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 17	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 42 %

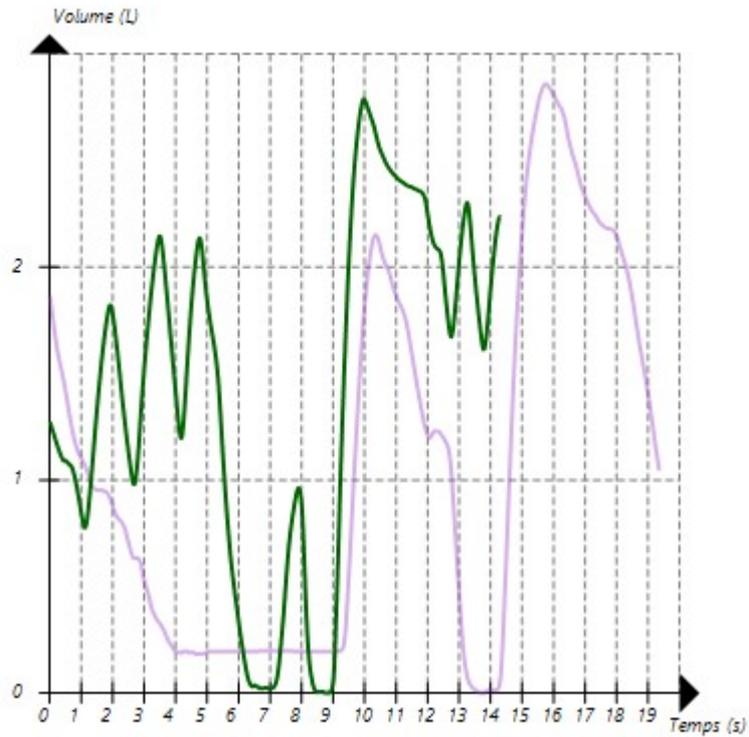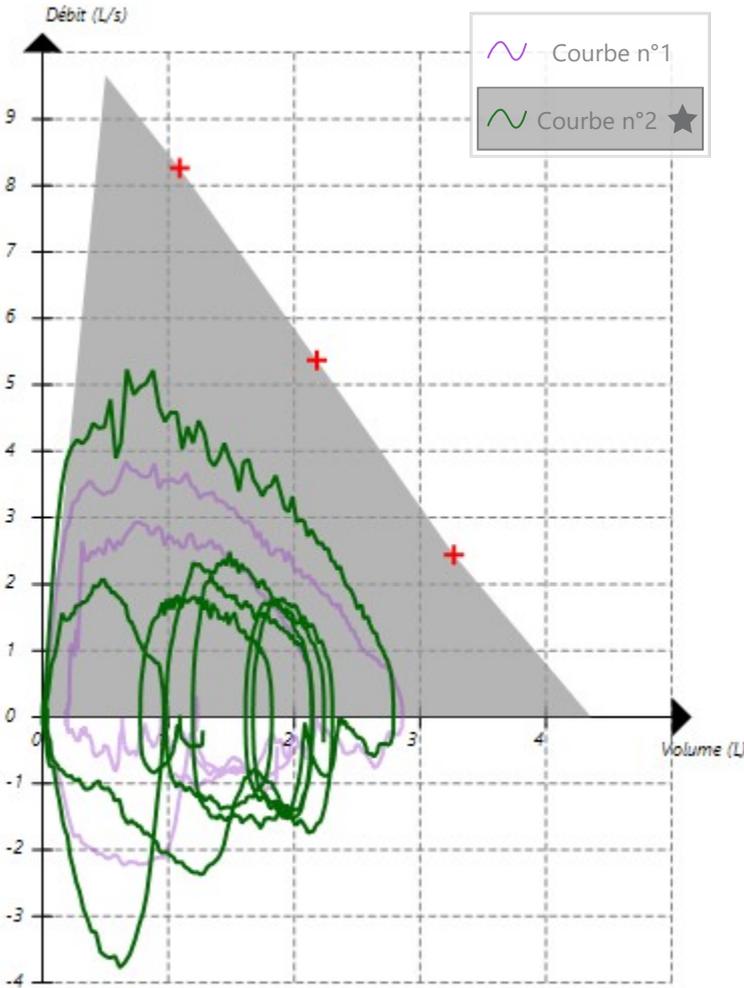

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,85 L	2,79 L	4,36 L	63,99 %
VEMS	2,62 L	2,79 L	3,65 L	76,44 %
DEP	3,95 L/s	5,99 L/s	9,66 L/s	62,01 %
VEMS/CVF	91,93 %	100,00 %	81,48 %	122,73 %
Durée d'expiration	1,67 s	1,16 s	-	
DEMM	3,03 L/s	3,98 L/s	4,76 L/s	83,61 %
DEMM/CVF	1,06 s-1	1,43 s-1	0,95 s-1	150,53 %
DE75	3,62 L/s	5,39 L/s	8,26 L/s	65,25 %
DE50	3,24 L/s	3,84 L/s	5,37 L/s	71,51 %
DE25	2,12 L/s	2,88 L/s	2,44 L/s	118,03 %