



<b>Nom</b> TOUARO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/10/1979	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 83	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 77 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,6 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 38 %

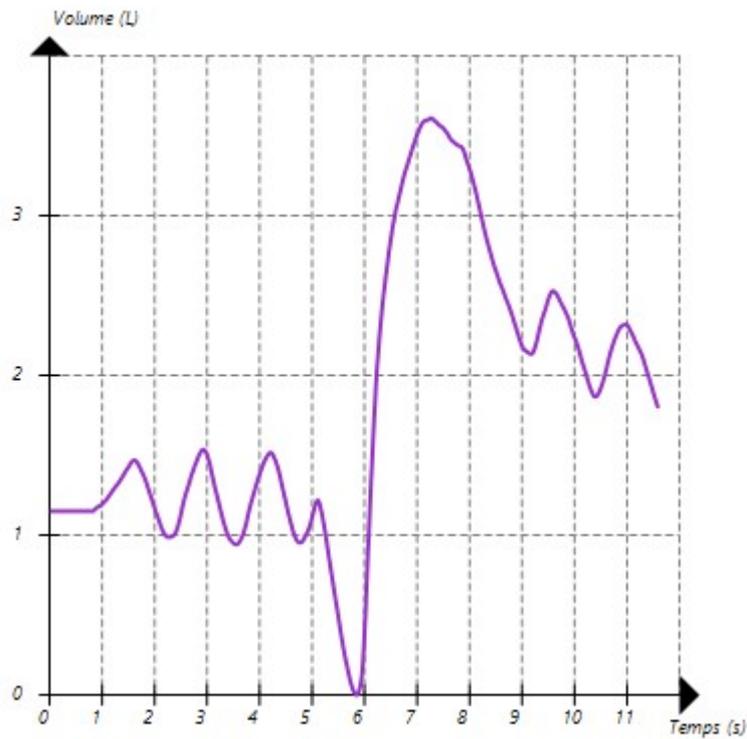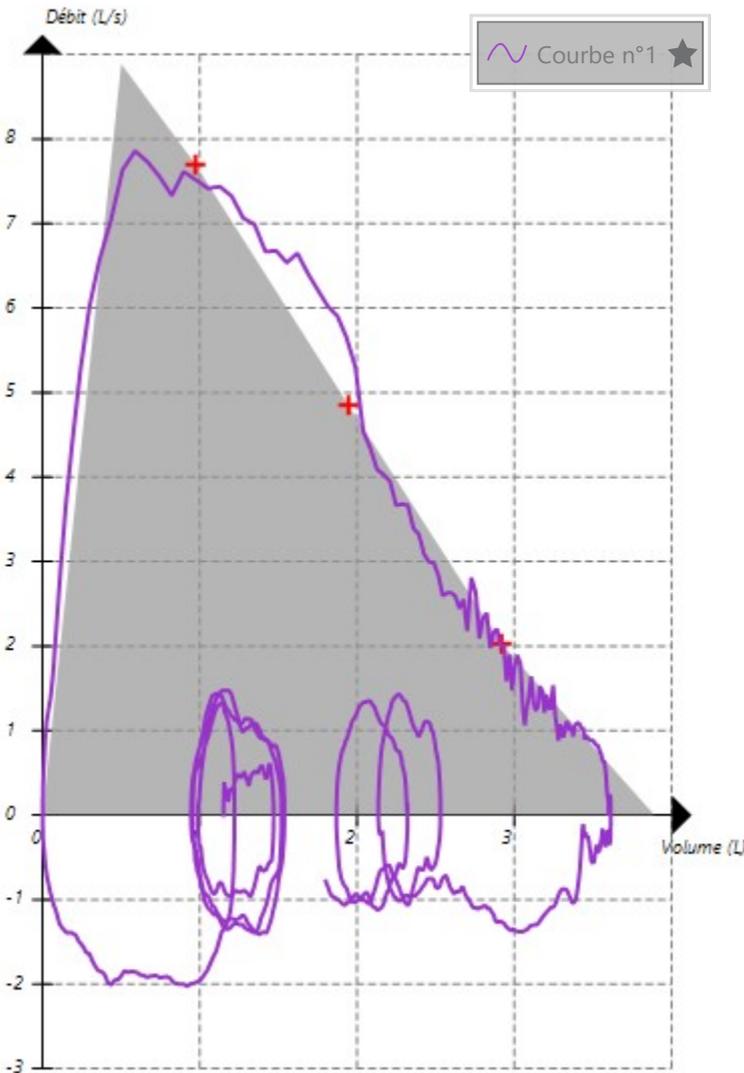

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,61 L	3,89 L	92,80 %
VEMS	3,45 L	3,19 L	108,15 %
DEP	7,97 L/s	8,89 L/s	89,65 %
VEMS/ CVF	95,57 %	79,33 %	120,47 %
Durée d'expiration	1,42 s	-	
DEMM	4,84 L/s	4,17 L/s	116,07 %
DEMM/ CVF	1,34 s-1	0,93 s-1	144,09 %
DE75	7,60 L/s	7,70 L/s	98,70 %
DE50	6,00 L/s	4,85 L/s	123,71 %
DE25	2,40 L/s	2,03 L/s	118,23 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: