

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> OPERATEUR EXCAVATEUR
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 527	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,5 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 63 %

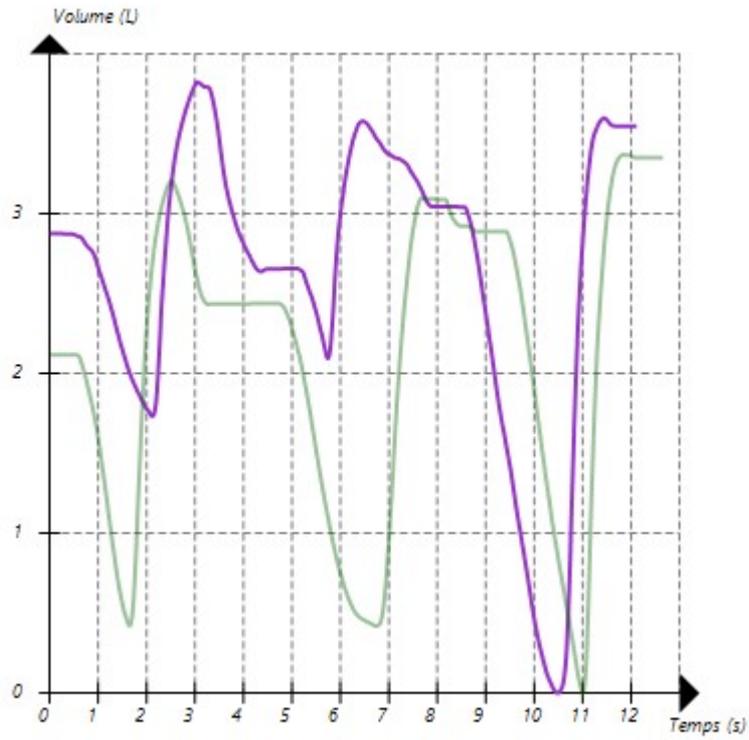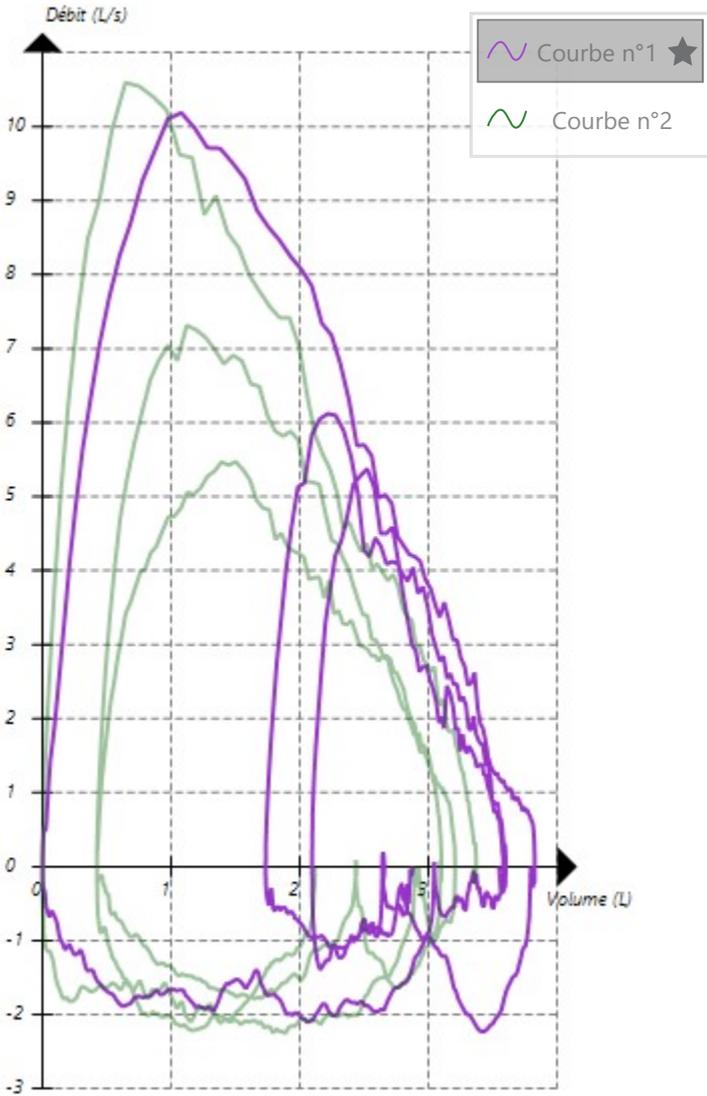

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,60 L	3,37 L	4,48 L	80,36 %
VEMS	3,60 L	3,37 L	3,74 L	96,26 %
DEP	10,24 L/s	10,73 L/s	9,48 L/s	108,02 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	83,39 %	119,92 %
Durée d'expiration	0,96 s	0,83 s	-	
DEMM	8,04 L/s	7,23 L/s	4,07 L/s	197,54 %
DEMM/CVF	2,23 s-1	2,15 s-1	0,91 s-1	245,05 %
DE75	9,84 L/s	10,31 L/s	-	
DE50	8,49 L/s	7,72 L/s	-	
DE25	4,89 L/s	4,60 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: