



| | |
|--|--|
| Nom GBELEMOU | Adresse |
| Prénom MICHEL | Exposition |
| Né le 01/01/1996 | Profession OPERATEUR PICK UP |
| Age 28 Ans | Entreprise COVEC |
| Genre Masculin | Service |
| ID 468 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 171 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 76 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 30,6 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 93,6 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 59 %

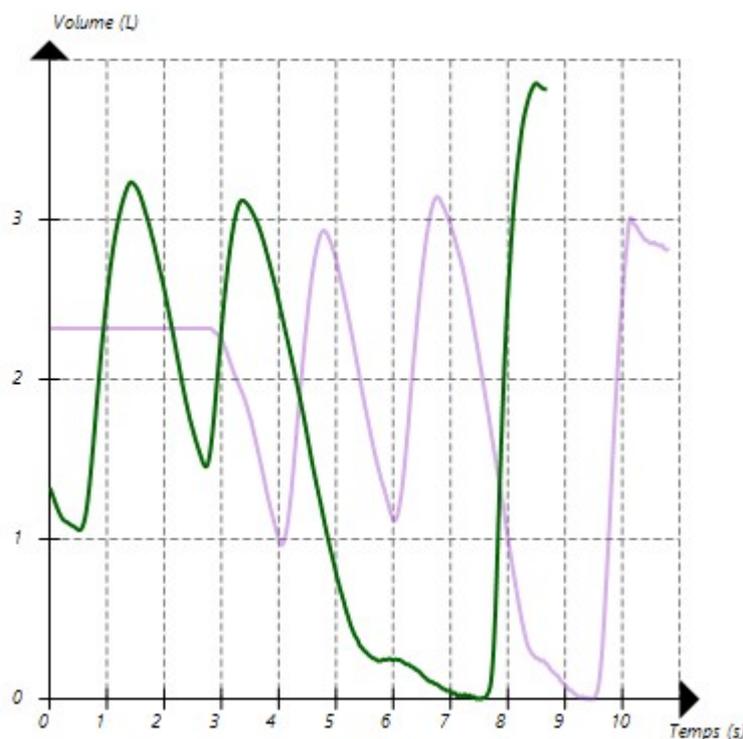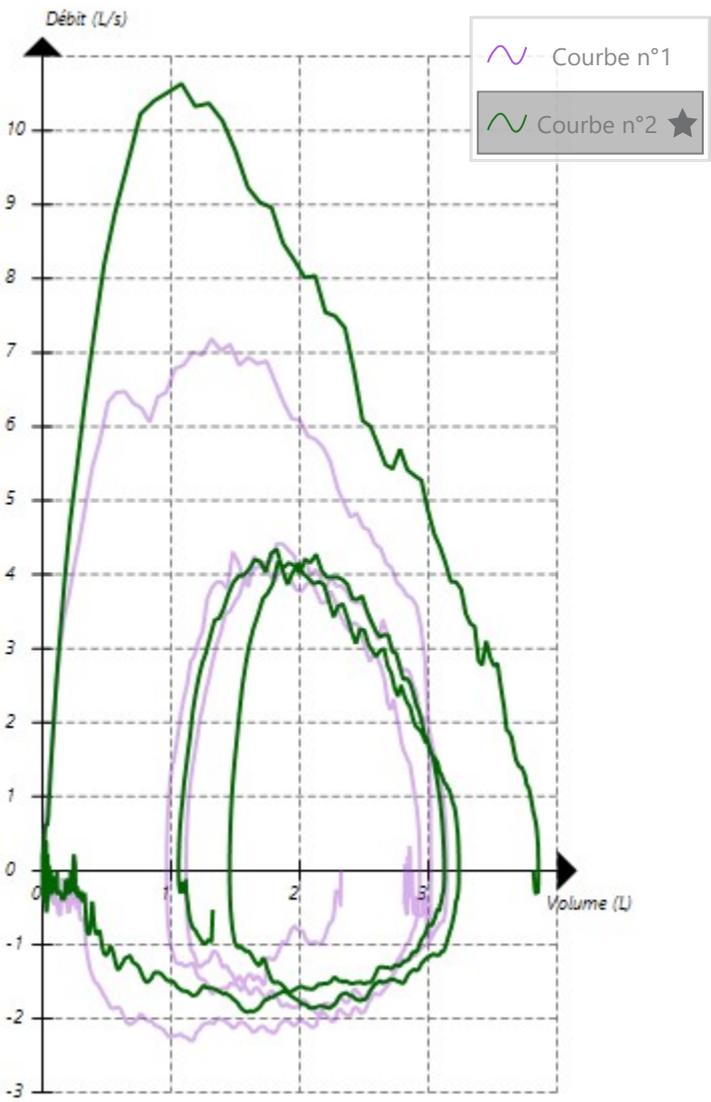

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| CVF | 3,02 L | 3,85 L | 4,20 L | 91,67 % |
| VEMS | 3,02 L | 3,85 L | 3,55 L | 108,45 % |
| DEP | 7,35 L/s | 10,66 L/s | 9,08 L/s | 117,40 % |
| VEMS/CVF | 100,00 % | 100,00 % | 84,12 % | 118,88 % |
| Durée d'expiration | 0,66 s | 0,96 s | - | |
| DEMM | 6,65 L/s | 8,00 L/s | 4,02 L/s | 199,00 % |
| DEMM/CVF | 2,20 s-1 | 2,08 s-1 | 0,96 s-1 | 216,67 % |
| DE75 | 6,37 L/s | 10,45 L/s | - | |
| DE50 | 6,76 L/s | 8,31 L/s | - | |
| DE25 | 5,21 L/s | 5,33 L/s | - | |