



<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom LONCENY</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 24/10/1993</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 30 Ans</b>	<b>Entreprise COVEC</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 16</b>	<b>Fumeur Ancien fumeur</b>
<b>Taille 188 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 64 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 2</b>
<b>Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA</b>	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 43 %

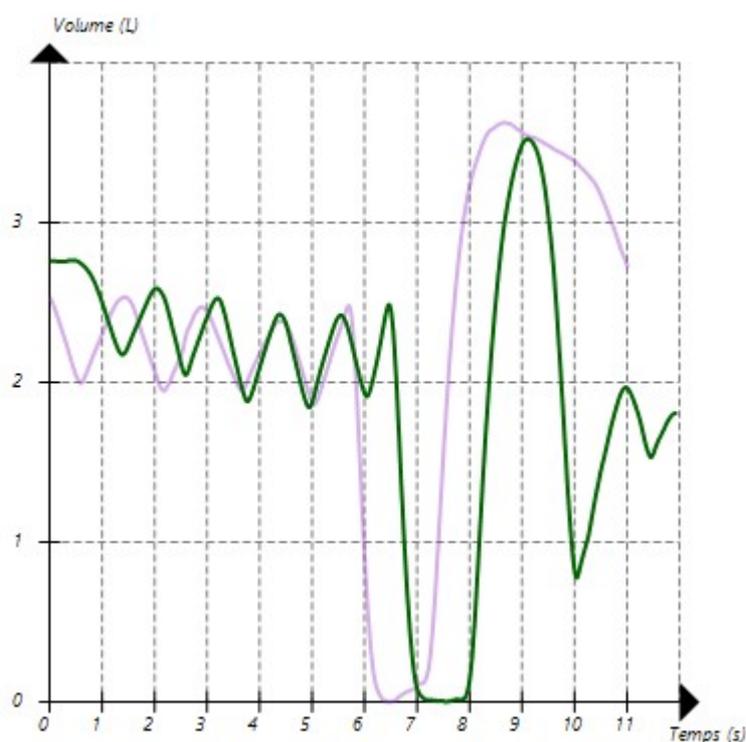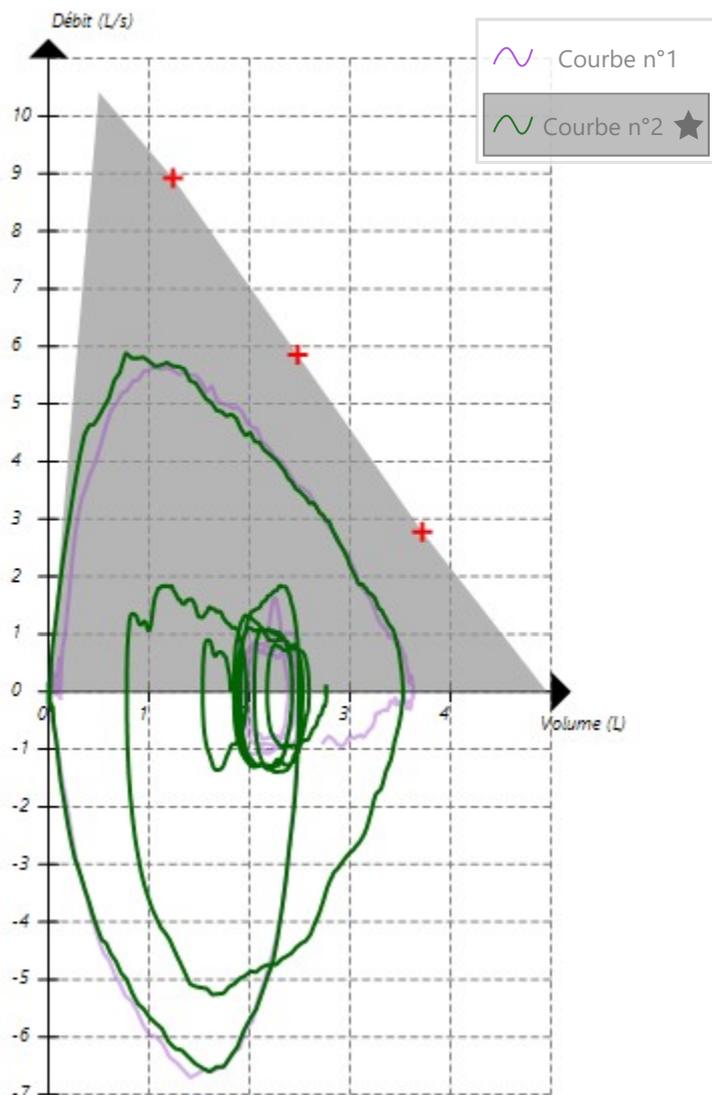

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,51 L	3,51 L	4,96 L	70,77 %
VEMS	3,38 L	3,49 L	4,11 L	84,91 %
DEP	5,68 L/s	5,96 L/s	10,42 L/s	57,20 %
VEMS/ CVF	96,30 %	99,43 %	81,84 %	121,49 %
Durée d'expiration	1,58 s	1,29 s	-	
DEMM	4,61 L/s	4,70 L/s	5,06 L/s	92,89 %
DEMM/ CVF	1,31 s-1	1,34 s-1	0,89 s-1	150,56 %
DE75	5,59 L/s	5,70 L/s	8,92 L/s	63,90 %
DE50	4,94 L/s	4,82 L/s	5,85 L/s	82,39 %
DE25	2,96 L/s	3,26 L/s	2,78 L/s	117,27 %