


<b>Nom</b> TRAORE <b>Prénom</b> SIDIKI <b>Né le</b> 01/01/1984 <b>Age</b> 40 Ans <b>Genre</b> Masculin <b>ID</b> 492 <b>Taille</b> 172 cm <b>Poids</b> 114 kg <b>Valeurs prédites</b> NHANES III <b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	<b>Adresse</b> <b>Exposition</b> <b>Profession</b> OPERATEUR DUMP TRUCK <b>Entreprise</b> COVEC <b>Service</b> <b>Fumeur</b> Non fumeur <b>Groupe ethnique</b> Origine africaine <b>Prescripteur:</b> <b>Smoking Pack Years</b> : 0
--	---




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 66 %

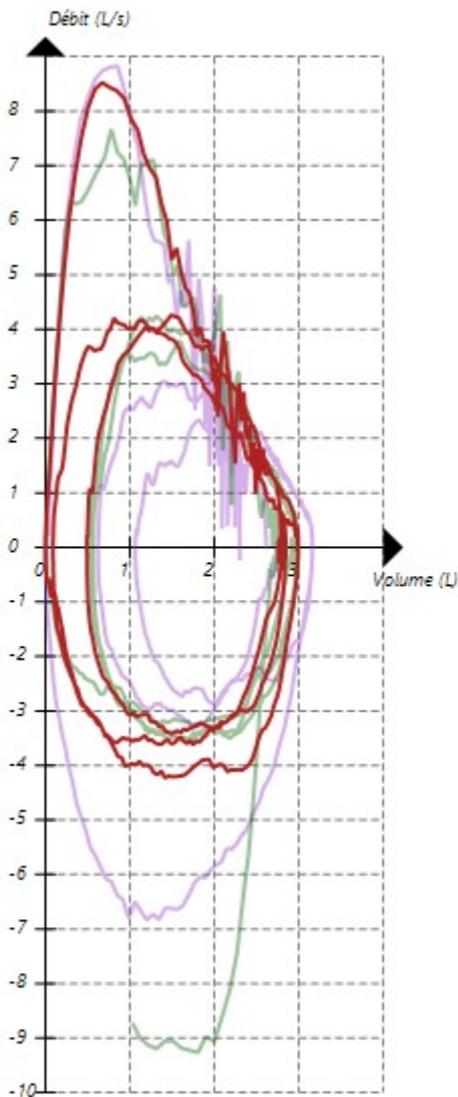

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2  
~ Courbe n°3 ★

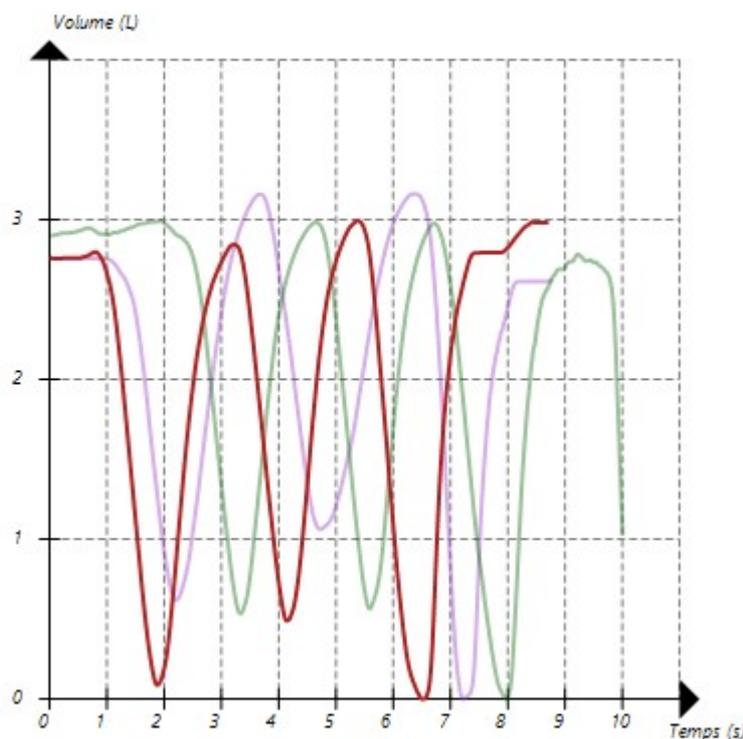

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,62 L	2,79 L	2,99 L	4,04 L	74,01 %
VEMS	2,61 L	2,73 L	2,79 L	3,32 L	84,04 %
DEP	8,94 L/s	7,89 L/s	8,61 L/s	8,68 L/s	99,19 %
VEMS/ CVF	99,62 %	97,85 %	93,31 %	81,93 %	113,89 %
Durée d'expiration	1,49 s	1,26 s	1,92 s	-	
DEMM	5,36 L/s	5,46 L/s	5,03 L/s	3,55 L/s	141,69 %
DEMM/ CVF	2,05 s-1	1,96 s-1	1,68 s-1	0,88 s-1	190,91 %
DE75	8,80 L/s	7,14 L/s	8,49 L/s	-	
DE50	5,25 L/s	5,54 L/s	5,15 L/s	-	
DE25	3,82 L/s	3,77 L/s	2,66 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: