



<b>Nom</b> SIDIBE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1988	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 53	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 37 %

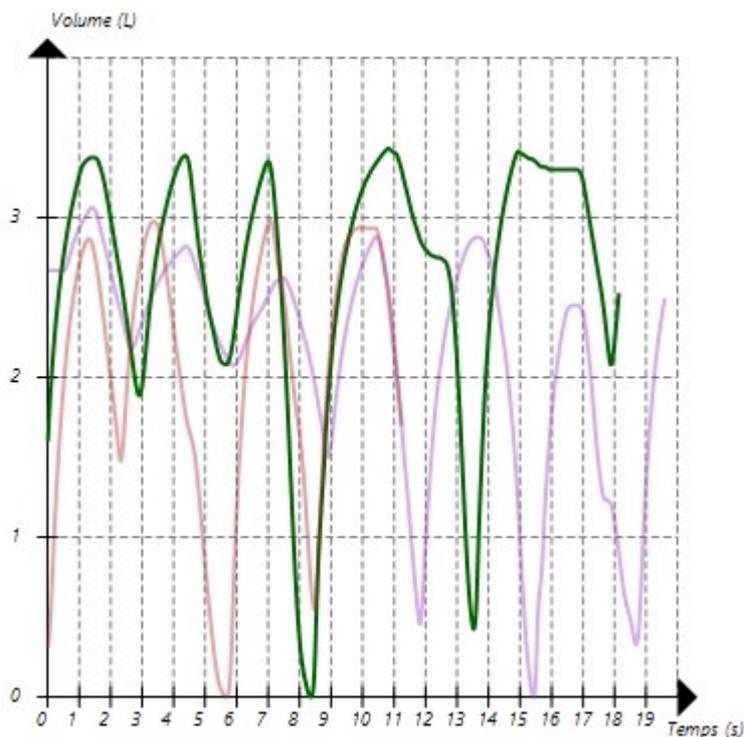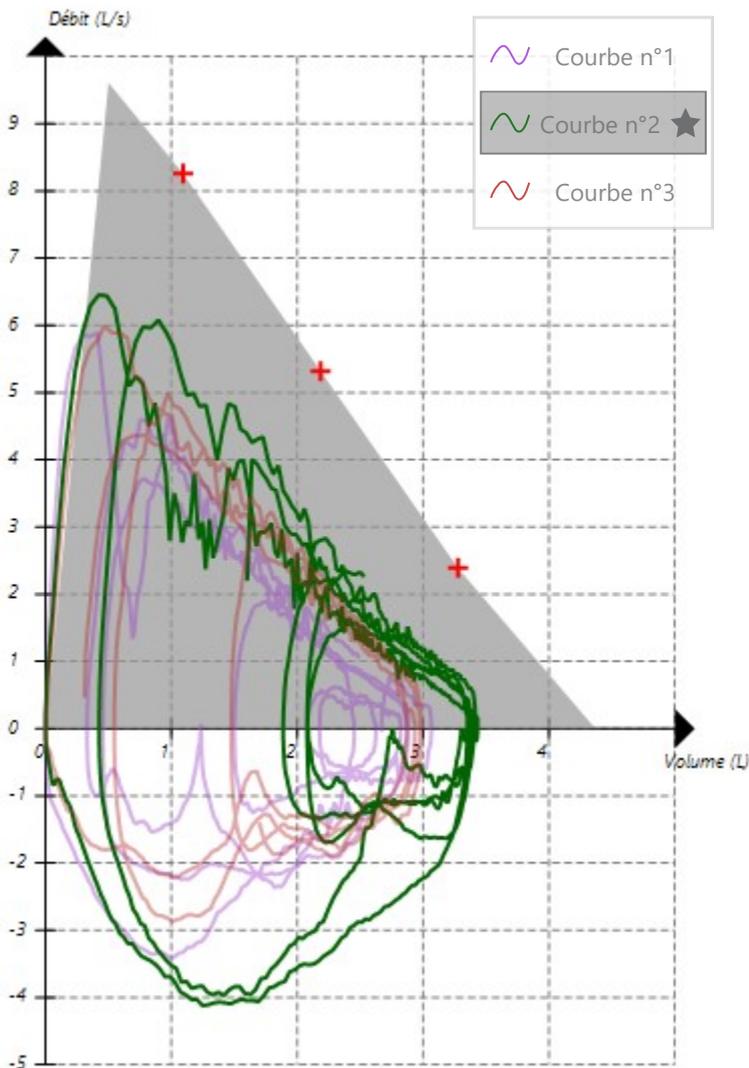

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,45 L	3,43 L	2,98 L	4,37 L	78,49 %
VEMS	2,41 L	2,76 L	2,78 L	3,62 L	76,24 %
DEP	6,18 L/s	6,53 L/s	6,05 L/s	9,61 L/s	67,95 %
VEMS/ CVF	98,37 %	80,47 %	93,29 %	80,77 %	99,63 %
Durée d'expiration	1,42 s	2,46 s	1,42 s	-	
DEMM	2,79 L/s	2,49 L/s	3,23 L/s	4,63 L/s	53,78 %
DEMM/ CVF	1,14 s-1	0,73 s-1	1,08 s-1	0,92 s-1	79,35 %
DE75	2,50 L/s	5,04 L/s	5,27 L/s	8,26 L/s	61,02 %
DE50	3,52 L/s	3,41 L/s	3,00 L/s	5,32 L/s	64,10 %
DE25	2,09 L/s	1,31 L/s	1,69 L/s	2,39 L/s	54,81 %