



<b>Nom</b> GBOMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LAMAH	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 22/06/1994	<b>Profession</b> INTERPRETE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 290	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,1 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 133,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 62 %

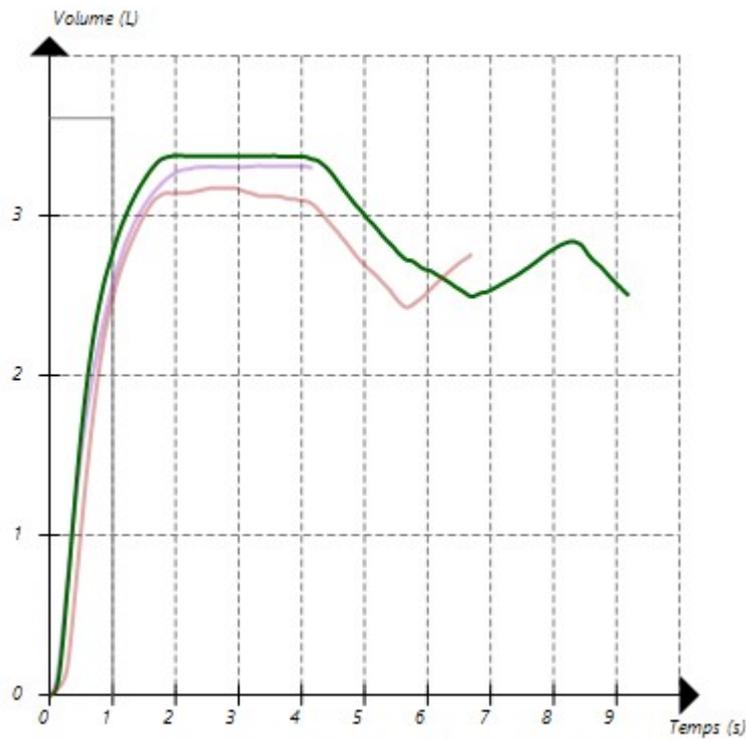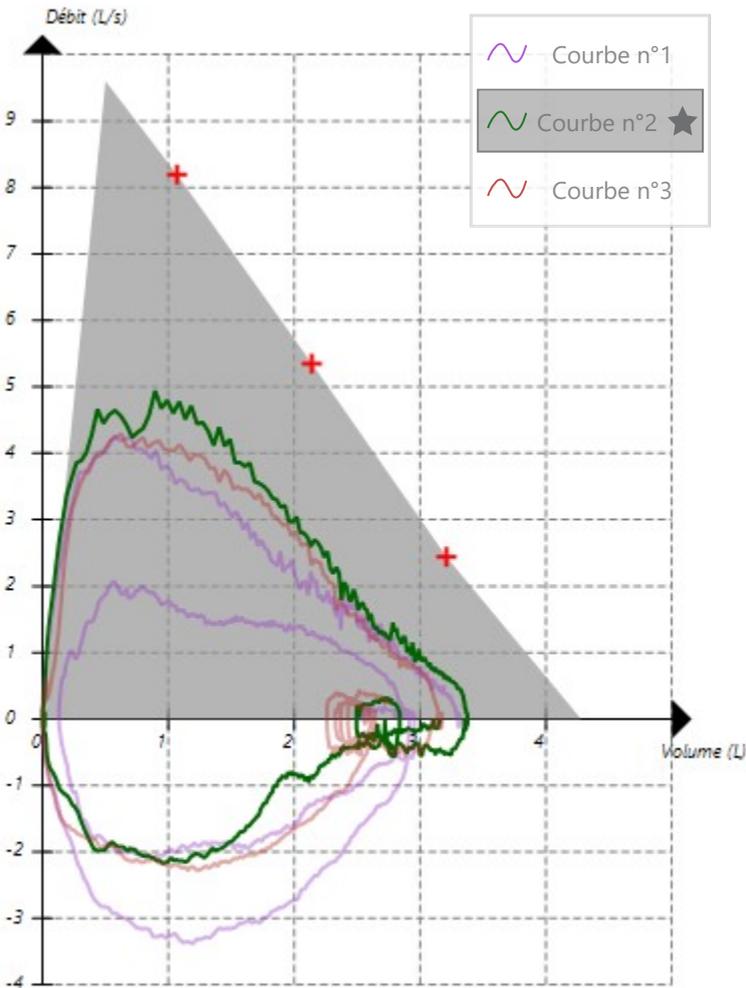

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,31 L	3,38 L	3,17 L	4,28 L	78,97 %
VEMS	2,72 L	2,93 L	2,80 L	3,61 L	81,16 %
DEP	4,46 L/s	5,53 L/s	4,37 L/s	9,60 L/s	57,60 %
VEMS/ CVF	82,18 %	86,69 %	88,33 %	82,02 %	105,69 %
Durée d'expiration	3,31 s	2,02 s	2,59 s	-	
DEMM	2,60 L/s	3,29 L/s	3,19 L/s	4,83 L/s	68,12 %
DEMM/ CVF	0,79 s-1	0,97 s-1	1,01 s-1	0,98 s-1	98,98 %
DE75	4,14 L/s	4,32 L/s	4,23 L/s	8,19 L/s	52,75 %
DE50	2,61 L/s	3,58 L/s	3,48 L/s	5,35 L/s	66,92 %
DE25	1,59 L/s	1,58 L/s	1,45 L/s	2,44 L/s	64,75 %