

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LASSO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/02/2001	<b>Profession</b> OPERATEUR GRADER
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 2635	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,9 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 54 %

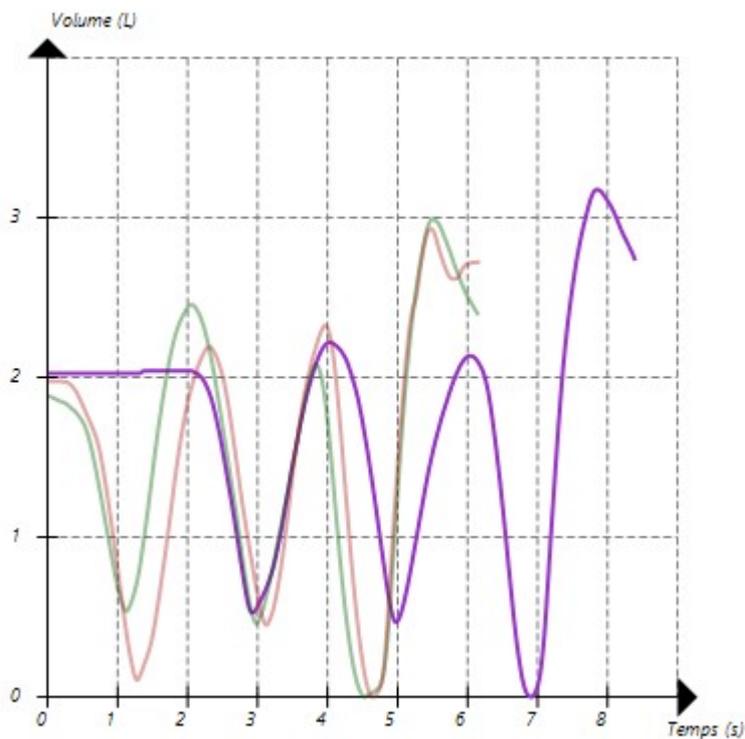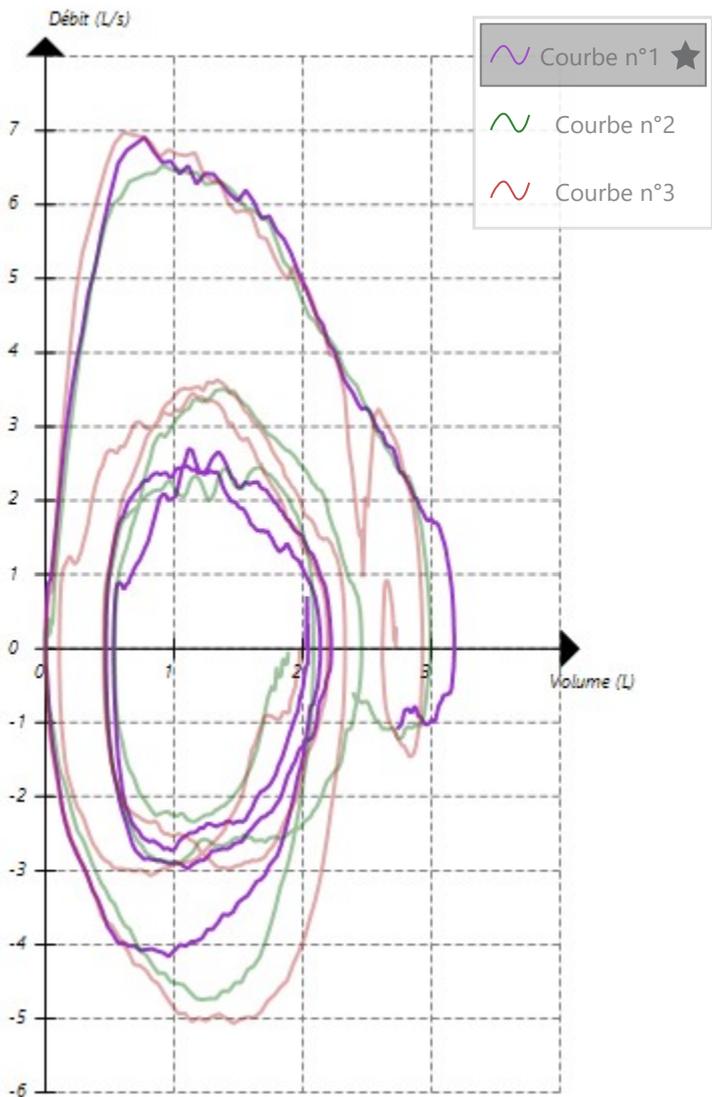

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,18 L	2,99 L	2,93 L	4,05 L	78,52 %
VEMS	3,18 L	2,99 L	2,93 L	3,47 L	91,64 %
DEP	7,02 L/s	6,62 L/s	7,14 L/s	8,87 L/s	79,14 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,85 %	117,86 %
Durée d'expiration	0,93 s	0,98 s	0,83 s	-	
DEMM	5,57 L/s	5,78 L/s	5,89 L/s	4,05 L/s	137,53 %
DEMM/ CVF	1,75 s-1	1,93 s-1	2,01 s-1	1,00 s-1	175,00 %
DE75	6,79 L/s	6,38 L/s	6,84 L/s	-	
DE50	6,10 L/s	6,08 L/s	5,90 L/s	-	
DE25	3,43 L/s	4,22 L/s	3,99 L/s	-	