

<b>Nom</b> KOLOMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> CECE DAVID	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 27/09/1992	<b>Profession</b> OPERATEUR COMPACTEUR
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> COVEC
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 395	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,7 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 62 %

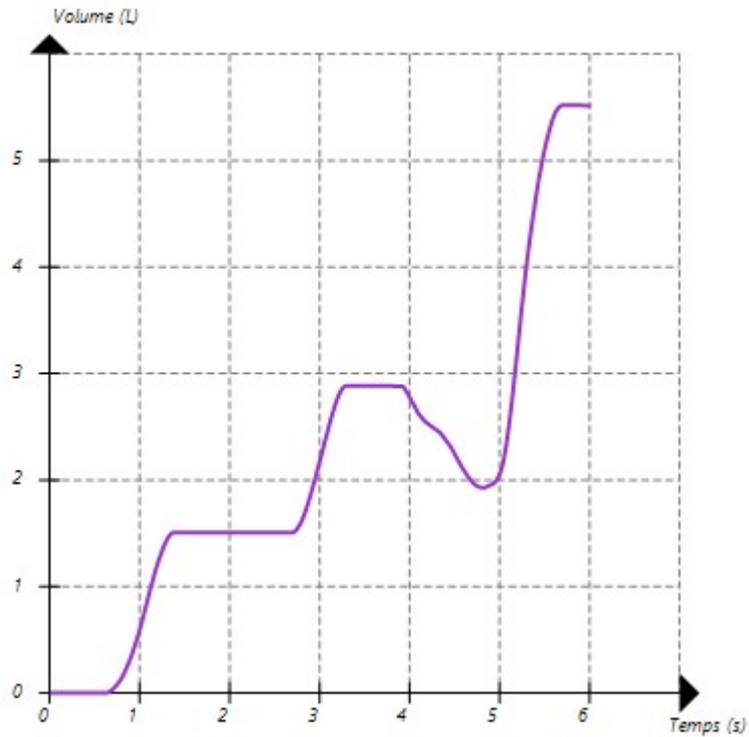

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,59 L	4,26 L	84,27 %
VEMS	3,59 L	3,57 L	100,56 %
DEP	8,43 L/s	9,14 L/s	92,23 %
VEMS/ CVF	100,00 %	83,57 %	119,66 %
Durée d'expiration	0,89 s	-	
DEMM	7,18 L/s	3,96 L/s	181,31 %
DEMM/ CVF	2,00 s-1	0,93 s-1	215,05 %
DE75	7,29 L/s	-	
DE50	7,43 L/s	-	
DE25	5,38 L/s	-	