

<b>Nom</b> LOUA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KEFFA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 26/01/1988	<b>Profession</b> MECANICIEN
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 583	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 52 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 27,1 °C  
 Pression atmosphérique : 101,1 kPa  
 Humidité : 57 %

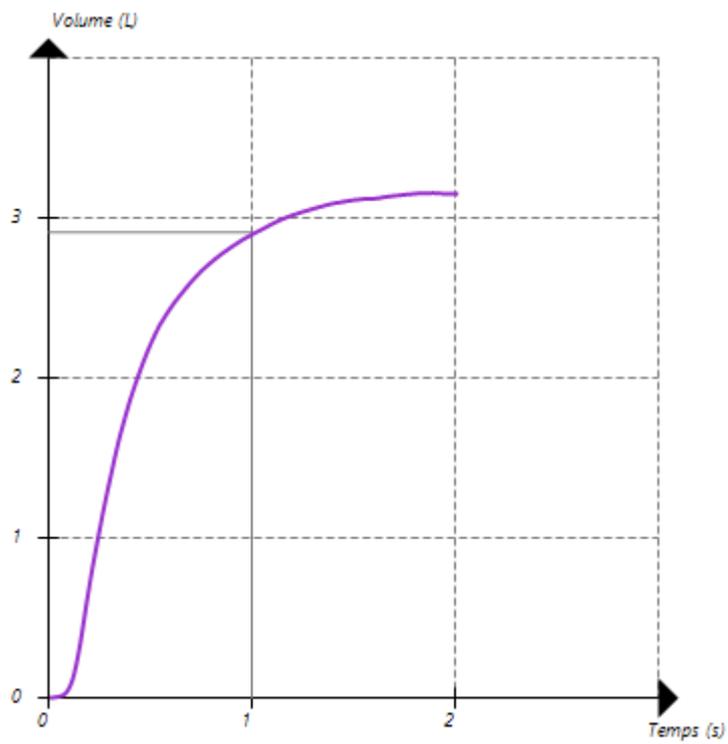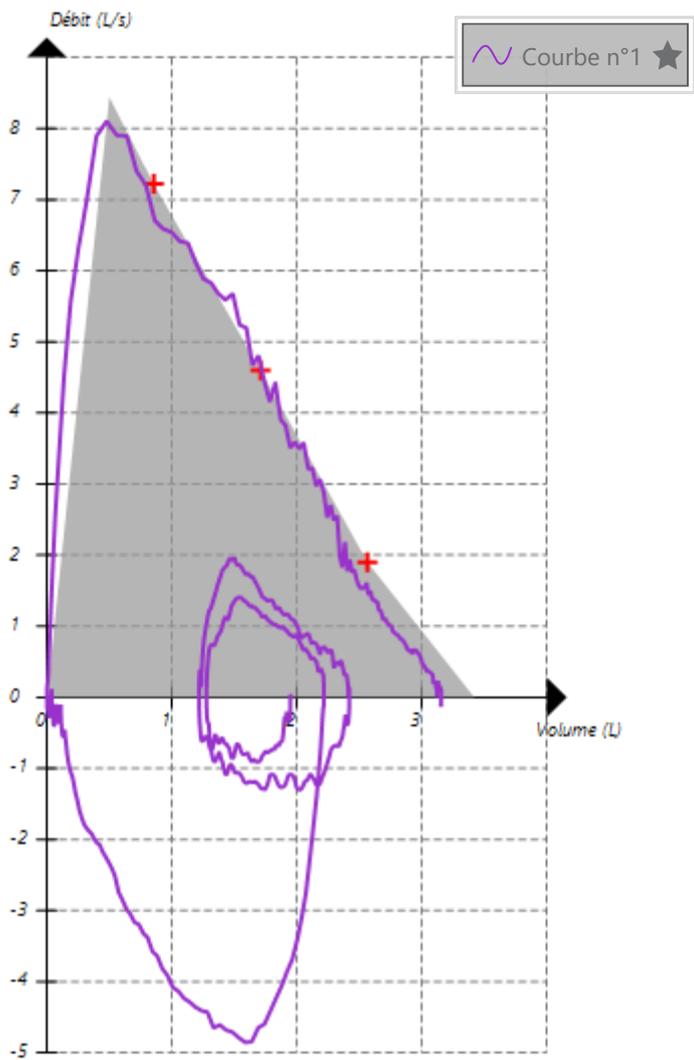

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,16 L	3,42 L	92,40 %
VEMS	2,97 L	2,91 L	102,06 %
DÉP	8,36 L/s	8,44 L/s	99,05 %
VEMS/CVF	93,99 %	80,77 %	116,37 %
Durée d'expiration	1,90 s	-	
DEMM	4,48 L/s	4,26 L/s	105,16 %
DEMM/CVF	1,42 s <sup>-1</sup>	1,08 s <sup>-1</sup>	131,48 %
DE75	7,22 L/s	7,22 L/s	100,00 %
DE50	5,57 L/s	4,60 L/s	121,09 %
DE25	1,95 L/s	1,90 L/s	102,63 %