

Nom TRAORE	Adresse
Prénom ROGER MANIMOU	Exposition
Né le 01/07/1988	Profession TECHNICIEN ENVIRONNEMENT
Age 35 Ans	Entreprise BCEIP
Genre Masculin	Service
ID 464	Fumeur Non fumeur
Taille 175 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	





Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
 Numéro de série : 232707
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 29,7 °C
 Pression atmosphérique : 100,8 kPa
 Humidité : 52 %

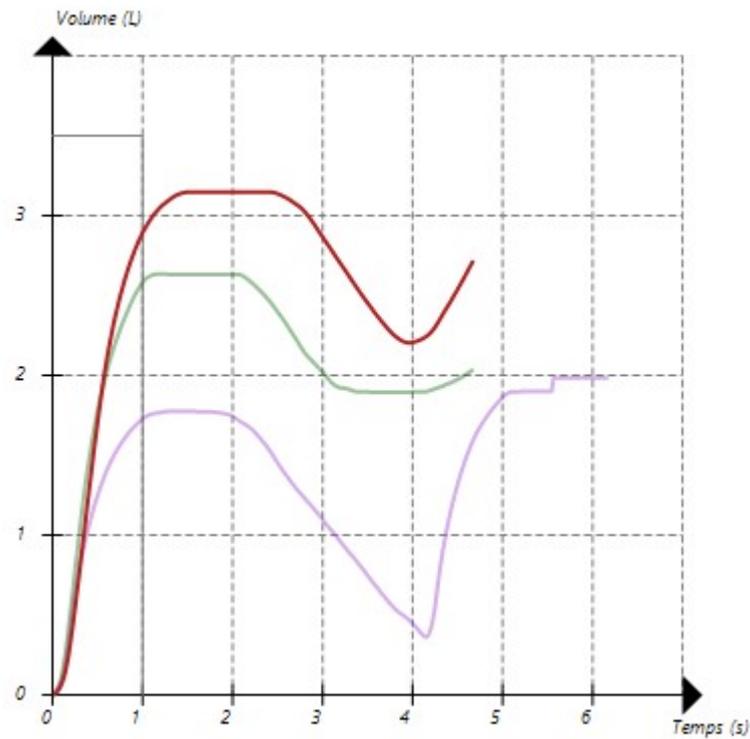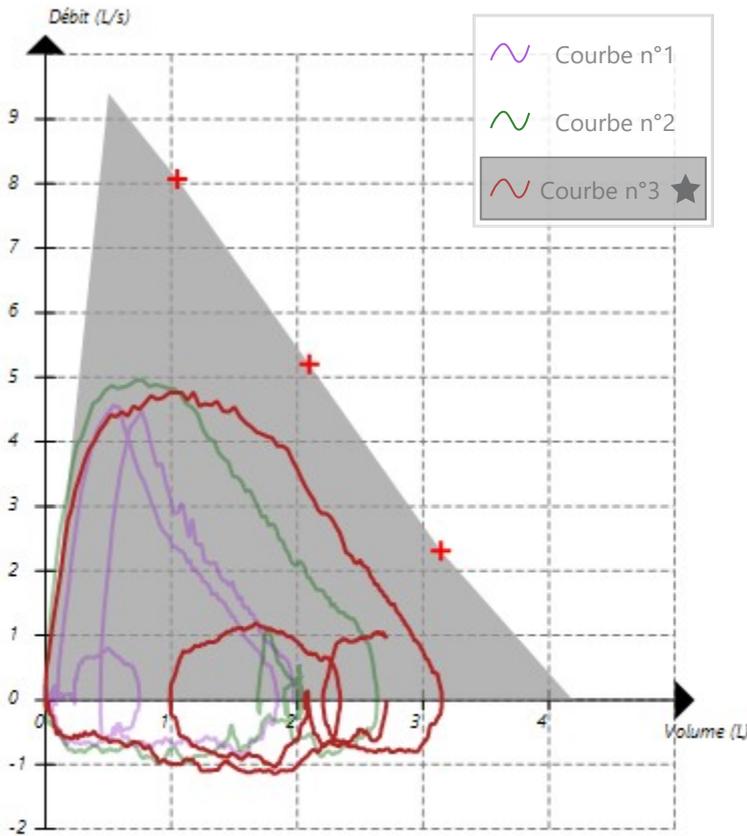

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,76 L	2,64 L	3,15 L	4,19 L	75,18 %
VEMS	1,75 L	2,63 L	3,01 L	3,50 L	86,00 %
DEP	4,67 L/s	5,04 L/s	4,86 L/s	9,40 L/s	51,70 %
VEMS/ CVF	99,43 %	99,62 %	95,56 %	80,94 %	118,06 %
Durée d'expiration	1,49 s	1,18 s	1,50 s	-	
DEMM	2,56 L/s	3,72 L/s	4,03 L/s	4,60 L/s	87,61 %
DEMM/ CVF	1,45 s-1	1,41 s-1	1,28 s-1	0,95 s-1	134,74 %
DE75	4,49 L/s	4,81 L/s	4,64 L/s	8,07 L/s	57,50 %
DE50	2,63 L/s	4,05 L/s	4,34 L/s	5,20 L/s	83,46 %
DE25	1,61 L/s	2,13 L/s	2,48 L/s	2,31 L/s	107,36 %