



<b>Nom</b> DIABATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MACKY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1987	<b>Profession</b> MENUISIER
<b>Age</b> 37 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 196	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 9
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	

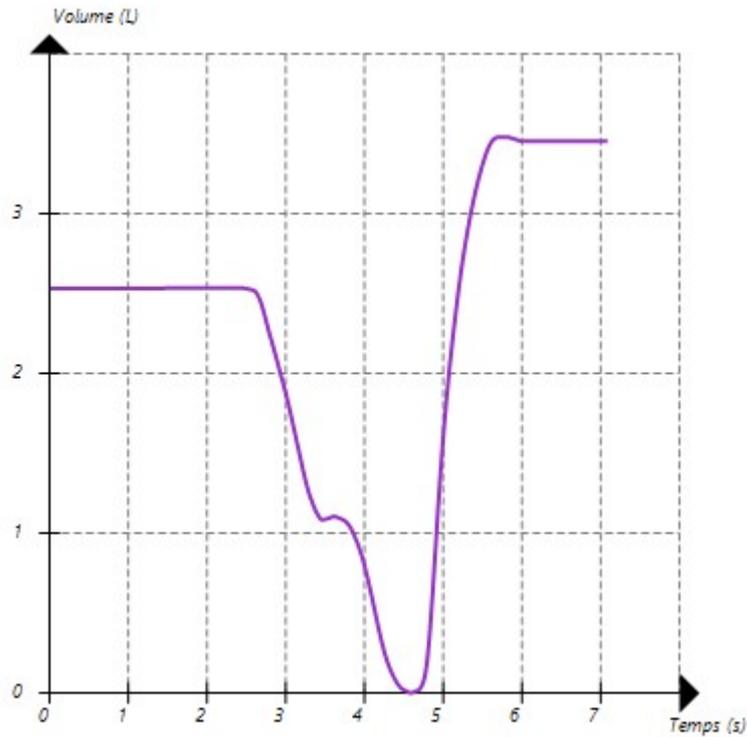

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 50 %

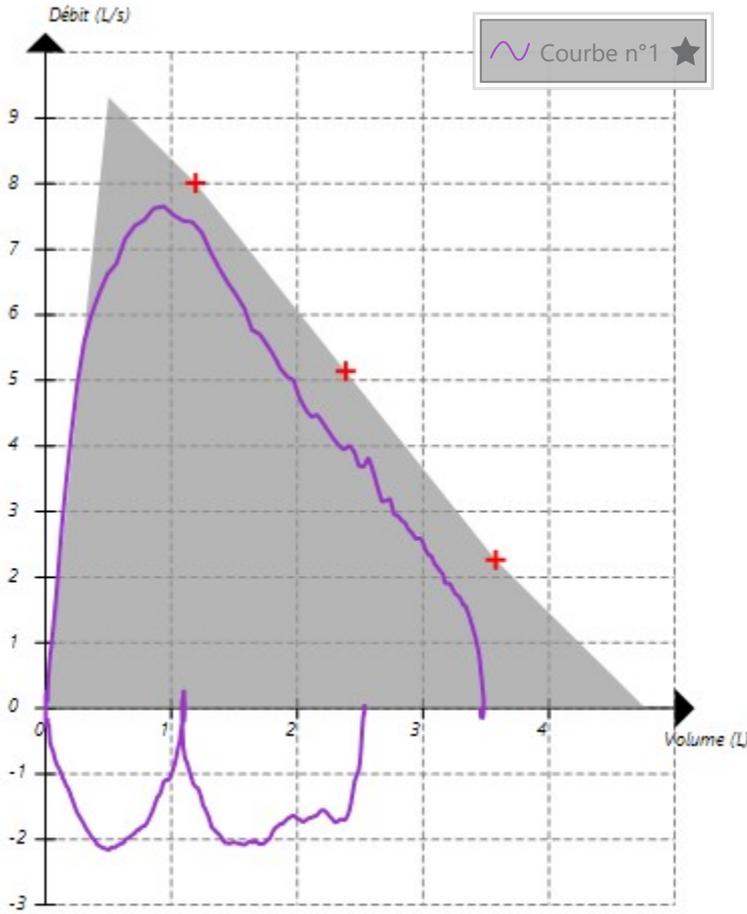

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,48 L	4,77 L	72,96 %
VEMS	3,48 L	3,96 L	87,88 %
DEP	7,74 L/s	9,32 L/s	83,05 %
VEMS/ CVF	100,00 %	80,59 %	124,08 %
Durée d'expiration	1,11 s	-	
DEMM	5,42 L/s	4,51 L/s	120,18 %
DEMM/ CVF	1,56 s-1	0,95 s-1	164,21 %
DE75	7,72 L/s	8,01 L/s	96,38 %
DE50	5,55 L/s	5,14 L/s	107,98 %
DE25	3,46 L/s	2,26 L/s	153,10 %