



<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LAYEBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/02/1996	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 290	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 55 %

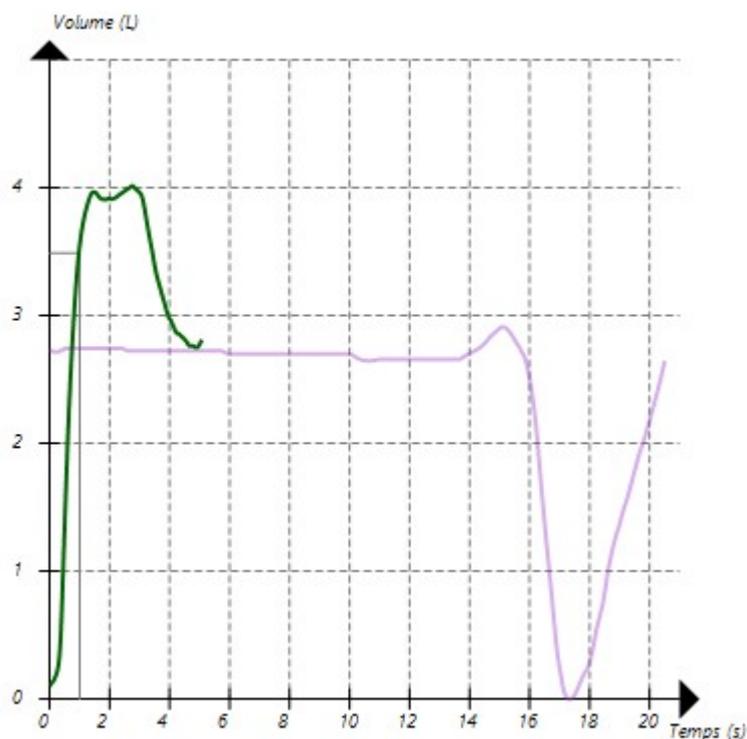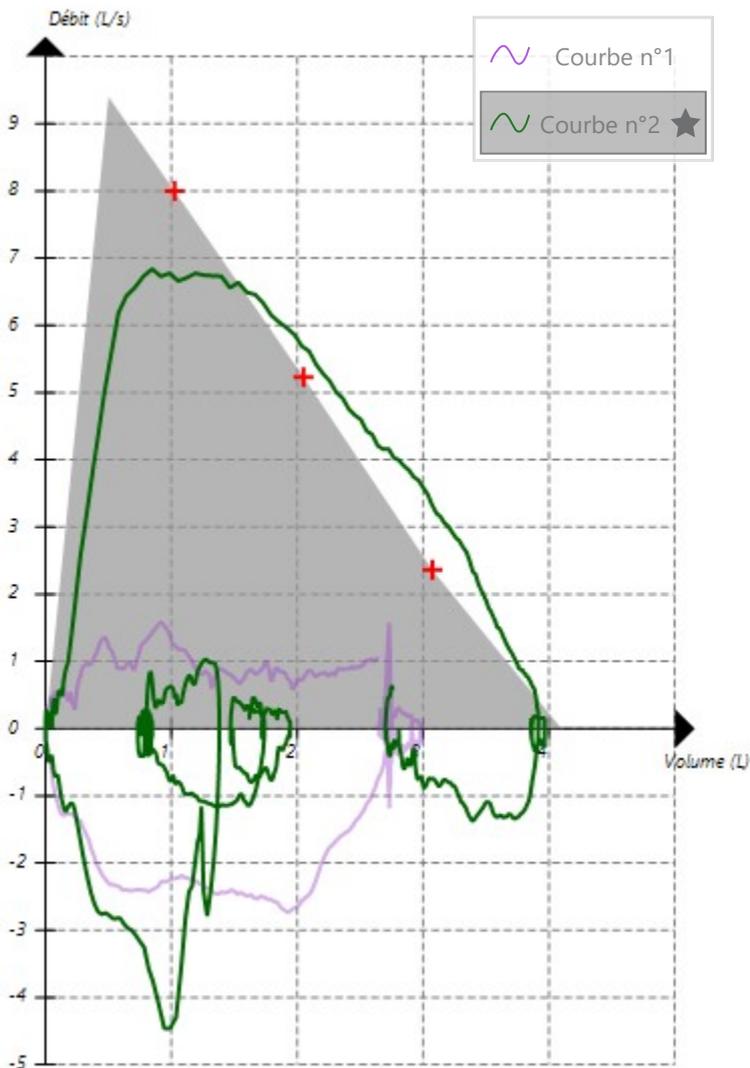

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,03 L	3,92 L	4,10 L	95,61 %
VEMS	0,03 L	3,85 L	3,49 L	110,32 %
DEP	2,57 L/s	6,88 L/s	9,40 L/s	73,19 %
VEMS/ CVF	100,00 %	98,21 %	82,20 %	119,48 %
Durée d'expiration	0,51 s	1,85 s	-	
DEMM	0,48 L/s	5,53 L/s	4,80 L/s	115,21 %
DEMM/ CVF	16,00 s-1	1,41 s-1	1,02 s-1	138,24 %
DE75	1,70 L/s	6,77 L/s	8,00 L/s	84,62 %
DE50	0,69 L/s	5,95 L/s	5,23 L/s	113,77 %
DE25	0,94 L/s	3,74 L/s	2,36 L/s	158,47 %