

Nom SOUMAORO	Adresse
Prénom FREBORY	Exposition
Né le 01/02/1999	Profession MANEUVRE
Age 25 Ans	Entreprise BECEIP
Genre Masculin	Service
ID 80	Fumeur Non fumeur
Taille 170 cm	Prescripteur:
Poids 71 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	
Opérateur admin admin	




MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Numéro de série : 232803
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 32,1 °C
Pression atmosphérique : 93,8 kPa
Humidité : 55 %

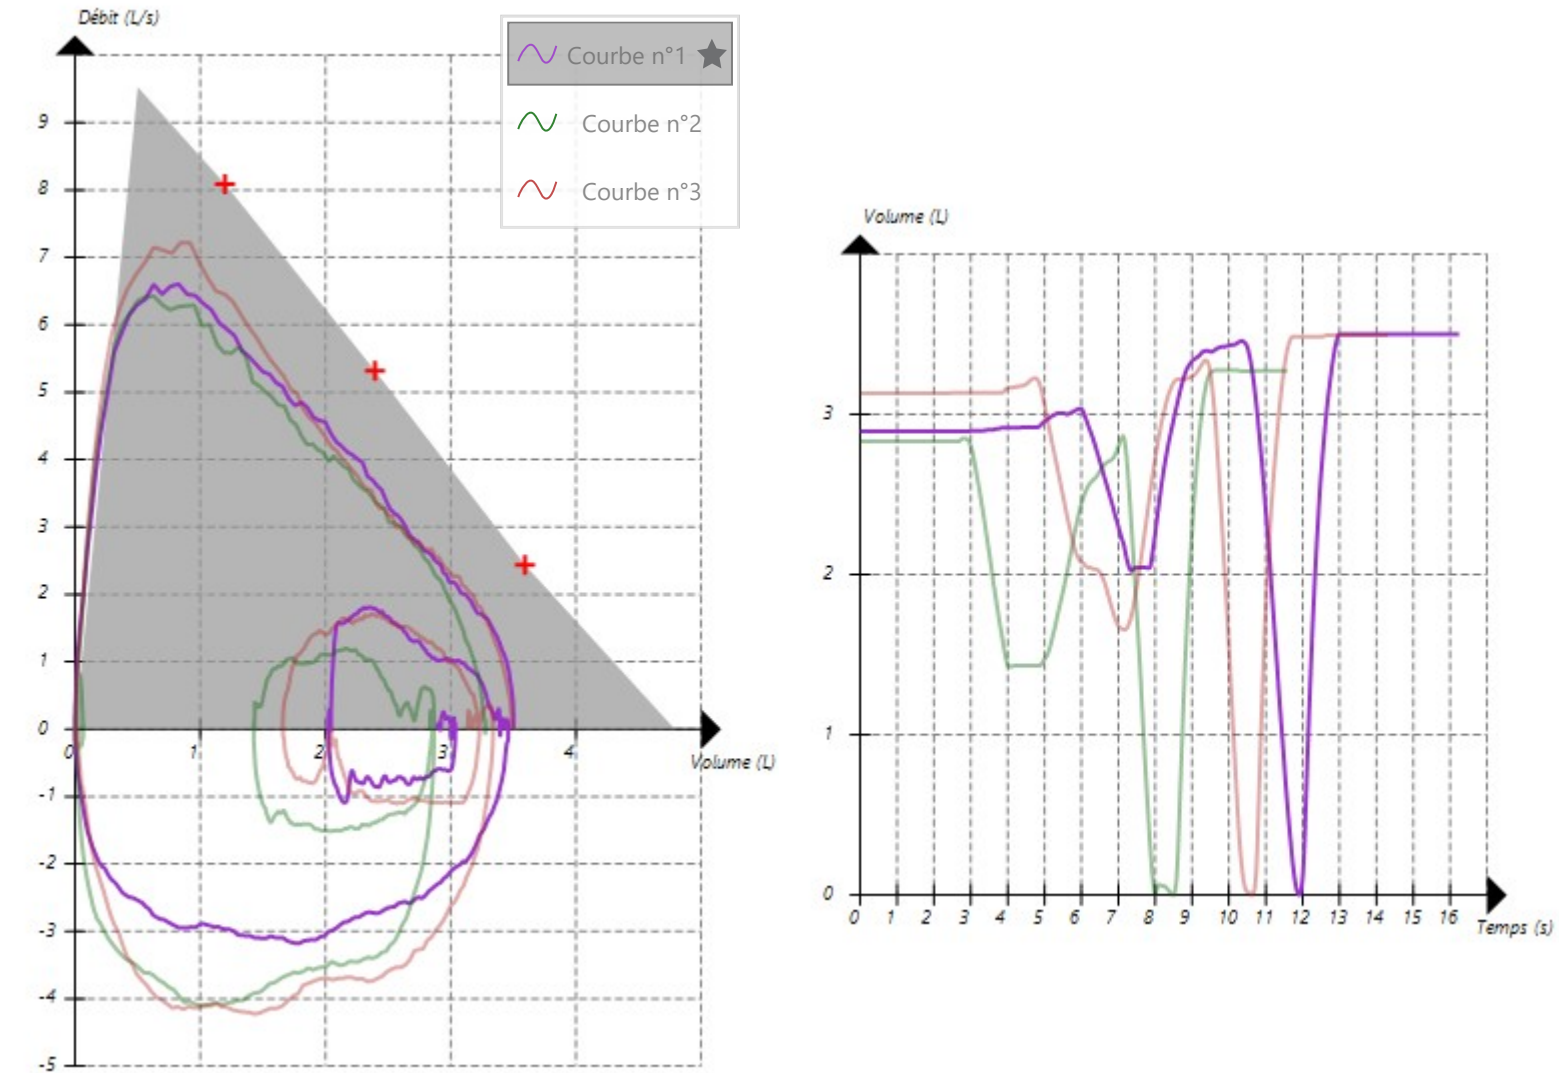

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,50 L	3,28 L	3,49 L	4,79 L	73,07 %
VEMS	3,50 L	3,27 L	3,49 L	4,09 L	85,57 %
DEP	6,72 L/s	6,52 L/s	7,44 L/s	9,53 L/s	70,51 %
VEMS/CVF	100,00 %	99,70 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,09 s	1,14 s	2,03 s	-	
DEMM	4,77 L/s	4,74 L/s	4,79 L/s	4,93 L/s	96,75 %
DEMM/CVF	1,36 s-1	1,45 s-1	1,37 s-1	1,03 s-1	132,04 %
DE75	6,54 L/s	6,27 L/s	7,40 L/s	8,09 L/s	80,84 %
DE50	4,74 L/s	4,82 L/s	5,00 L/s	5,32 L/s	89,10 %
DE25	3,05 L/s	3,26 L/s	2,98 L/s	2,44 L/s	125,00 %