

<b>Nom</b> WELEMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JEAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/02/1996	<b>Profession</b> SOUDEUR
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 529	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 32,2 °C  
 Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Humidité : 56 %

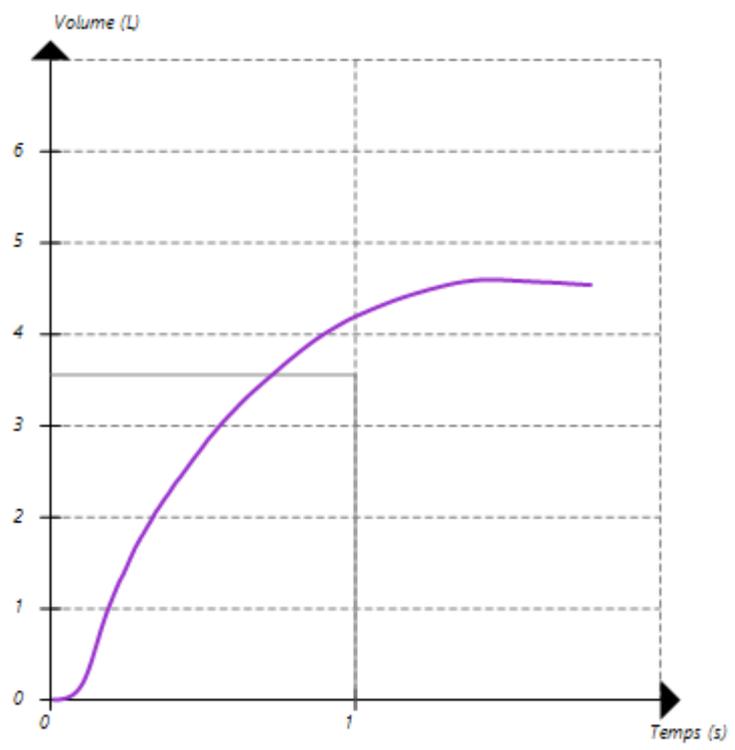

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,60 L	4,20 L	109,52 %
VEMS	4,32 L	3,56 L	121,35 %
DÉP	11,08 L/s	9,52 L/s	116,39 %
VEMS/CVF	93,91 %	82,20 %	114,25 %
Durée d'expiration	1,44 s	-	
DEMM	4,77 L/s	4,84 L/s	98,55 %
DEMM/CVF	1,04 s <sup>-1</sup>	1,00 s <sup>-1</sup>	104,00 %
DE75	8,01 L/s	8,11 L/s	98,77 %
DE50	6,15 L/s	5,31 L/s	115,82 %
DE25	2,97 L/s	2,42 L/s	122,73 %