



<b>Nom</b> KONNEH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMASU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 11/11/1998	<b>Profession</b> ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 636	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 155 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 49 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,6 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 52 %

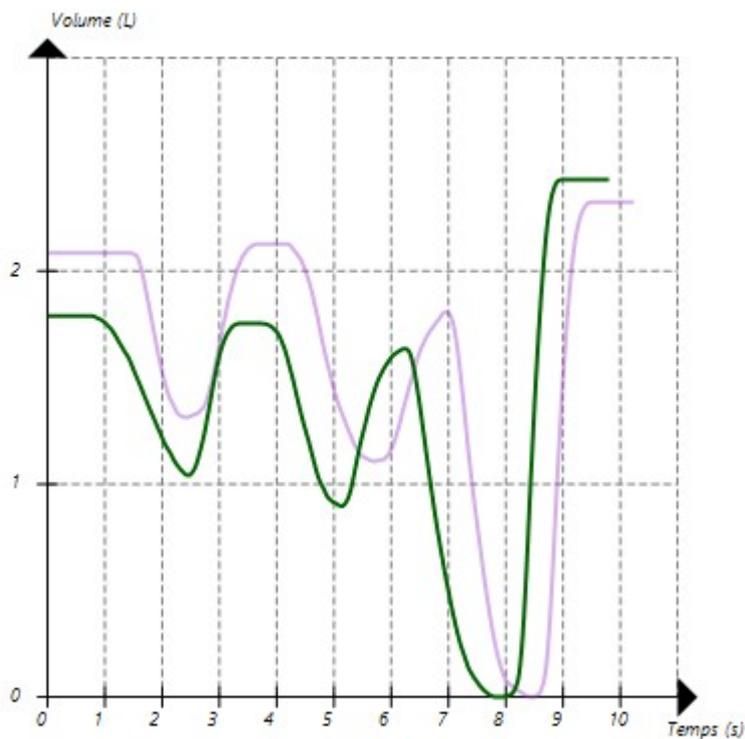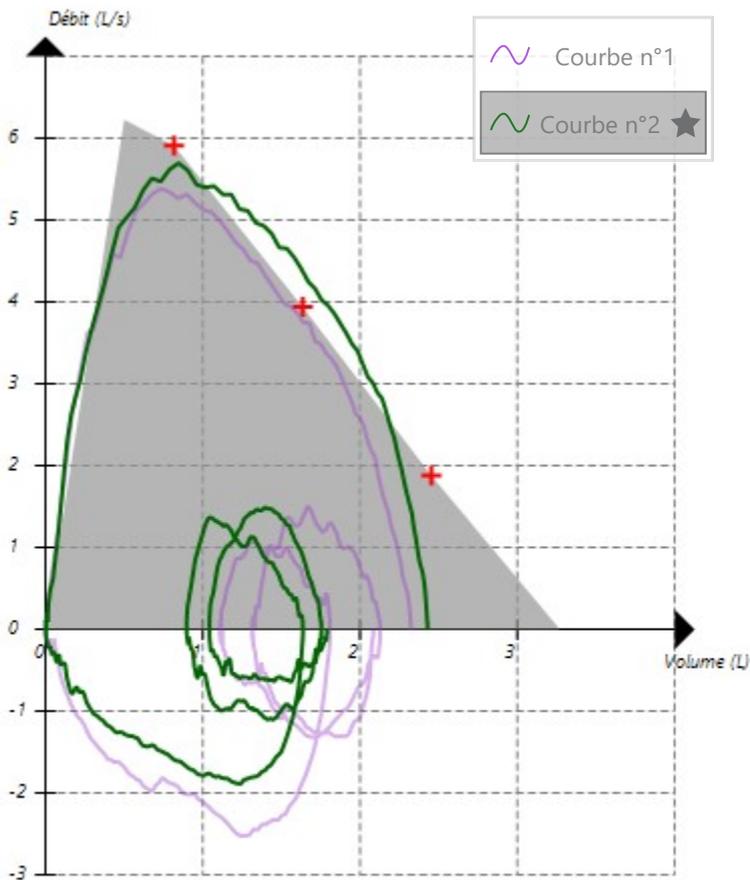

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,32 L	2,43 L	3,27 L	74,31 %
VEMS	2,32 L	2,43 L	2,85 L	85,26 %
DEP	5,47 L/s	5,73 L/s	6,23 L/s	91,97 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	88,25 %	113,31 %
Durée d'expiration	1,10 s	1,11 s	-	
DEMM	4,70 L/s	5,08 L/s	3,47 L/s	146,40 %
DEMM/ CVF	2,03 s-1	2,09 s-1	1,06 s-1	197,17 %
DE75	5,10 L/s	5,33 L/s	5,91 L/s	90,19 %
DE50	4,85 L/s	5,08 L/s	3,94 L/s	128,93 %
DE25	3,48 L/s	3,91 L/s	1,88 L/s	207,98 %