



<b>Nom</b> SANOH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/01/1993	<b>Profession</b> OPERATEUR GRU
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 649	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,2 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %

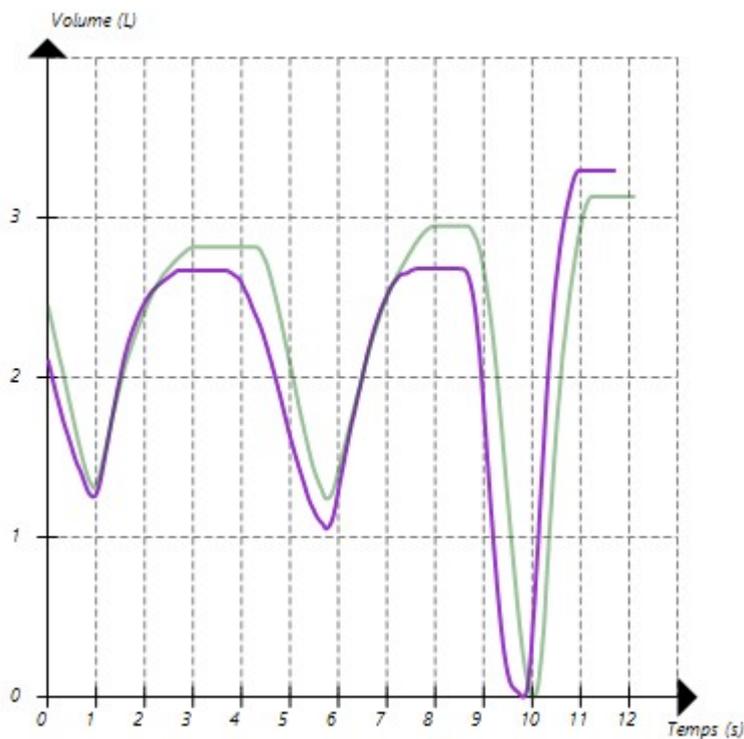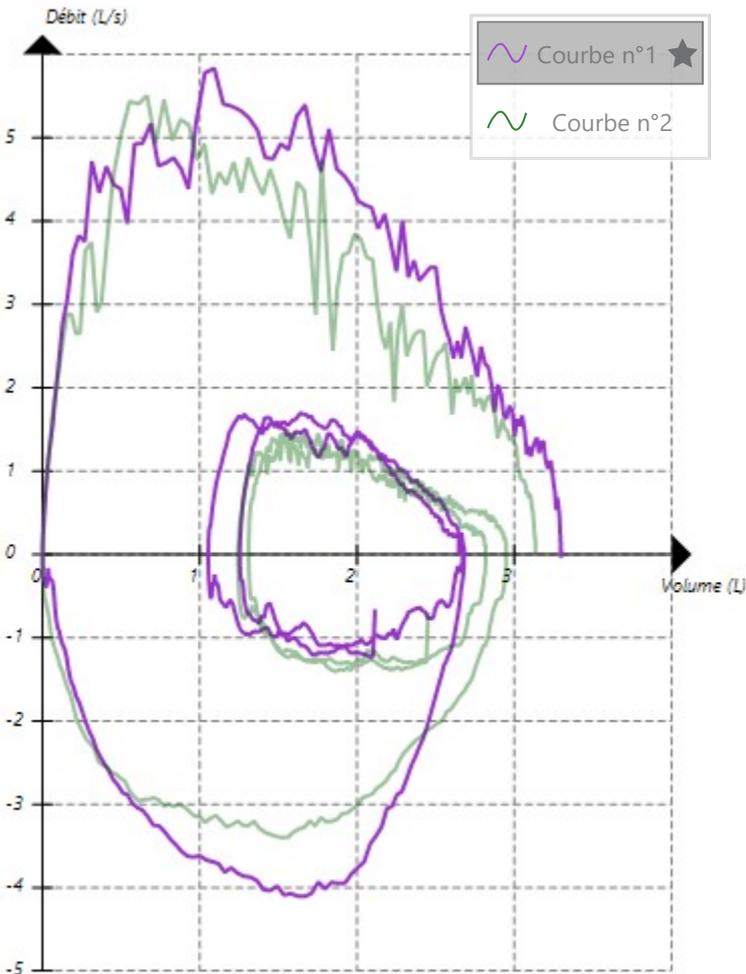

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,30 L	3,13 L	4,15 L	79,52 %
VEMS	3,29 L	3,10 L	3,48 L	94,54 %
DEP	5,98 L/s	5,87 L/s	8,95 L/s	66,82 %
VEMS/CVF	99,70 %	99,04 %	83,57 %	119,30 %
Durée d'expiration	1,21 s	1,20 s	-	
DEMM	4,66 L/s	3,90 L/s	3,89 L/s	119,79 %
DEMM/CVF	1,41 s-1	1,25 s-1	0,94 s-1	150,00 %
DE75	4,80 L/s	5,28 L/s	-	
DE50	5,32 L/s	3,27 L/s	-	
DE25	3,28 L/s	2,44 L/s	-	