


Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 26,1 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,4 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 48 %

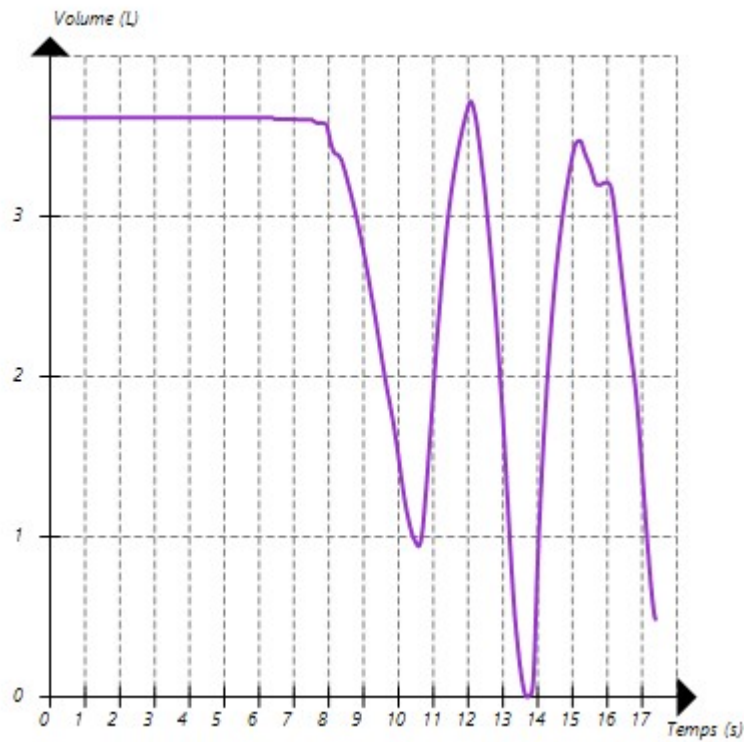

Signature du patient: SpirowinExpert - v04.00.00 Signature de l'opérateur:
Copyright 2015-2020 - FIM MEDICAL - (+33) 4 72 34 89 89 - (+33) 4 72 33 43 51