

<b>Nom</b> DIABATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/03/2003	<b>Profession</b> SPOTERS
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 648	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,4 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 53 %

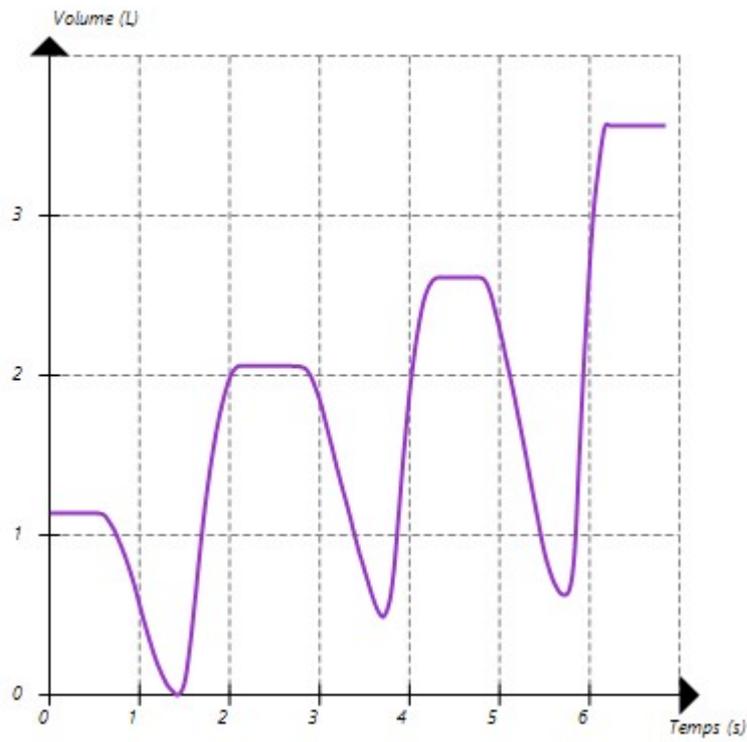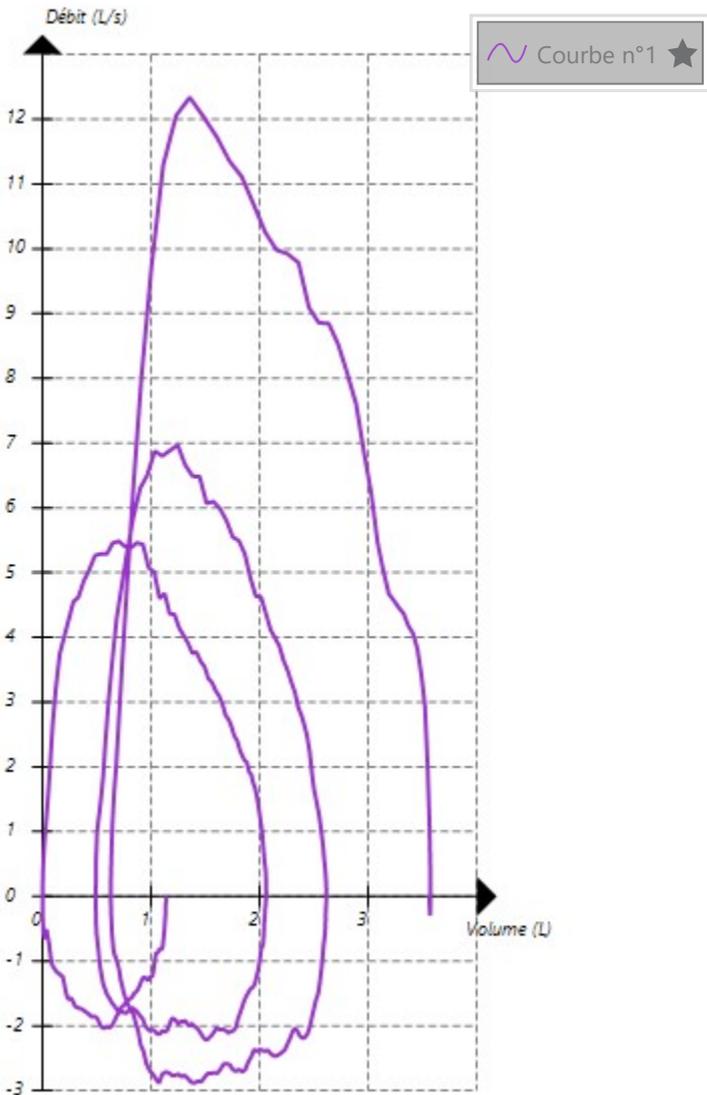

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,95 L	4,16 L	70,91 %
VEMS	2,95 L	3,58 L	82,40 %
DEP	12,47 L/s	9,08 L/s	137,33 %
VEMS/ CVF	100,00 %	85,40 %	117,10 %
Durée d'expiration	0,48 s	-	
DEMM	10,30 L/s	4,21 L/s	244,66 %
DEMM/ CVF	3,49 s-1	1,01 s-1	345,54 %
DE75	12,32 L/s	-	
DE50	10,03 L/s	-	
DE25	7,82 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: