



Nom KAMARA	Adresse
Prénom ABRAHAM.A	Exposition
Né le 06/05/1988	Profession SUPERVISEUR HSE
Age 36 Ans	Entreprise BCEIP
Genre Masculin	Service
ID 322	Fumeur Non fumeur
Taille 175 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids	Prescripteur:
Valeurs prédites Eccls/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 32,4 °C
 Numéro de série : 232707 Pression atmosphérique : 100,3 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 68 %

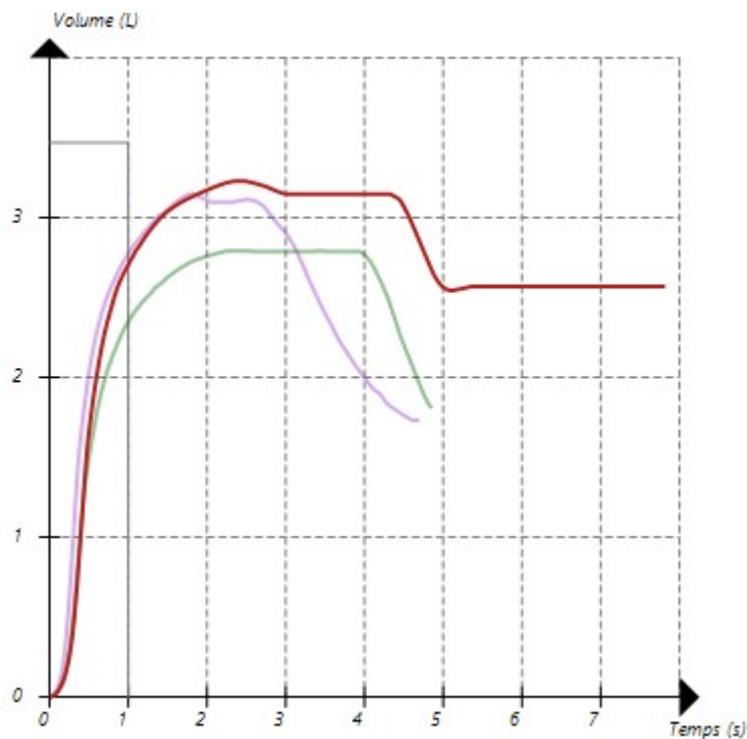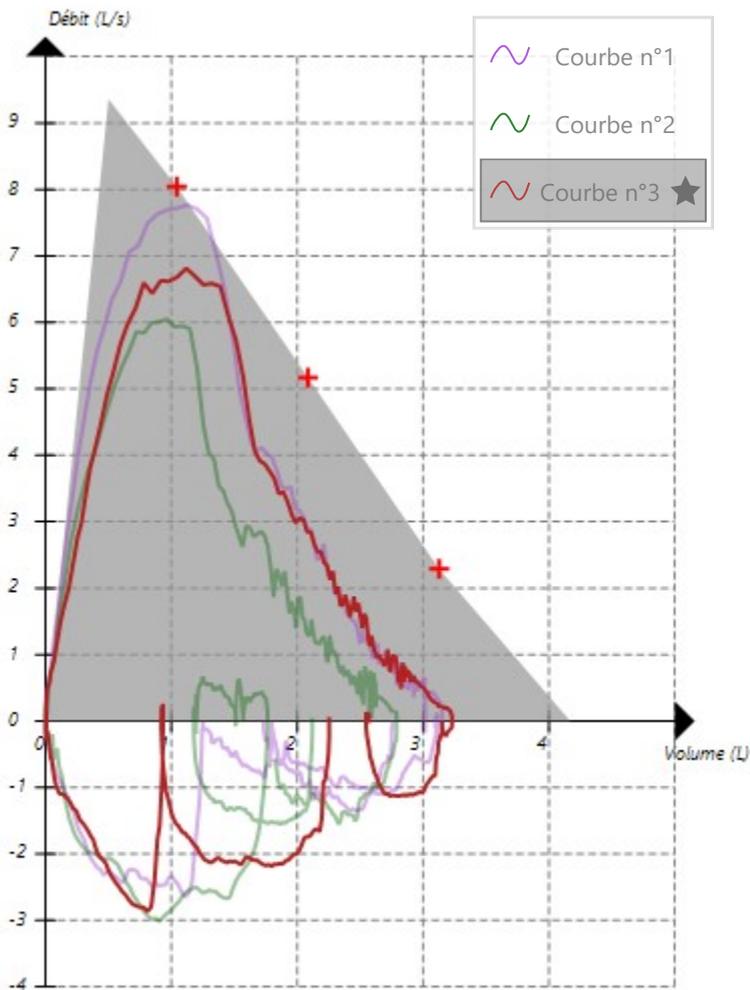

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,15 L	2,79 L	3,23 L	4,17 L	77,46 %
VEMS	2,89 L	2,50 L	2,90 L	3,47 L	83,57 %
DEP	7,88 L/s	6,14 L/s	6,85 L/s	9,36 L/s	73,18 %
VEMS/CVF	91,75 %	89,61 %	89,78 %	80,77 %	111,16 %
Durée d'expiration	1,80 s	2,29 s	2,37 s	-	
DEMM	4,32 L/s	3,25 L/s	3,93 L/s	4,55 L/s	86,37 %
DEMM/CVF	1,37 s-1	1,16 s-1	1,22 s-1	0,95 s-1	128,42 %
DE75	7,43 L/s	5,86 L/s	6,45 L/s	8,04 L/s	80,22 %
DE50	4,69 L/s	3,44 L/s	4,53 L/s	5,17 L/s	87,62 %
DE25	1,74 L/s	1,30 L/s	1,37 L/s	2,29 L/s	59,83 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: