



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N'VAFING	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/02/1990	<b>Profession</b> ASSISTANT ADMIN D'ENTREPO
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 547	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,4 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 67 %

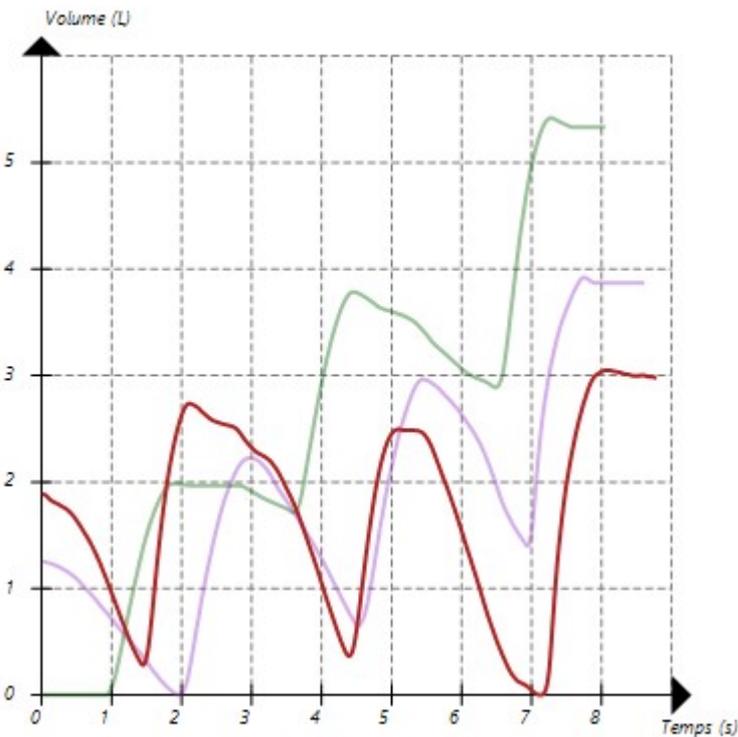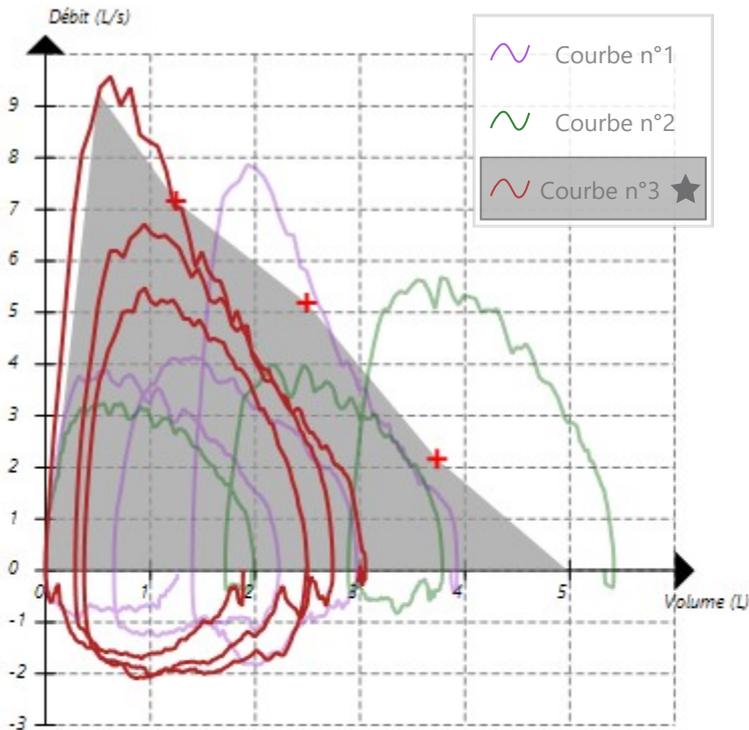

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,52 L	2,53 L	3,05 L	4,98 L	61,24 %
VEMS	2,52 L	2,53 L	3,05 L	4,13 L	73,85 %
DEP	7,89 L/s	5,90 L/s	9,72 L/s	9,27 L/s	104,85 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,13 %	120,29 %
Durée d'expiration	0,81 s	0,79 s	0,98 s	-	
DEMM	4,62 L/s	4,93 L/s	5,65 L/s	4,38 L/s	129,00 %
DEMM/ CVF	1,83 s-1	1,95 s-1	1,85 s-1	0,88 s-1	210,23 %
DE75	7,79 L/s	5,63 L/s	9,28 L/s	7,16 L/s	129,61 %
DE50	5,05 L/s	4,98 L/s	5,90 L/s	5,19 L/s	113,68 %
DE25	2,70 L/s	3,64 L/s	3,33 L/s	2,16 L/s	154,17 %