

**Nom** SQUARE  
**Prénom** MOHAMED  
**Né le** 04/01/1980  
**Age** 44 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 247  
**Taille** 170 cm  
**Poids** 66 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession** ADT  
**Entreprise** BCEIP  
**Service**  
**Fumeur** Non fumeur  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Numéro de série : 232697

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 27,2 °C

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Humidité : 44 %

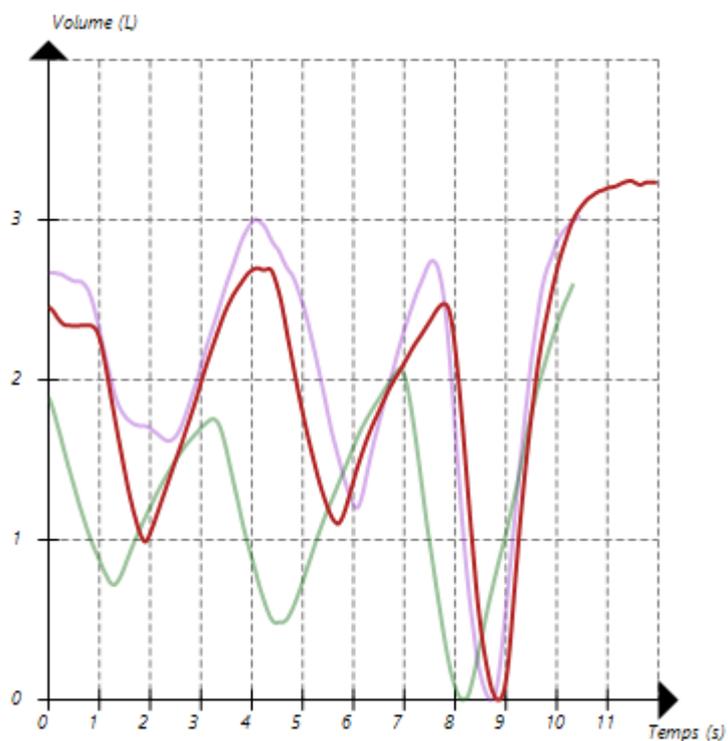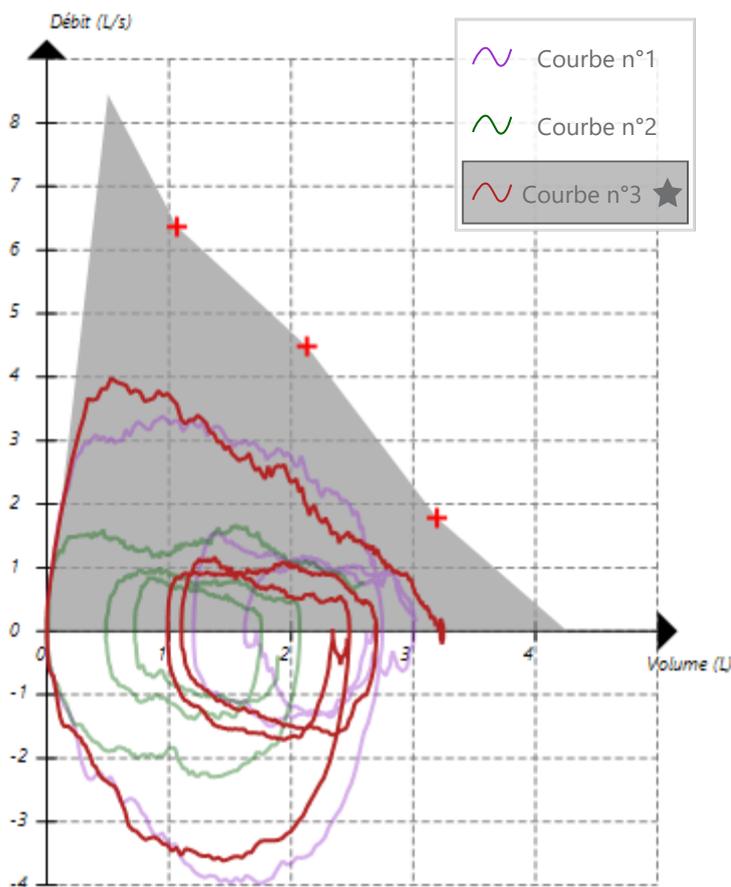

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,03 L	2,61 L	3,25 L	4,26 L	76,29 %
VEMS	2,72 L	1,66 L	2,67 L	3,51 L	76,07 %
DÉP	3,47 L/s	1,70 L/s	4,07 L/s	8,45 L/s	48,17 %
VEMS/ CVF	89,77 %	63,60 %	82,15 %	82,08 %	100,09 %
Durée d'expiration	1,77 s	2,19 s	2,56 s	-	
DEMM	3,00 L/s	1,39 L/s	2,60 L/s	3,73 L/s	69,71 %
DEMM/ CVF	0,99 s-1	0,53 s-1	0,80 s-1	0,88 s-1	90,91 %
DE75	3,33 L/s	1,33 L/s	3,54 L/s	6,37 L/s	55,57 %
DE50	2,86 L/s	1,44 L/s	2,76 L/s	4,48 L/s	61,61 %
DE25	2,26 L/s	1,06 L/s	1,52 L/s	1,78 L/s	85,39 %