



<b>Nom</b> MANSARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOUBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/04/1992	<b>Profession</b> CONDUCTEUR
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 342	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 180 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 68 %

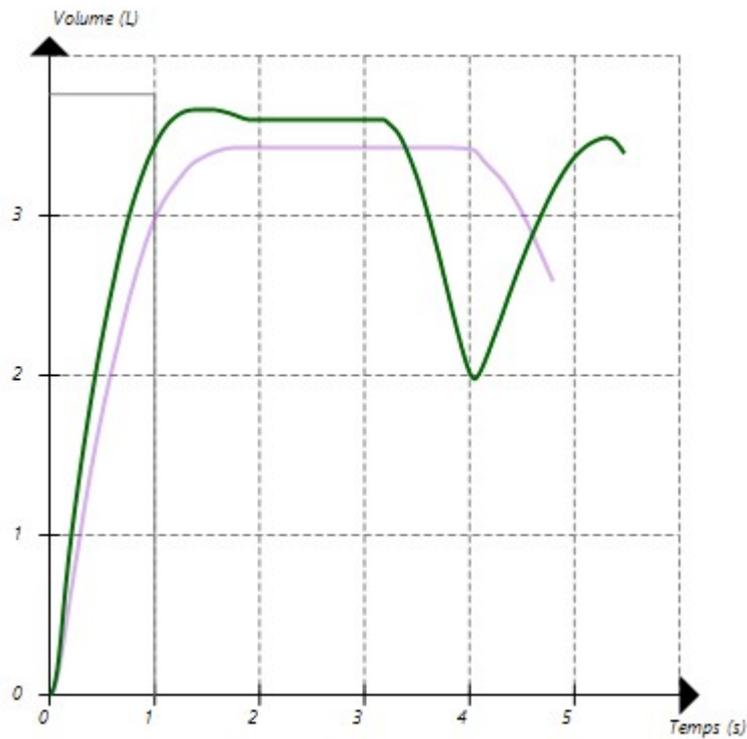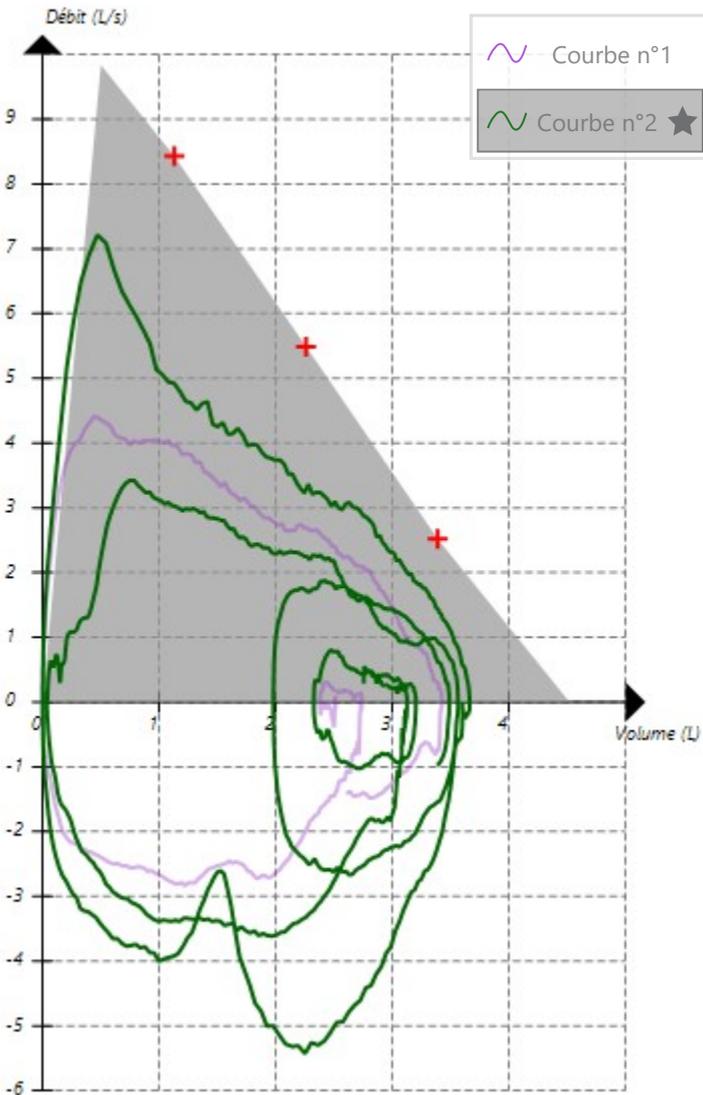

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,43 L	3,66 L	4,52 L	80,97 %
VEMS	3,05 L	3,50 L	3,76 L	93,09 %
DEP	4,47 L/s	7,37 L/s	9,84 L/s	74,90 %
VEMS/ CVF	88,92 %	95,63 %	81,48 %	117,37 %
Durée d'expiration	3,63 s	1,37 s	-	
DEMM	3,17 L/s	3,91 L/s	4,82 L/s	81,12 %
DEMM/ CVF	0,92 s-1	1,07 s-1	0,93 s-1	115,05 %
DE75	4,01 L/s	5,62 L/s	8,43 L/s	66,67 %
DE50	3,12 L/s	3,96 L/s	5,49 L/s	72,13 %
DE25	2,23 L/s	2,87 L/s	2,52 L/s	113,89 %