

Nom CAMARA	Adresse
Prénom YAKOUBA	Exposition
Né le 25/02/1985	Profession OPERATEUR
Age 39 Ans	Entreprise BECEIP
Genre Masculin	Service
ID 263	Fumeur Non fumeur
Taille 175 cm	Groupe ethnique Origine africaine
Poids	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur admin admin	



Fim medical
51 rue Primat
+33 (0)4 72 34 89 89
+33(0)4 72 33 43 51

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00


Température ambiante : 32,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 100,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Humidité : 59 %

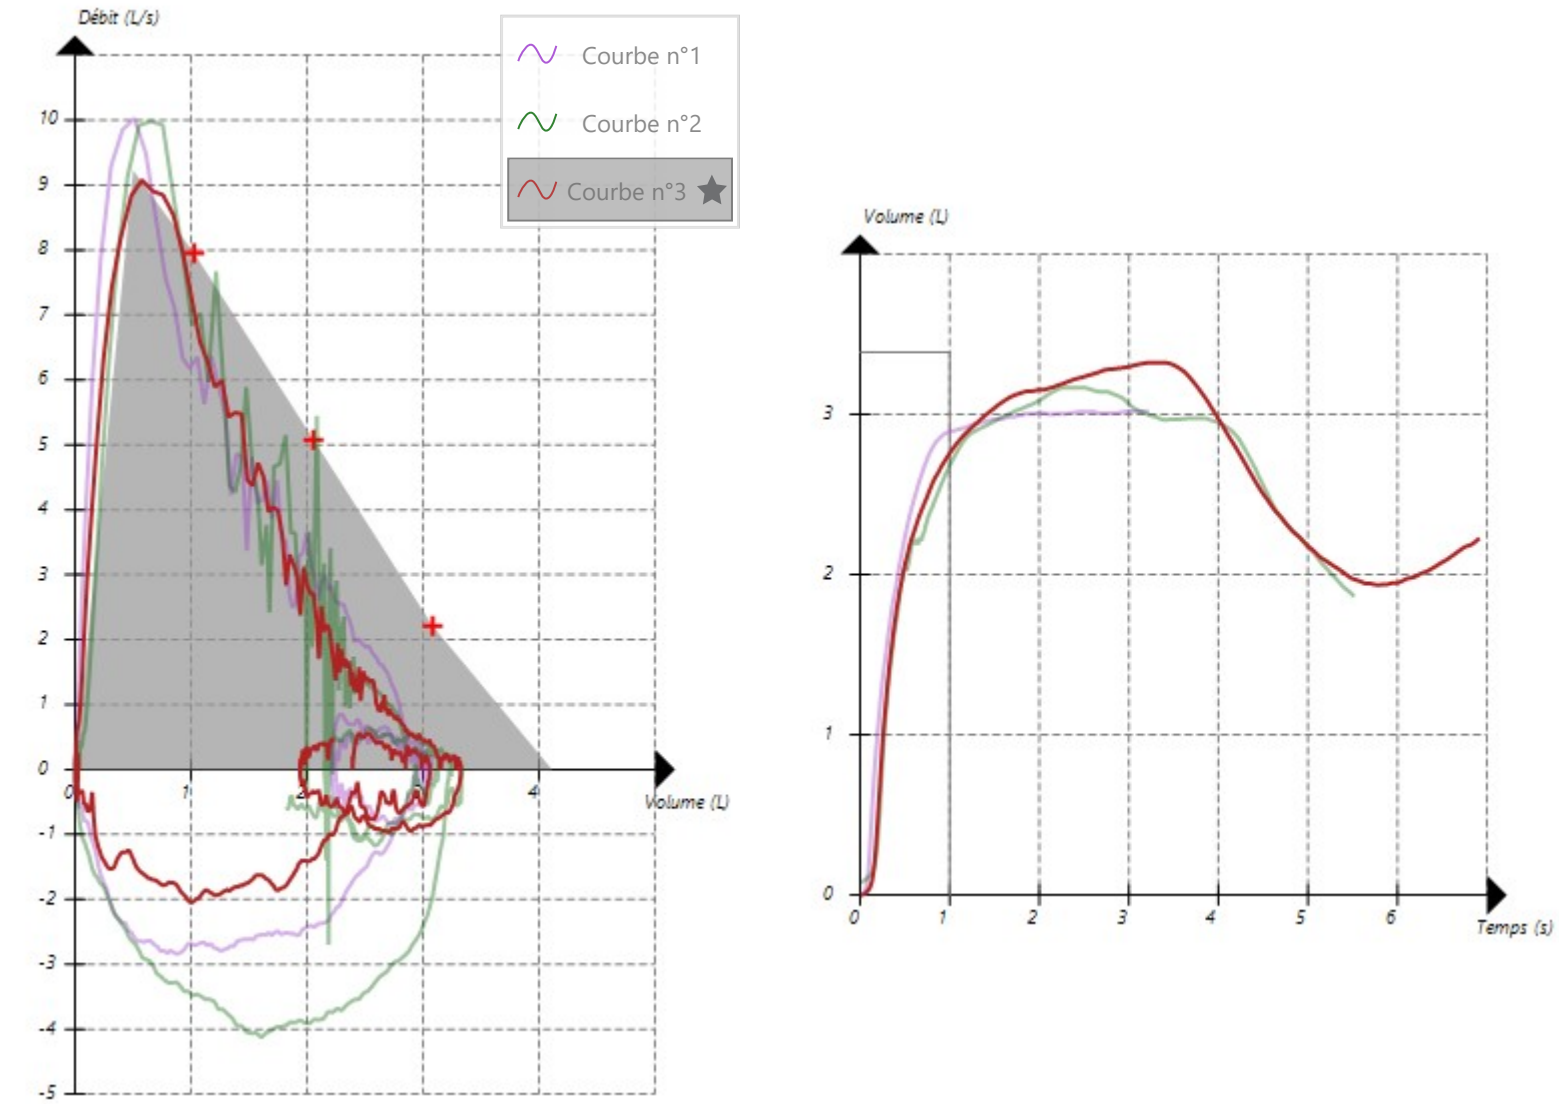

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,01 L	3,13 L	3,32 L	4,11 L	80,78 %
VEMS	2,90 L	2,80 L	2,86 L	3,39 L	84,37 %
DEP	10,07 L/s	10,25 L/s	9,12 L/s	9,23 L/s	98,81 %
VEMS/CVF	96,35 %	89,46 %	86,14 %	80,23 %	107,37 %
Durée d'expiration	2,01 s	2,59 s	3,30 s	-	
DEMM	4,28 L/s	2,95 L/s	3,22 L/s	4,42 L/s	72,85 %
DEMM/CVF	1,42 s-1	0,94 s-1	0,97 s-1	0,94 s-1	103,19 %
DE75	7,70 L/s	9,61 L/s	8,64 L/s	7,95 L/s	108,68 %
DE50	4,48 L/s	3,91 L/s	4,21 L/s	5,08 L/s	82,87 %
DE25	2,56 L/s	1,67 L/s	1,52 L/s	2,21 L/s	68,78 %