



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALPHA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 27/09/1982	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> ASSISTANT FOREUR
<b>ID</b> 731	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 182 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 76 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 62 %

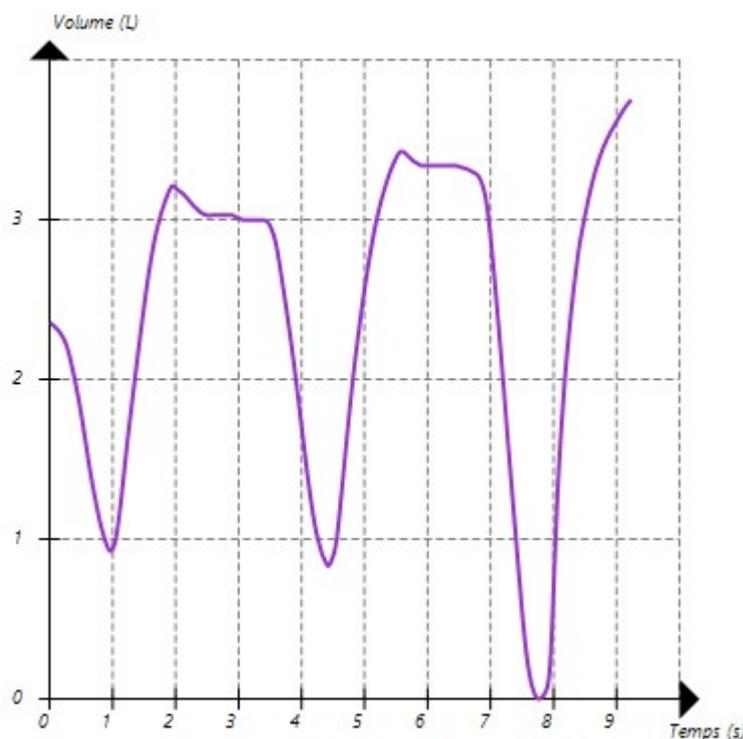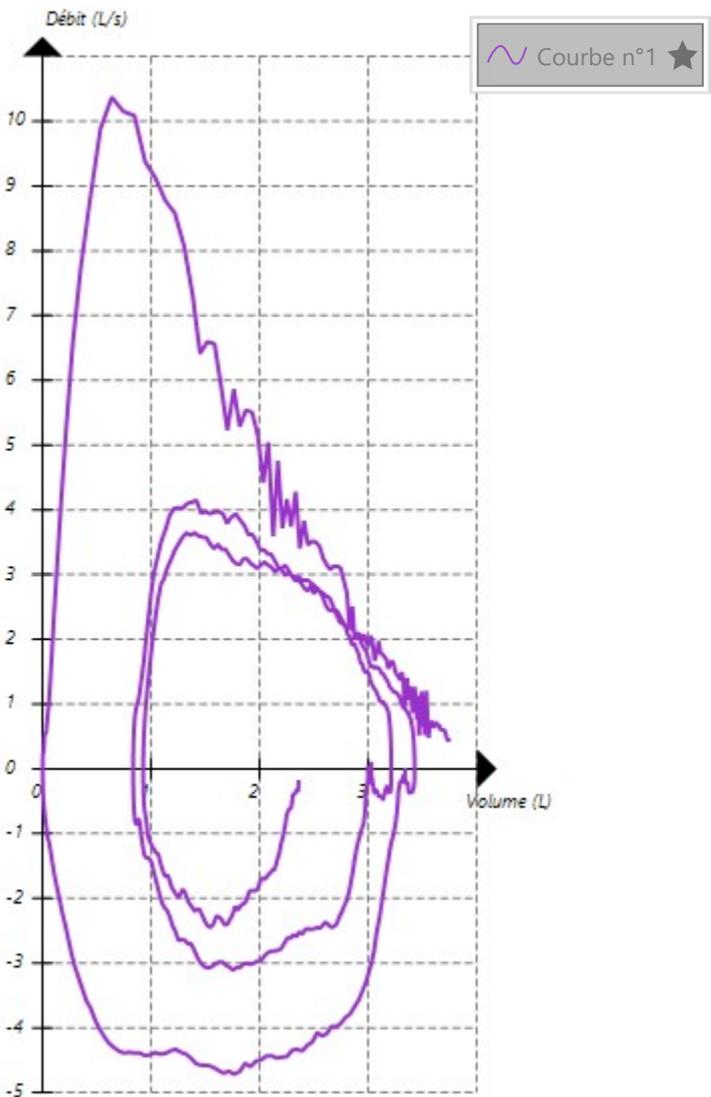

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,76 L	4,61 L	81,56 %
VEMS	3,56 L	3,76 L	94,68 %
DEP	10,49 L/s	9,61 L/s	109,16 %
VEMS/CVF	94,68 %	81,74 %	115,83 %
Durée d'expiration	1,49 s	-	
DEMM	5,00 L/s	3,88 L/s	128,87 %
DEMM/CVF	1,33 s-1	0,84 s-1	158,33 %
DE75	9,41 L/s	-	
DE50	5,69 L/s	-	
DE25	2,44 L/s	-	