



<b>Nom</b> TOURE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KABINET	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 04/06/1994	<b>Profession</b> CHAUFFEUR PL
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> BECEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 584	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,4 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 53 %

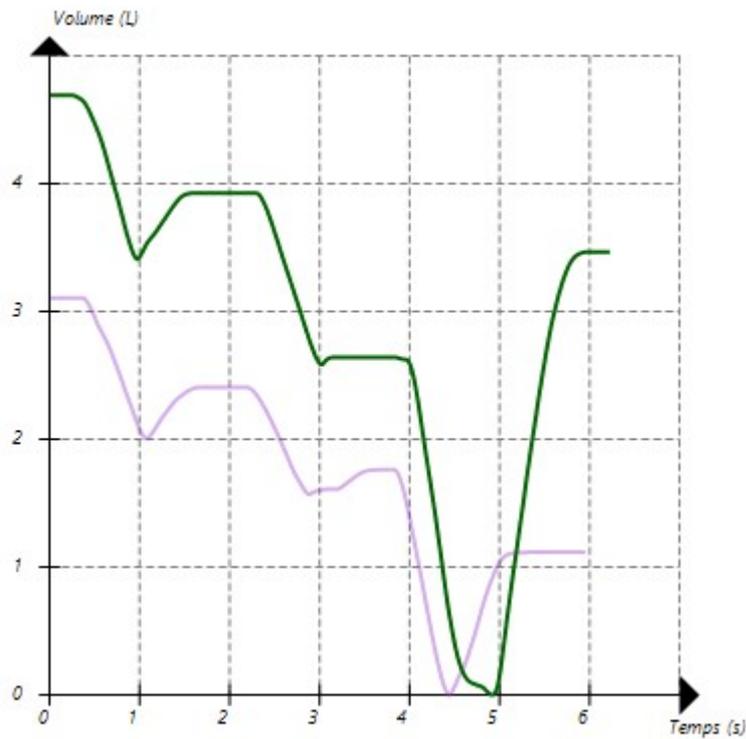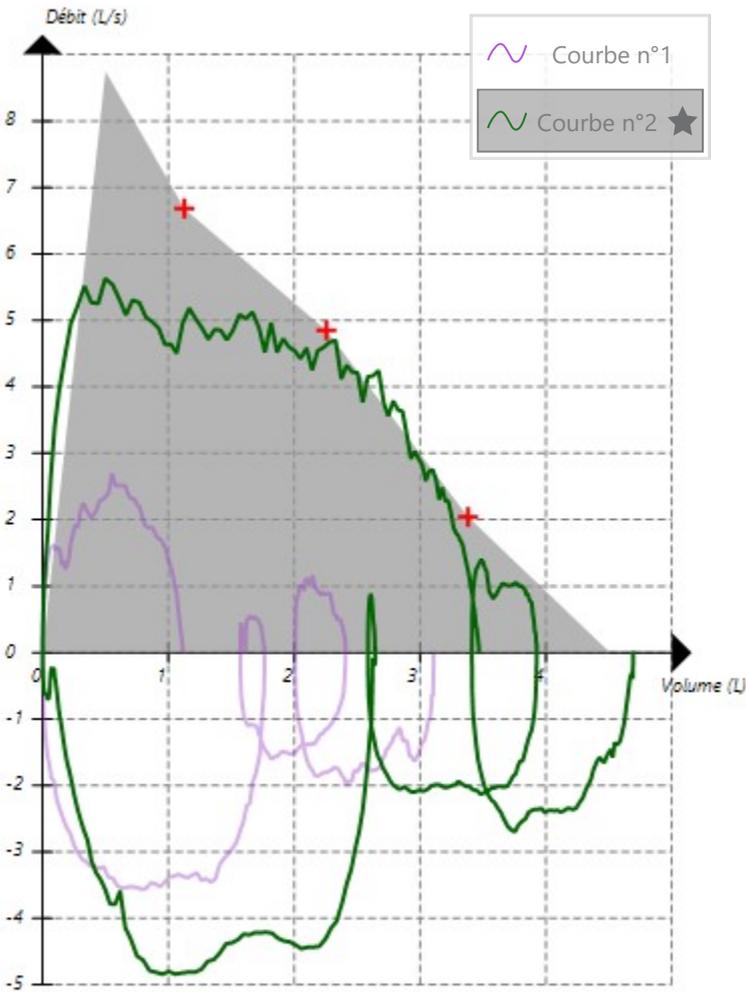

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,12 L	3,47 L	4,51 L	76,94 %
VEMS	1,12 L	3,47 L	3,79 L	91,56 %
DEP	2,83 L/s	5,81 L/s	8,75 L/s	66,40 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	83,55 %	119,69 %
Durée d'expiration	0,89 s	1,06 s	-	
DEMM	2,31 L/s	4,75 L/s	4,12 L/s	115,29 %
DEMM/CVF	2,06 s-1	1,37 s-1	0,91 s-1	150,55 %
DE75	1,86 L/s	4,91 L/s	6,68 L/s	73,50 %
DE50	2,82 L/s	4,77 L/s	4,85 L/s	98,35 %
DE25	1,96 L/s	4,13 L/s	2,04 L/s	202,45 %