



<b>Nom</b> DIARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KABINET	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/10/1989	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 444	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 2
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 50 %

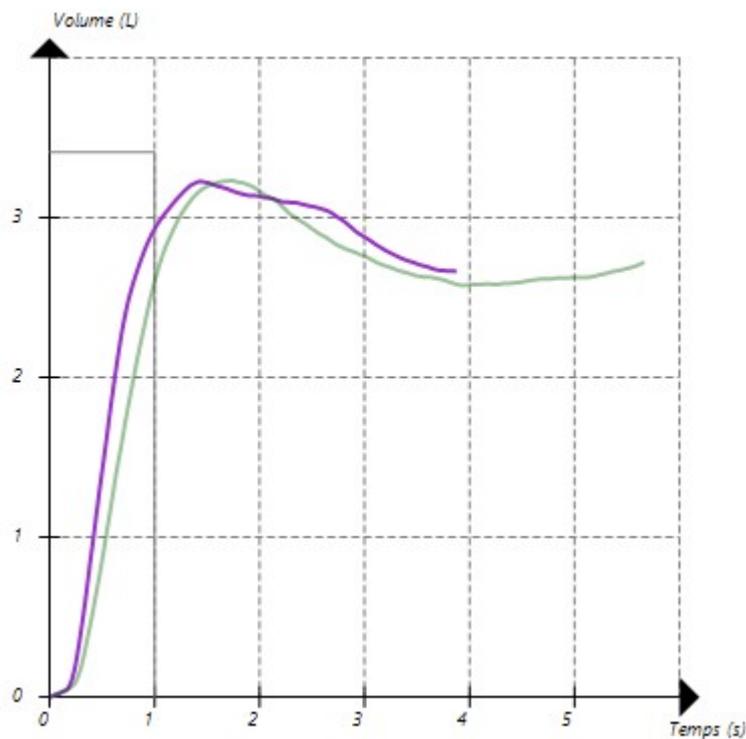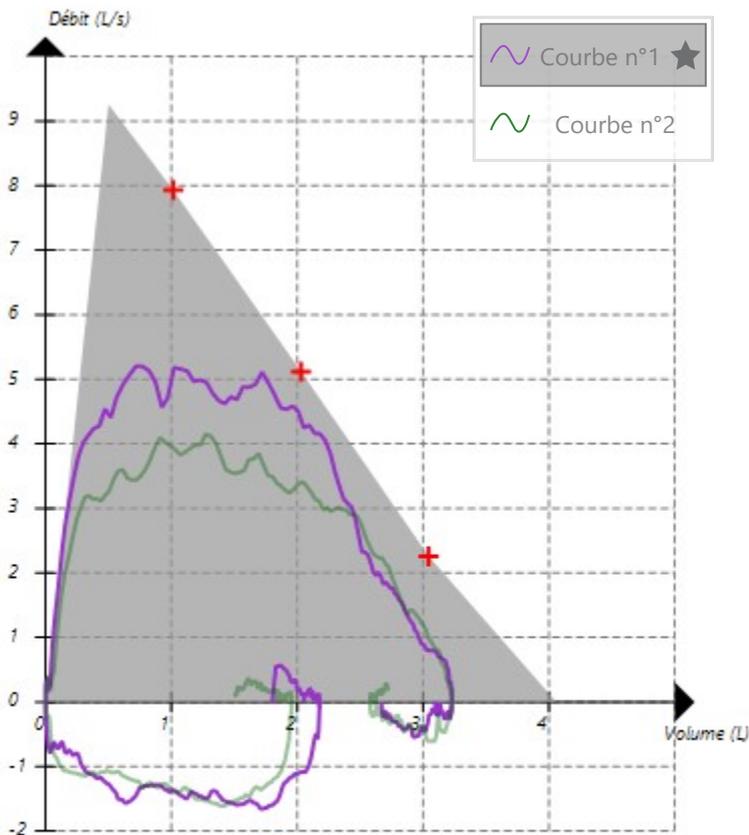

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,23 L	3,23 L	4,06 L	79,56 %
VEMS	3,12 L	3,06 L	3,41 L	91,50 %
DEP	5,24 L/s	4,29 L/s	9,26 L/s	56,59 %
VEMS/CVF	96,59 %	94,74 %	81,12 %	119,07 %
Durée d'expiration	1,44 s	1,73 s	-	
DEMM	4,61 L/s	3,62 L/s	4,58 L/s	100,66 %
DEMM/CVF	1,43 s-1	1,12 s-1	0,98 s-1	145,92 %
DE75	5,11 L/s	3,65 L/s	7,93 L/s	64,44 %
DE50	4,91 L/s	3,78 L/s	5,12 L/s	95,90 %
DE25	3,04 L/s	2,87 L/s	2,26 L/s	134,51 %