

<b>Nom</b> SAGNO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MIMI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> FERRAILLEUR
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 181	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 163 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 50 %

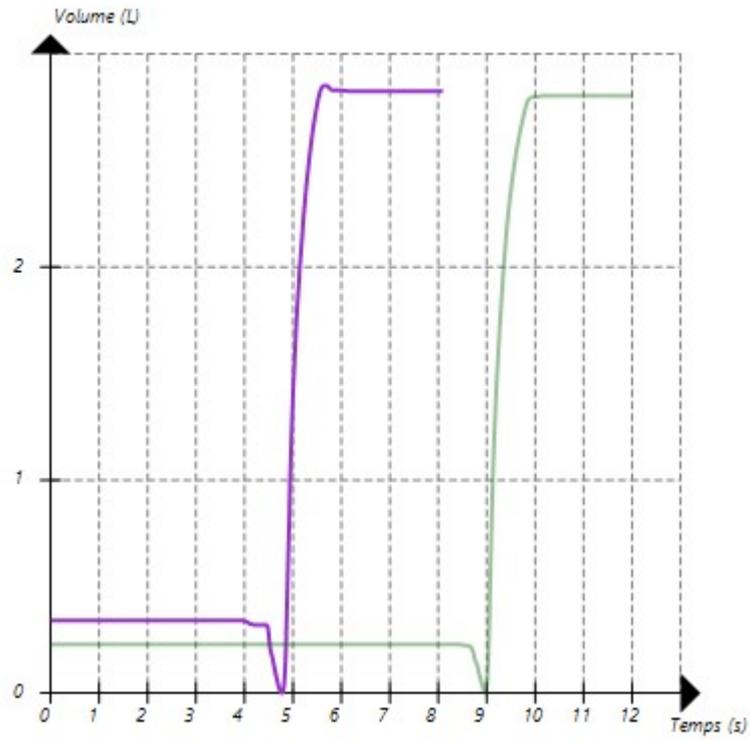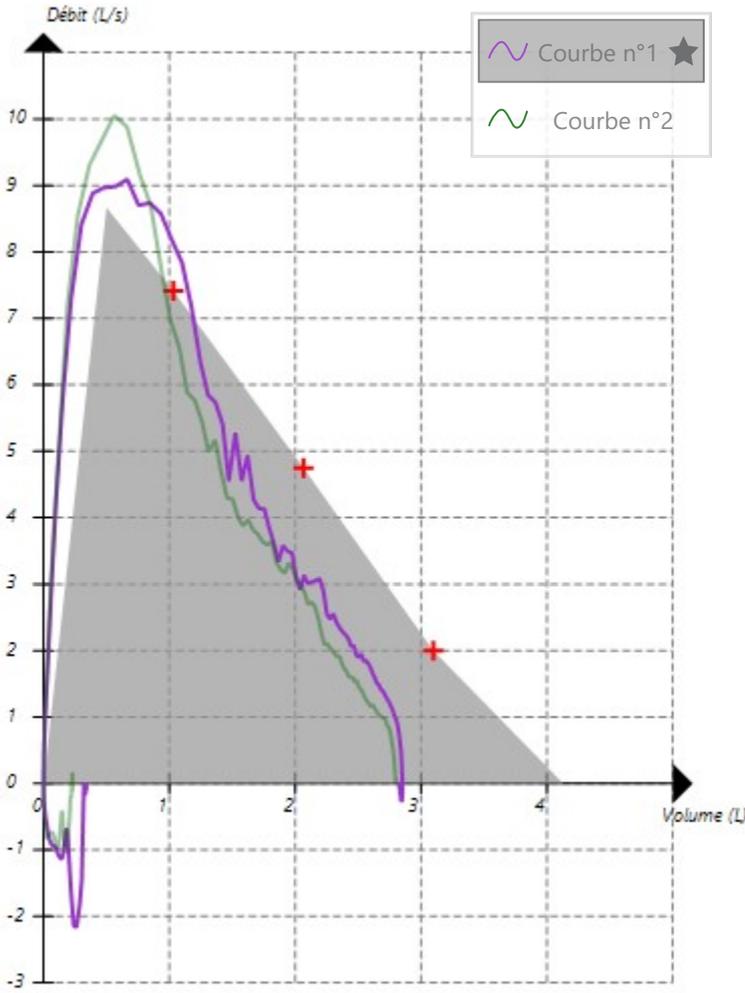

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,85 L	2,80 L	4,13 L	69,01 %
VEMS	2,85 L	2,80 L	3,50 L	81,43 %
DEP	9,32 L/s	10,16 L/s	8,67 L/s	107,50 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	80,94 %	123,55 %
Durée d'expiration	0,92 s	1,21 s	-	
DEMM	5,13 L/s	4,74 L/s	4,36 L/s	117,66 %
DEMM/CVF	1,80 s-1	1,69 s-1	1,06 s-1	169,81 %
DE75	8,81 L/s	9,79 L/s	7,41 L/s	118,89 %
DE50	5,44 L/s	4,65 L/s	4,75 L/s	114,53 %
DE25	3,07 L/s	2,68 L/s	2,00 L/s	153,50 %