



<b>Nom</b> KOULEMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> NOEL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/12/1992	<b>Profession</b> MECANICIEN D'EQUIPEMENT LOU...
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 548	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,4 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 68 %

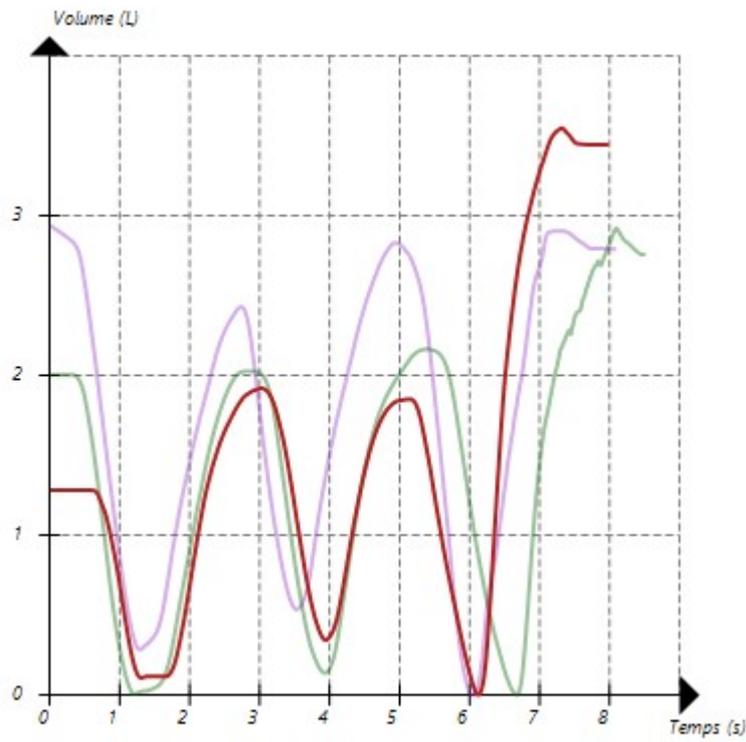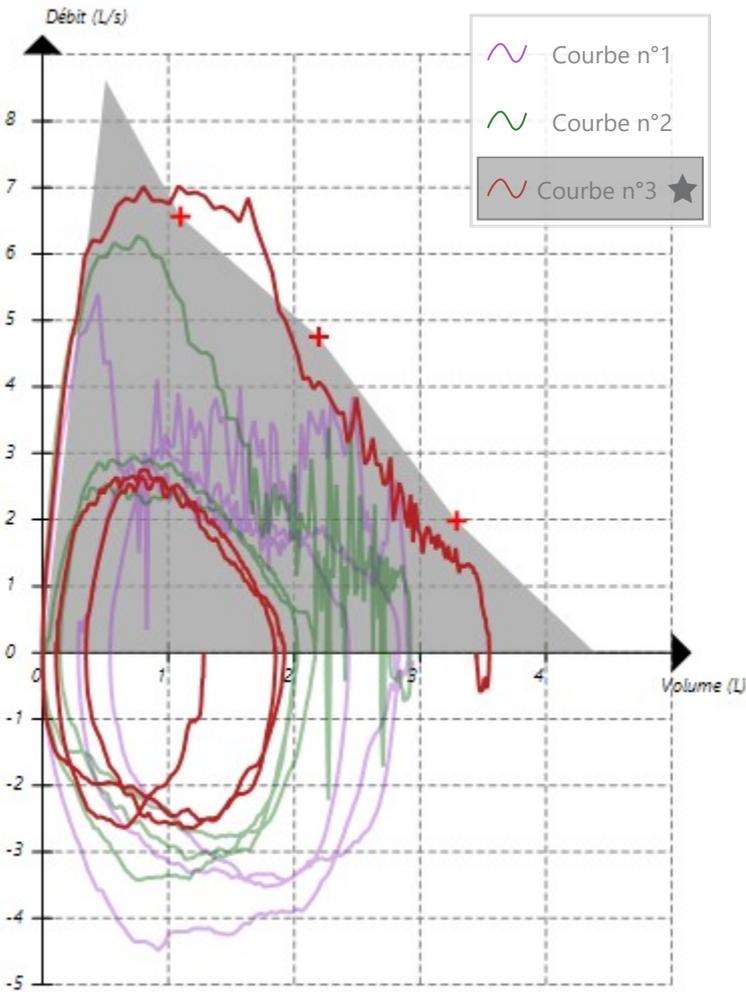

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,91 L	2,92 L	3,55 L	4,39 L	80,87 %
VEMS	2,90 L	2,63 L	3,51 L	3,69 L	95,12 %
DEP	6,03 L/s	6,49 L/s	7,08 L/s	8,62 L/s	82,13 %
VEMS/CVF	99,66 %	90,07 %	98,87 %	83,44 %	118,49 %
Durée d'expiration	1,16 s	1,42 s	1,19 s	-	
DEMM	2,95 L/s	3,13 L/s	5,05 L/s	4,02 L/s	125,62 %
DEMM/CVF	1,01 s-1	1,07 s-1	1,42 s-1	0,92 s-1	154,35 %
DE75	2,59 L/s	6,19 L/s	6,80 L/s	6,56 L/s	103,66 %
DE50	3,85 L/s	3,51 L/s	5,92 L/s	4,75 L/s	124,63 %
DE25	3,56 L/s	1,62 L/s	2,86 L/s	1,98 L/s	144,44 %