



<b>Nom</b> DUONAMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> HENRI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/07/1991	<b>Profession</b> TECHNICIEN HSE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> BCEIP
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 319	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32,6 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 100,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 69 %

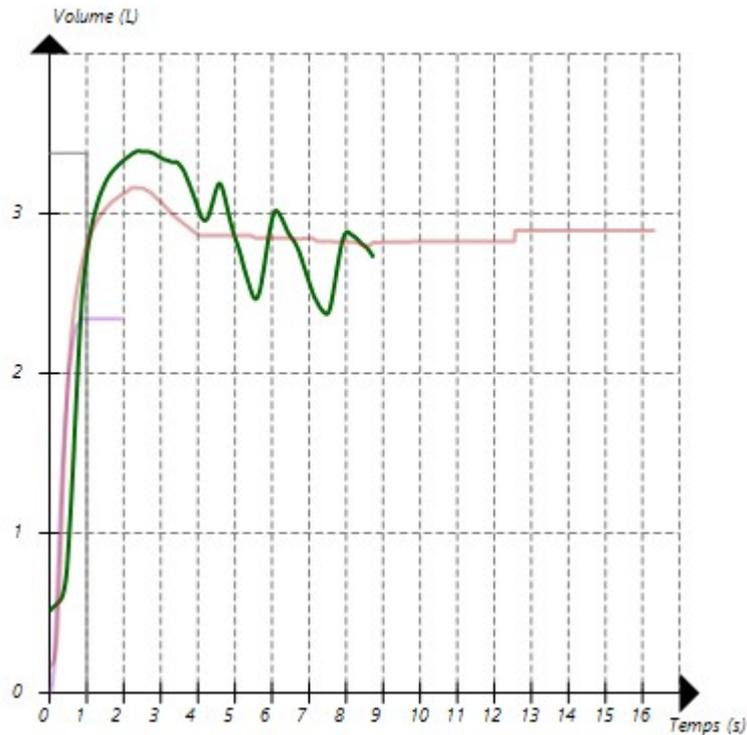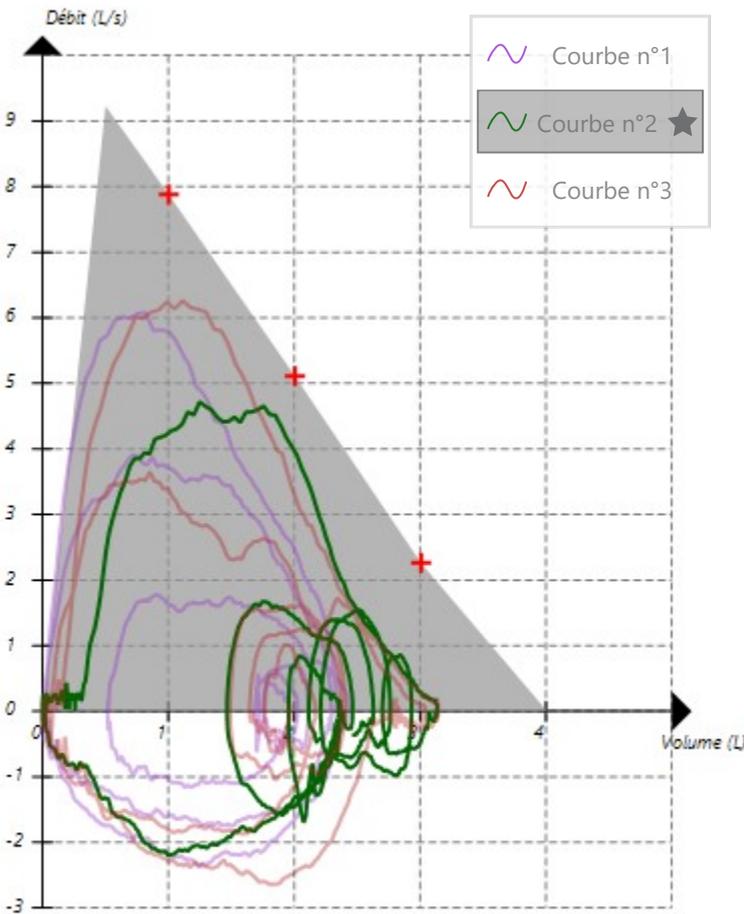

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,31 L	3,14 L	3,08 L	4,01 L	78,30 %
VEMS	2,31 L	2,87 L	2,82 L	3,38 L	84,91 %
DEP	6,17 L/s	4,76 L/s	6,35 L/s	9,23 L/s	51,57 %
VEMS/CVF	100,00 %	91,40 %	91,56 %	81,48 %	112,17 %
Durée d'expiration	0,82 s	3,77 s	2,71 s	-	
DEMM	4,86 L/s	4,04 L/s	4,19 L/s	4,63 L/s	87,26 %
DEMM/CVF	2,10 s-1	1,29 s-1	1,36 s-1	1,00 s-1	129,00 %
DE75	6,07 L/s	3,91 L/s	6,08 L/s	7,88 L/s	49,62 %
DE50	5,21 L/s	4,39 L/s	5,01 L/s	5,11 L/s	85,91 %
DE25	3,14 L/s	2,10 L/s	1,81 L/s	2,26 L/s	92,92 %