

Nom TRONKA	Adresse
Prénom SAYON	Exposition
Né le 01/01/1990	Profession OPERATEUR COMPACTEUR
Age 34 Ans	Entreprise
Genre Masculin	Service
ID 43	Fumeur Non fumeur
Taille 181 cm	Prescripteur:
Poids 69 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	
Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion: SYNDROME VENTILATOIRE RESTRICTIF



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,3 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 46 %

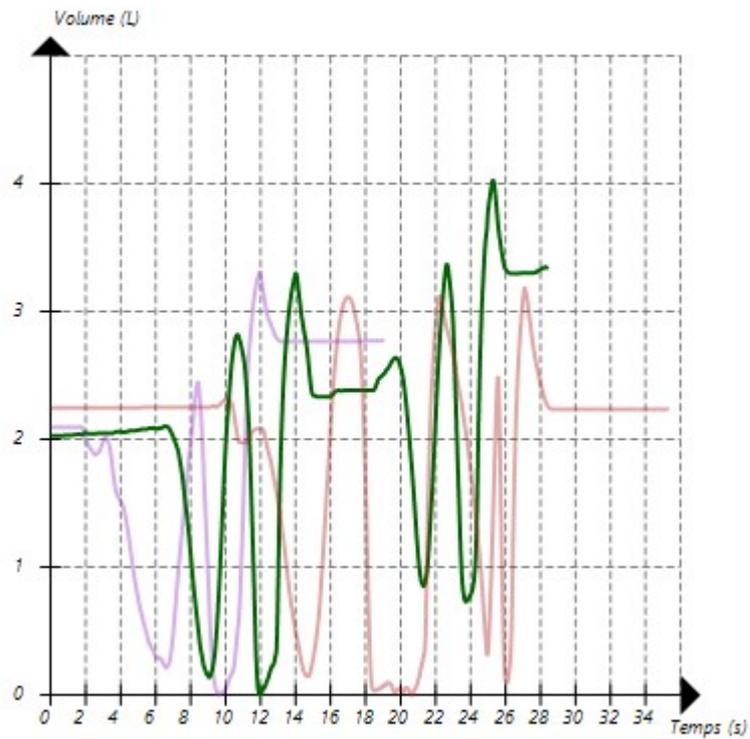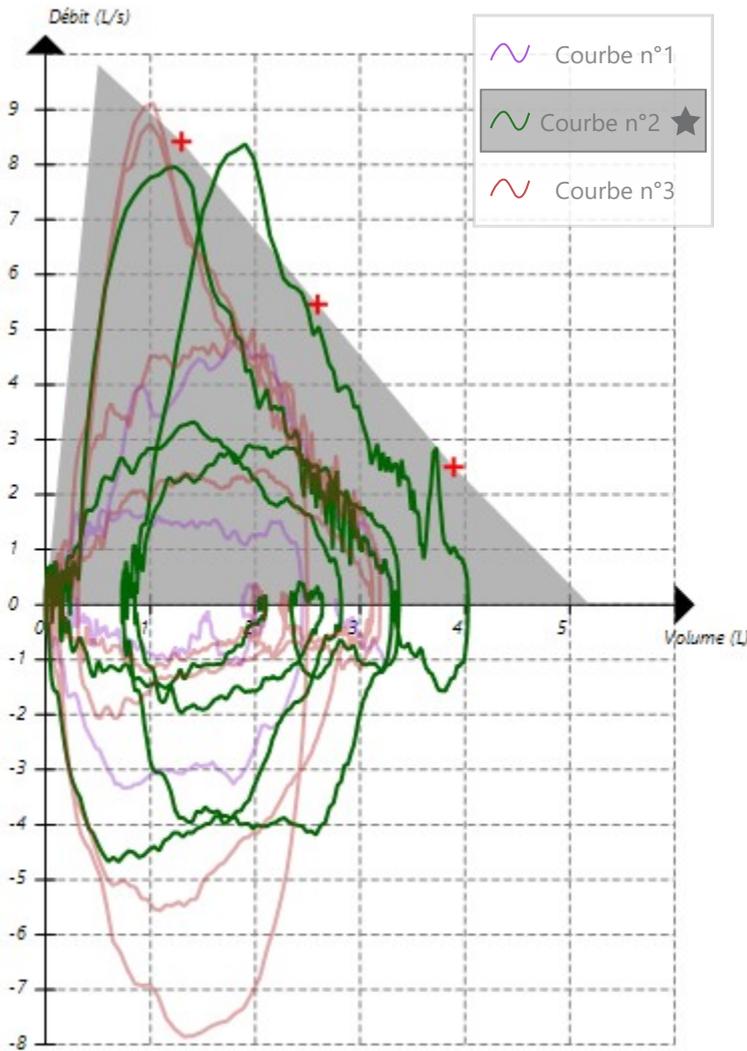

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,16 L	3,26 L	3,09 L	5,19 L	62,81 %
VEMS	3,04 L	3,26 L	3,09 L	4,31 L	75,64 %
DEP	4,89 L/s	8,46 L/s	9,26 L/s	9,82 L/s	86,15 %
VEMS/ CVF	96,20 %	100,00 %	100,00 %	81,12 %	123,27 %
Durée d'expiration	1,66 s	1,32 s	0,99 s	-	
DEMM	4,03 L/s	5,12 L/s	5,60 L/s	4,76 L/s	107,56 %
DEMM/ CVF	1,28 s-1	1,57 s-1	1,81 s-1	0,92 s-1	170,65 %
DE75	3,96 L/s	7,63 L/s	8,95 L/s	8,42 L/s	90,62 %
DE50	4,61 L/s	5,73 L/s	5,92 L/s	5,46 L/s	104,95 %
DE25	2,45 L/s	2,98 L/s	3,06 L/s	2,50 L/s	119,20 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: