

Nom CAMARA	Adresse
Prénom MOHAMED	Exposition
Né le 15/03/1980	Profession SUPERVISEUR HSE
Age 43 Ans	Entreprise BECEIP
Genre Masculin	Service
ID 56	Fumeur Non fumeur
Taille 169 cm	Prescripteur:
Poids 86 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	
Opérateur admin admin	




MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
Numéro de série : 232803
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,8 °C
Pression atmosphérique : 93,5 kPa
Humidité : 51 %

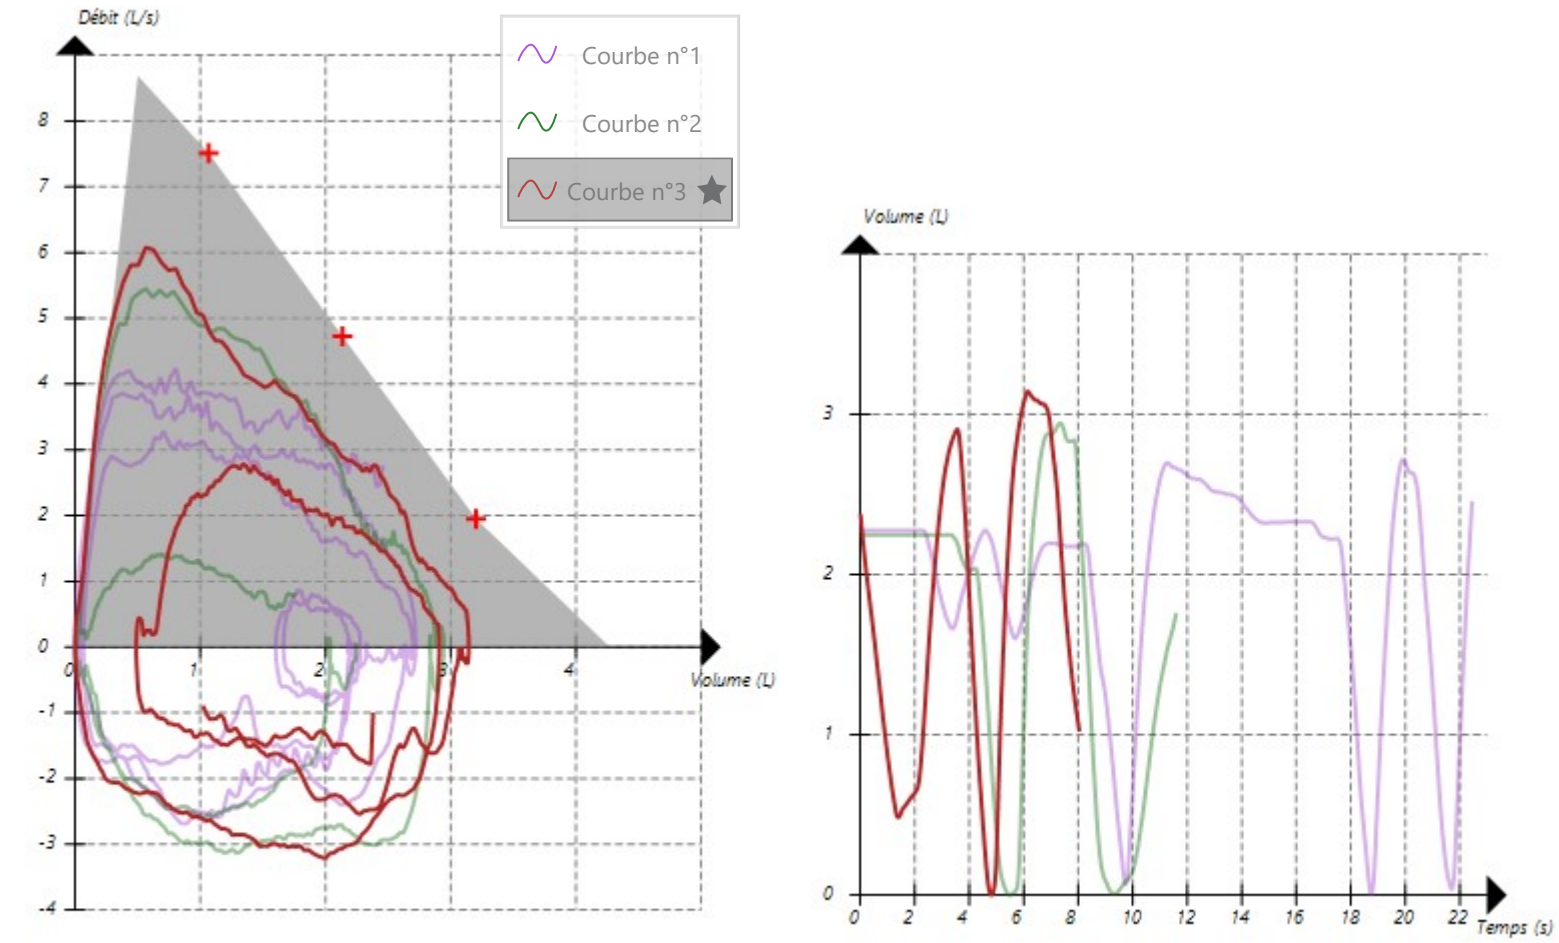

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,45 L	2,94 L	3,14 L	4,27 L	73,54 %
VEMS	2,45 L	2,86 L	3,05 L	3,53 L	86,40 %
DEP	4,51 L/s	5,68 L/s	6,22 L/s	8,69 L/s	71,58 %
VEMS/ CVF	100,00 %	97,28 %	97,13 %	79,51 %	122,16 %
Durée d'expiration	0,76 s	1,87 s	1,32 s	-	
DEMM	3,74 L/s	4,10 L/s	3,88 L/s	4,14 L/s	93,72 %
DEMM/ CVF	1,53 s-1	1,39 s-1	1,24 s-1	0,97 s-1	127,84 %
DE75	4,09 L/s	5,24 L/s	5,84 L/s	7,51 L/s	77,76 %
DE50	3,82 L/s	4,50 L/s	3,94 L/s	4,73 L/s	83,30 %
DE25	3,38 L/s	2,19 L/s	2,55 L/s	1,95 L/s	130,77 %